

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГМС: КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



БЕЛГИМ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ

- Переходной период с 01.01.2026 по 31.12.2029 для передачи сведений о государственной поверке СИ в подписанном ЭЦП виде
- Новый сервис: печать результатов государственной поверки СИ из ГИФ
- Прослеживаемость результатов государственной поверки к ГРСИ
- Новая форма свидетельств/заключений с опциональной возможностью размещения QR-кода, ведущего на ГИФ

ВНЕДРЕНИЕ ЭЦП

#	Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица...	ЭЦП	УНП Организации	Регистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измерений	Заводской номер средства измерений	Поверка	Регистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБ	Наименование средства измерений	Обозначение типа средства измерений
1	БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397585-4325	469625	Последующая	РБ 03 15 1655 20	секундомер электронный	"Интеграл С-01"
2	БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397584-4325	435889	Последующая	РБ 03 15 1655 20	секундомер электронный	"Интеграл С-01"
3	БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397583-4325	442411	Последующая	РБ 03 15 1655 20	секундомер электронный	"Интеграл С-01"
4	БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397582-4325	447431	Последующая	РБ 03 15 1655 20	секундомер электронный	"Интеграл С-01"
5	БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397581-4325	409103	Последующая	РБ 03 15 1655 20	секундомер электронный	"ИНТЕГРАЛ С-01"
6	БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397580-4325	454124	Последующая	РБ 03 15 1655 20	секундомер электронный	"ИНТЕГРАЛ С-01"
7	БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397579-4325	306747	Последующая	РБ 03 15 1655 20	секундомер электронный	"Интеграл С-01"

ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ ИЗ ГИФ

				
БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397585-4325	469625
БелГИМ	Подписано	100055197	1-0397584-4325	435889



Республиканское унитарное предприятие
Белорусский государственный институт метрологии

Свидетельство об уполномочивании
на осуществление государственной поверки средств измерений
№ 1 от 24.11.2023

УНП: 100055197

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ
№1-0000010-4925

Действительно до 10.06.2026 г.

Средство измерений Манометры МТ, мановакуумметры МВТ

Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений Манометр МТ-160 Верхнее значение диапазона измерений (избыточного давления): 300 кПа кл.т. 2,5

Идентификационный признак РБ 03 04 8192 21

Заводской (серийный) номер средства измерений 23

Состав средства измерений

Методика поверки СТБ 8056-2015

Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке Манометр цифровой Crystal XP2i № 120209, от минус 100 до 0 кПа $\gamma = \pm 0,25 \%$; от 0 до 2 000 кПа $\gamma = \pm 0,05 \%$

Применяется в качестве эталона единицы величины -

Объем государственной поверки В полном объеме.

Тип государственной поверки Последующая

Заключение по результатам государственной поверки Годен

Владелец средства измерений СООО "БелЦЕННЕР"

Результаты государственной поверки -

Номер свидетельства о государственной поверке 1-0000010-4925 Страница 2 из 2

Национального эталона единицы электрического сопротивления НЭ РБ 29-16; Национальный эталон единицы напряженности электрического поля НЭ РБ 49-18; Национальный эталон единицы давления для области избыточных давлений НЭ РБ 32-18; Государственный первичный эталон единицы температуры - кельвина в диапазоне 0,3 К до 273,16 К гэт35-2021; передачу в процессе поверки размера единицы величины от Национального эталона единицы электрической мощности № НЭ РБ 14-04, Национального эталона един

Информация
о метрологической
прослеживаемости:

Государственный поверитель В.В. Масалков

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: 220050, Старовиленский тракт 93, г.Минск, Республика Беларусь, тел.:

Дата государственной поверки 11.06.2025



Организация-подписанта	Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»	
Кем подписан	Дата и время	Серийный номер сертификата
Масалков Владимир Валерьевич	12.09.2025 13:43:11	4E822700DF42DA0E5834E640
ЭЦП: E22B7BA5D4C942FDC568928393F98E958123B3533A68314901E1C26B9A0C30B67F2F2413A943CACC741B23CE33698E2C		
Файл документа: 1-00000010-4925.pdf		

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ К ГРСИ

БелГИМ	100055197	1-0296603-4725	1747	Последующая	РБ 03 02 0045 94	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-2
БелГИМ	100055197	1-0296602-4725	2111	Последующая	РБ 03 02 0045 94	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-2



Вид средства измерений

Все

Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений	Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений	Номер сертификата об утверждении типа средства измерений	Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ	Производитель средства измерений	Дата внесения типа средства измерений	Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений	Сведения о методике поверки	Интервал времени между государственными поверками	Категория средства измерений	Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства
Выберите ...			РБ 03 02 0045 9							Выберите ...
Исключенный	Весы настольные циферблатные ВНЦ-2М	3707	РБ 03 02 0045 94	ОАО "Весоприбор"	27.12.2005		Поверка проводится по ГОСТ 8.453-82	12 мес.	Средства измерений массы	Нет
Исключенный	Весы настольные циферблатные ВНЦ-2М	45	РБ 03 02 0045 94	АО "ВЕСОПРИБОР"	25.02.1994		Поверка проводится по ГОСТ 8.453-82	12 мес.	Средства измерений массы	Нет

Показаны 1-2 из 2 записи.

НОВАЯ ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВ/ЗАКЛЮЧЕНИЙ С QR-КОДОМ

Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

Свидетельство об уполномочивании на осуществление государственной поверки средств измерений № 1 от 24.11.2023

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ
№ 1-0000010-3425

Дата государственной поверки «20» января 2025 г.
Действительно до «19» января 2026 г.

Средства измерений Измеритель времени распространения ультразвука ПУЛЬСАР-1;
ПУЛЬСАР-1.1.

Идентификационный номер 864

Обязательные метрологические требования:	Диапазон	Погрешность
Характеристики		
Время распространения ультразвуковых колебаний Т, мкс	10-999	±(0,1+0,01Т)
База при поверхностном прозвучивании, мм	120	±3

Заявитель Унитарное предприятие "Стройреконструкция"

Государственная поверка проведена в соответствии с методикой поверки:
разделом 6 «Методика поверки» из руководства по эксплуатации ИВРУ.410505.002 РЭ

с применением эталонов единиц величин: микрометр серин 293 №66473643, микрометр серин 293, Δ=±1 мкм; Установка для измерения скорости ультразвуковых волн УНСУ-3, 01, Δ=±(0,002+0,0001·Т), мкс

Результаты государственной поверки (при необходимости): с преобразователями П111=0,06-ИЗ №782, П111=0,06-ИЗ №783, П111=0,06-И1 №773, П111=0,06-И2 №193

На основании результатов государственной поверки средство измерений соответствует обязательным метрологическим требованиям и признано пригодным к применению.

Знак государственной поверки:

Государственный поверитель

Добров А. А.

подпись

расшифровка подписи

Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, до единиц величин Международной системы единиц (СИ), которые воспроизводятся через Национальный эталон единицы длины-метра в диапазоне (0,1-100) мм НЭ РБ 31-18; Национальный эталон единицы времени-секунды, частоты – герца и шкалы времени НЭ РБ 1-95

Адрес юридического лица, уполномоченного на проведение государственной поверки, тел.: 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел.: _____; факс 244-99-38

Республиканское унитарное предприятие
Белорусский государственный институт метрологии

Свидетельство об уполномочивании
на осуществление государственной поверки средств измерений
№ 1 от 24.11.2023

УНП: 100055197

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ
№1-0000010-4925

Действительно до 10.06.2026 г.

Средство измерений

Манометры МТ, мановакуумметры МВТ

Обозначение модификации
и (или) исполнения средства
измерений

Манометр МТ-160 Верхнее значение диапазона
измерений (избыточного давления): 300 кПа
кл.т. 2,5

Идентификационный признак

РБ 03 04 8192 21

Заводской (серийный)
номер средства измерений

23

Состав средства измерений

Методика поверки

СТБ 8056-2015

Эталоны единиц величин,
стандартные образцы,
средства измерений,
применяемые при
государственной поверке

Манометр цифровой Crystal XP2i № 120209,
от минус 100 до 0 кПа γ= ±0,25 %; от 0
до 2 000 кПа γ= ±0,05 %

Применяется в качестве
эталона единицы величины

-

Объем государственной
поверки

В полном объеме.

Тип государственной
поверки

Последующая

Заключение по результатам
государственной поверки

Годеи

Владелец средства
измерений

СООО "БелЦЕННЕР"

Результаты государственной
поверки

-

Номер свидетельства о государственной поверке 1-0000010-4925 Страница 2 из 2

Национального эталона единицы электрического сопротивления НЭ РБ 29-16; Национальный эталон единицы напряженности электрического поля НЭ РБ 49-18; Национальный эталон единицы давления для области избыточных давлений НЭ РБ 32-18; Государственный первичный эталон единицы температуры - кельвина в диапазоне 0,3 К до 273,16 К гэт35-2021; передачу в процессе поверки размера единицы величины от Национального эталона единицы электрической мощности № НЭ РБ 14-04, Национального эталона един

Информация
о метрологической
прослеживаемости:

Государственный поверитель В.В. Масалков

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: 220050, Старовиленский тракт 93, г.Минск, Республика Беларусь, тел.:

Дата государственной поверки 11.06.2025



Организация-подписант	Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»	
Кем подписан	Дата и время	Серийный номер сертификата
Масалков Владимир Валерьевич	12.09.2025 13:43:11	4E822700DF42DA0E5834E640
ЭЦП: E22B7BA5D4C942FDC568928393F98E958123B3533A68314901E1C26B9A0C30B67F2F2413A943CACC741B23CE33698E2C		
Файл-документа: 1-000000010-4925.pdf		

НОВАЯ ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВ/ЗАКЛЮЧЕНИЙ С QR-КОДОМ

Государственный поверитель

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего поверку средства измерений: 220050, Старовиле
Республика Беларусь, тел.:

Дата
государственной поверки





Поиск

Сбросить фильтры

Показаны 1-1 из 1 запись.

#	Наименование уполномоченного юридического лица или иного юридического лица, уполномоченного Госстандартом на осуществление государственной поверки средства измерения, осуществившее государственную поверку средства измерения	УНП Организации	Регистрационный номер свидетельства о государственной поверке средства измерений	Заводской номер средства измерений	Поверка	Регистрационный номер утвержденного типа средства измерения в Госреестре средств измерений и стандартных образцов РБ	Наименование средства измерений	Обозначение типа средства измерений	Модификация средства измерений (при наличии)	Дата государственной поверки средства измерений	Дата прекращения действия государственной поверки средства измерений	Год
1	БелГИМ	100055197	1-0399650-4325	699	Последующая	РБ 03 16 1705 03	Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-131		10.09.2025	09.09.2026	2025

МОДУЛЬ НА ПЛАТФОРМЕ 1С ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ЭЦП

☆

Протокол поверки

Провести и закрыть

Записать

Провести

+ Добавить наклейку

✉ Отправить результат МО

- Снять наклейку

🖨 Печать ▾

✍ Подписать и отправить на портал

🔗

🔍 Наряд

👤

Номер: Дата: 12.09.2025 12:47:52 📅 Дата поверки: 12.09.2025 📅 Действителен до: 11.09.2026 📅

Общие данные

Описание типа

Метрологические характеристики

Результаты

Следование по подразделениям

Заказ

Средство измерений

Заявитель: (2 944) Филиал "Бобруйские электрические сети" РУП "Мон ⌵ 🔒

Подразделение: (4900) Производственно-исследовательский отдел измерени ⌵ 🔒

Методики поверки: Методика поверки
(000000020) ГОСТ 8.520-2005 Государственная система обес...

Владелец:

Межповерочный интервал: 12

Средство измерений: 3D системы измерительные лазерные Leica ⌵ 🔒

Вид поверки: Последующая ⌵

Описание типа: РБ 03 01 4977 15 (15 - 20) ⌵ 🔒

Результат: Годен ⌵

Модификация: ⌵ 🔒

Клеймо-наклейка:

Зав. №: 123

Вне СЗМ: ☐ Малая: ☐ Виртуальная: ☐

Уполномоченное лицо: Масалков Владимир Валерьевич ⌵ 🔒

Дата изготовления: . . 📅

ПСМ 270: ☐ ?

Состав средства измерений:

Эталоны, применяемые при поверке данного СИ

Добавить ⬆ ⬇ ⬇

N	Средство измерений
	Заводской номер Точностные характеристики

Менеджер сертификатов

Выберите сертификат

Идентификатор ключа

Республиканское унитарное предприятие "БЕЛОРУССКАЯ АЭС"

Авст CSP Bel Pro - контейнер личных ключей

Для доступа к контейнеру личных ключей выберите тип носителя и укажите пароль

OK

Отмена

Контейнер

Носитель

AvPass S/N AVP6000231461 ⌵

Имя контейнера

Республиканское унитарное предприятие "БЕЛОРУССКАЯ АЭС"

Пароль

Пароль доступа к контейнеру

••••••••

Войти в систему

Отмена

ОБНОВЛЕННЫЙ ГРСИ

- Обновленный «ГРСИ 1С» с выгрузкой всех сертификатов утверждения типа с привязкой к периодам действия
- Автоматический фильтр для ГИФ
- Единый справочник СИ
- Актуальные трудозатраты на проведение государственной поверки СИ

ОБНОВЛЕННЫЙ ГРСИ НА БАЗЕ 1С 8.3

Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов (1С:Предприятие)

Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

ГРСИ

Сертификаты утверждения типа средства измерений

Сертификаты утверждения типа средства измерений СССР

Сертификаты утверждения типа стандартного образца

Категории средств измерений

Контрагенты

Методики поверки

Области измерений

Основания для выдачи СУТ

Подразделы ГРСИ

Разделы стандартных образцов

Еще ▸

Сертификаты утверждения типа средства измерений

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

Тип СИ. Область измерений: Проведен: Нет

Проведен: Нет

Дата выдачи СУТ	Срок действия СУТ	Истек	Отмена УТ	Номер СУТ	Пор...	Номер госреестра СИ	Тип СИ
02.04.1997		✓		463	0447	РБ 03 13 0447 97	Вольтметр универсальный В7-58А
12.02.1997		✓		452	0445	РБ 03 13 0445 97	Вольтметр универсальный электрометрический В7-57/3
12.02.1997		✓		451	0444	РБ 03 13 0444 97	Вольтметр универсальный электрометрический В7-57/2
28.01.1997	28.01.2002	✓	✓	446	0440	РБ 03 07 0440 97	Колонки топливораздаточные ВМР 1000
30.08.2005	05.07.2010	✓	✓	3 522	0407	РБ 03 02 0407 05	Весы электронно-тензометрические для статического взвешива
06.07.1996			✓	385	0386	РБ 03 25 0386 96	Алкометр А2.0
30.07.1996	25.07.1998	✓	✓	375	0375	РБ 03 13 0375 96	Электросчетчик СО ЭЭ608
30.07.1996	01.01.2001	✓	✓	370	0369	РБ 03 10 0369 96	Счетчик СПТ 960
22.10.2001				1 710	0281	РБ 03 10 0281 01	Теплосчетчики SKU-02
01.07.1998				708	0281	РБ 03 10 0281 98	Теплосчетчики SKU-02
09.09.1997				531	0281	РБ 03 10 0281 97	Теплосчетчики SKU-02
19.07.1995	13.06.2000	✓	✓	252	0254	РБ 03 10 0254 95	Теплосчетчик VORFLO/F

ОЕИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

✉ INFO@OEL.BY

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Основное

Термопреобразователи сопротивления TS-CVO-RTD

PB 03 10 8098 21

14281

02.08.2021

02.08.2026

ГОСТ 8.461-2009 "ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки"

24 месеца

Имеется

Отсутствуют

Копия сертификата об утверждении типа средств измерений или его дубликата

OT_8098_04.08.2021.pdf

Заккрыть

Состояние:	Действующий
------------	-------------

Производитель средства измерений фирма «Termics S.r.l.», Италия

Адрес производителя Via S. Predengo, 27/29, 26022, Castelverde - Cremona, Italy

Контактные данные производителя тел.: +39 0372 471488, факс: +39 0372 471498

Категория средства измерений	Средства измерений температурных и теплофизических величин
------------------------------	--

Вид средства измерений (единичный или серийно-выпускаемый экземпляр)	Серийное-выпускаемый экземпляр
--	--------------------------------

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ГИФ

Основное

Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений		Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений (действующий, истекший)	
Анализаторы иммунофлуоресцентные AFIAS		Состояние: Действующий	
Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ		Производитель средства измерений	
12335-25		Производитель средства измерений: фирма "Boditech Med Inc."	
Номер сертификата об утверждении типа средства измерений		Адрес производителя: 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gang-won-do 24398	
19092		Контактные данные производителя: Тел. +82-33-243-1400, факс +82-33-243-9373	
Дата внесения типа средства измерений		Категория средства измерений: Средства измерений медицинского назначения	
2025-08-25		Вид средства измерений (единичный или серийно-выпускаемый экземпляр): Серийное-выпускаемый экземпляр	
Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений			
2030-08-25			
Сведения о методике поверки			
Обозначение	Наименование		
МРБ МП.4358-2025	Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы иммунофлуоресцентные AFIAS. Методика поверки		
Интервал времени между государственными поверками			
Интервал, месяцев	Условие		
12			
Информация о наличии возможности проведения работ по метрологической оценке в Республике Беларусь			
Имеется			
Признание результатов поверки средства измерений			
-			
Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства			
Отсутствуют			
Получатель сертификата об утверждении типа средства измерений			
Компания «DIAQUIP LIMITED», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии			
Категория			
Код	Наименование		
6.8	анализаторы состава и свойств биологических сред		
Файл сертификата утверждения типа и описания типа			
CVT_19092.pdf			
Модификации			
AFIAS-1			
AFIAS-6			

Заккрыть

ЕДИНЬЙ СПРАВОЧНИК СИ

ГИФ
Oei.by

ГРСИ

Единый
справочник СИ

Хронометражные
карты

Калькуляции

УТВЕРЖДЕННЫЙ ТИП В ГРСИ (OEI.BY)

ОЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

+375 (17) 337-77-99

INFO@OEI.BY

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Главная / Государственный реестр средств измерений (стандартных образцов) / Средства измерений

Основное

Наименование, тип и заводской номер (для единичных экземпляров средств измерений) средства измерений

Весы неавтоматического действия EJ

Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в ГРСИ и СО РБ

РБ 03 02 6579 18

Номер сертификата об утверждении типа средства измерений

11738

Дата внесения типа средства измерений

2018-05-31

Срок действия сертификата об утверждении типа средства измерений

2023-05-31

Сведения о методике поверки

Обозначение

Наименование

ГОСТ OIML R 76-1-2011

ГОСТ OIML R 76-1-2011

Интервал времени между государственными поверками

Интервал, месяцы

Условие

12

Информация о наличии возможности проведения работ по метрологической оценке в Республике Беларусь

Имеется

Признание результатов поверки средства измерений

-

Сведения о признании утверждения типа средств измерений зарубежного производства

Отсутствуют

Получатель сертификата об утверждении типа средства измерений

фирма "A&D Company, Limited", Япония (JP)

Категория

Код

Наименование

Файл сертификата утверждения типа и описания типа

Модификации

EJ-120

EJ-200

EJ-300

EJ-410

EJ-610

EJ-1500

EJ-2000

EJ-3000

EJ-4100

EJ-6100

EJ-123

EJ-303

Состояние сертификата об утверждении типа средства измерений (действующий, истекший)

Состояние:Истекший

Производитель средства измерений

Производитель средства измерений

Адрес производителя

Контактные данные производителя

фирма "A&D Company, Limited"

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013

+ 81 (3) 5391-6132, + 81 (3) 5191-6148

Категория средства измерений

Средства измерений массы

Вид средства измерений (единичный или серийно-выпускаемый экземпляр)

Серийно-выпускаемый экземпляр

Заккрыть

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНИК СИ

☆ Веса неавтоматического действия ЕЈ (Средство измерений)

Основное

Модификации средств измерений

Записать и закрыть

Записать

Печать

Еще

?

Основные данные

Шаблон результатов

Услуги

Код:

000011744

Наименование и обозначение
типа средств измерений:

Веса неавтоматического действия ЕЈ

Область измерений:

Средства измерений массы

ГРСИ:

РБ 03 02 6579 18 (18 - 23)

Метки (теги):

Не браковать прибор:

☐

?

Зонд:

☐

Методика поверки

(000000878) ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная систем...

Интервал	Условие
12	

Категории средства измерений (в соотв. с Постановлением №39)

Добавить

↑

↓

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще

N	Категория средства измерений
---	------------------------------

Комментарий:

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНИК СИ, СПИСОК МОДИФИКАЦИЙ СИ

☆ Весы неавтоматического действия EJ (Средство измерений)

[Основное](#) Модификации средств измерений


Модификации средств измерений

Создать Создать группу

Поиск (Ctrl+F) × Ещё ▾

Наименование ↓	Представление модификации	Описание модификации	Класс точности	Комментарий	Разряд
▬ EJ-120					
▬ EJ-123					
▬ EJ-1500					
▬ EJ-200					
▬ EJ-2000					
▬ EJ-300					
▬ EJ-3000					
▬ EJ-303					
▬ EJ-410					
▬ EJ-4100					
▬ EJ-610					
▬ EJ-6100					

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГИМ

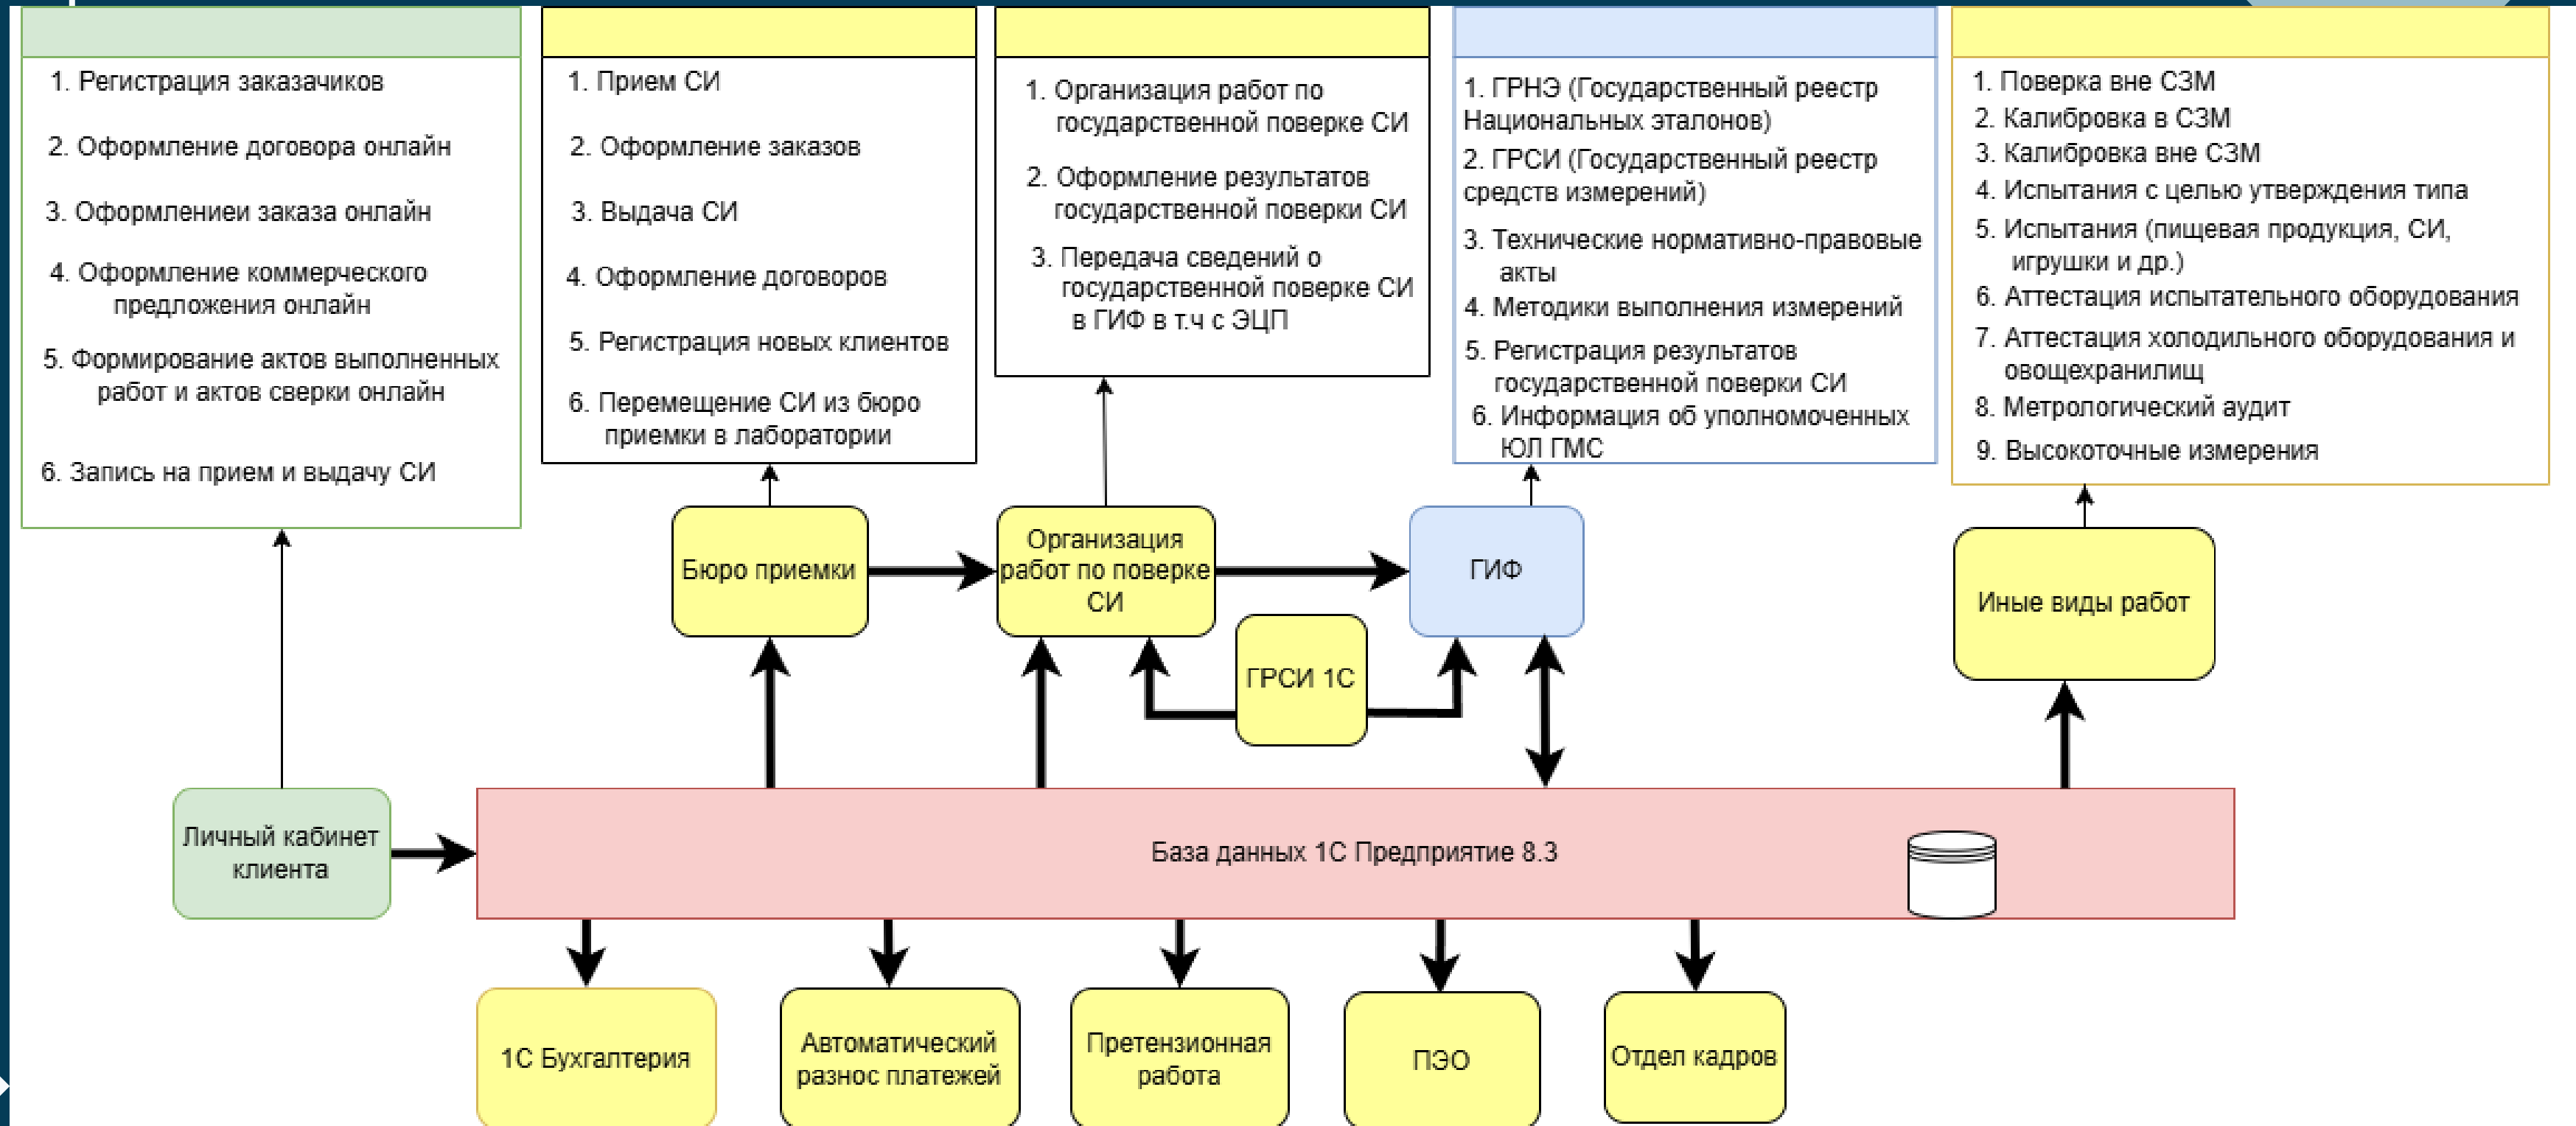

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- Повышение эффективности нашей совместной работы
- Обеспечение безупречного качества и юридической значимости сведений о государственной поверке СИ
- Создание основы для цифровой трансформации всей ГМС Республики Беларусь.
- Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь