

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ для Государственного реестра



Топливораздаточные колонки типа
112, 114
фирмы "TANKANLAGEN SALZKOTTEN
GmbH", Германия

Внесены в Государственный реестр средств
измерений Республики Беларусь
Регистрационный номер № РБ 03 07 0616 98
Взамен №

Выпускается по технической документации
"TANKANLAGEN SALZKOTTEN GmbH", Германия

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Колонки топливораздаточные типа **112, 114** (далее - колонки) применяются для измерения объема топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) вязкостью от 0,55 до 40 мм²/с (сСт) при выдаче его в топливные баки транспортных средств с учетом требований учетно-расчетных операций.

Колонки предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха и топлива от -40°C до +50°C и относительной влажности воздуха от 30% до 100%.

ОПИСАНИЕ

Пример обозначения:

- **112 / 50 .2 AE D50**
- **112 / 90 .4 3 AD EO GR**

Расшифровка обозначений:

112	- тип топливораздаточной колонки,
50 / 90	- номинальная производительность, л/мин,
.2	- с устройством вычисления стоимости, руб, калибруемая,
.4	- со счетчиком расхода, л, калибруемая,
3	- исполнение с пружинной мачтой (пустое место - с держателем шланга)
AE или AD	- дисплей расположен с одной или с двух сторон колонки,
EO	- присоединение к наземным резервуарам,
GR	- с возвратом газа,

Основными элементами колонки являются:

- счетчик (измеритель объема) поршневого типа **K90**, или объемно-шнековый счетчик типа **Ecometer (EM)**;
- электронно-вычислительное устройство EL-112, ER 112 - для колонок **112, 114**;
- насосный агрегат с газоотделяющим устройством производительностью 45 л/мин;
- фильтр тонкой очистки 12 мкм для бензина и 25 мкм для дизельного топлива;
- газоулавливающее устройство с поплавковым клапаном;
- раздаточный пистолет с рукавом длиной не менее 3,5 (6) метров.

Колонки выпускаются с встроенным насосом или без насоса. В последнем случае применяется насос, погружаемый в резервуар с жидкостью. При использовании колонок без насоса давление топлива на входе колонки должно быть не менее 2,8 (3.8) бар.

Модели 112 и 114 отличаются друг от друга внешним видом, габаритными размерами и компоновкой основных элементов. В топливораздаточной колонке типа 112 установлен поршневой счетчик, а в топливораздаточной колонке 114 установлен Ecometer.

Принцип действия колонок следующий:

- топливо из резервуара при помощи насоса с устройством для отделения паровоздушной смеси через фильтр и приемный клапан подается в счетчик (поршневой или объемно-шнековый), из которого через раздаточный шланг с пистолетом поступает в бак транспортного средства. При помощи преобразователя импульсов информация о количестве топлива, прошедшего через счетчик поступает в электронный блок колонки, на цифровом табло которого отображается количество отпущенного топлива, его цена и стоимость;
- установка показаний цифрового табло разового учета выданного объема топлива на нуль производится автоматически при снятии раздаточного пистолета с колонки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики каждого из типов колонок даны в **приложении 1**.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра может наноситься на фирменной табличке изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки в соответствии с технической документацией фирмы "TANKANLAGEN SALZKOTTEN GmbH", Германия.

ПОВЕРКА

Поверка колонок производится по методическим указаниям **МИ 1864-88 "ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки."**

Средства поверки:

- Мерники образцовые 2^{-го} разряда вместимостью 5, 10, 20, 50 и 100 литров по **ГОСТ 8.400-80**,
- Передвижная поверочная лаборатория ППЛ -ТМ.

Межповерочный интервал - 1 год.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ

Схема пломбировки узлов и элементов колонки приводится в **приложении 2**.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "TANKANLAGEN SALZKOTTEN GmbH", Германия и ГОСТ 9081 "Колонки топливораздаточные".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Топливораздаточные колонки типа 112, 114 соответствуют технической документации фирмы "TANKANLAGEN SALZKOTTEN GmbH", Германия и основным требованиям ГОСТ 9081.

Изготовитель: фирма "TANKANLAGEN SALZKOTTEN GmbH", Германия

Адрес: 33154 Salzkotten
Ferdinand - Henze - Straße 9

Факс: (05258) 13207

Заместитель директора ГПЦЭСМ

В.П.Лобко

Начальник отдела испытаний средств
измерений ГПЦЭСМ

С.В.Курганский

Инженер

М.В.Шабанов

Главный инженер фирмы "TANKANLAGEN
SALZKOTTEN GmbH", Германия

Franz-Josef Kersting






TANKANLAGEN SALZKOTTEN GMBH
Ferdinand-Henze-Str. 9
D - 33154 Salzkotten


Основные технические характеристики колонок топливораздаточных 112, 114

	112/50	112/52	112/90	112/92
	114/50	114/52	114/90	114/92
Количество насосов	1	1	1	1
Количество счетчиков, шт	1	1	1	1
Количество раздаточных рукавов, шт	1	1	1	1
Номинальный расход, л/мин	40	40	70	70
Наименьший расход, л/мин	5	5	2 / 4	2 / 4
Минимальная доза, л	2	2	2 / 4	2 / 4
Предел допускаемой основной погрешности, %	± 0.25			
Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающего воздуха, %, не более	± 0.25			
Сходимость показаний, %	± 0.25			
Рабочий объем счетчика, л	0,5	0,5	0,5	0,5
Емкость счетчика: стоимость, руб выдача топлива, л цена за один литр, руб суммарного учета, л	6 разрядов 6 разрядов 5 разрядов 7 разрядов			
Дискретность отсчета стоимость, руб выдача топлива, л цена за один литр, руб	по заказу 0,01 по заказу			
Мощность привода насоса, кВт	0,55	0,55	0,55	0,75
Напряжение питания, В	220/380 +10/-15%			
Габаритные размеры, мм, не более	1400x800x450			
Масса, кг	225	250	275	225
Длина раздаточного шланга, м, не менее	4	4	6	6
Средний срок службы, лет	12			
Средняя наработка на отказ, ч	7000			
Категория взрывозащитности	2ExedsIIBT3 или 2ExedIIDT3			

Приложение 2

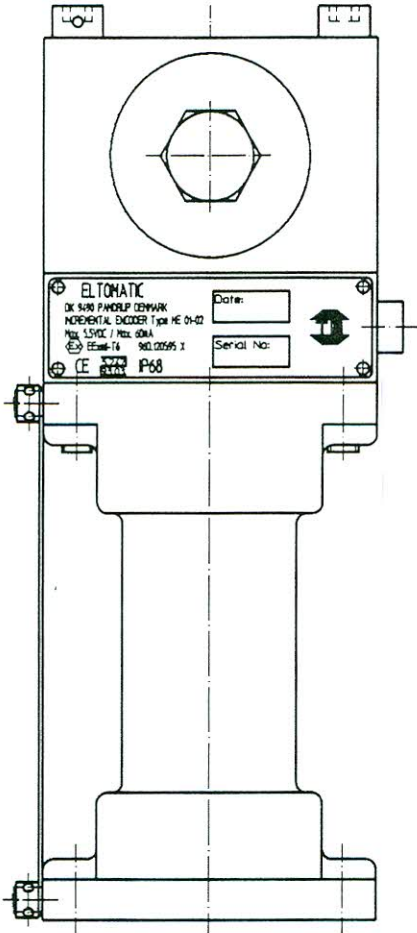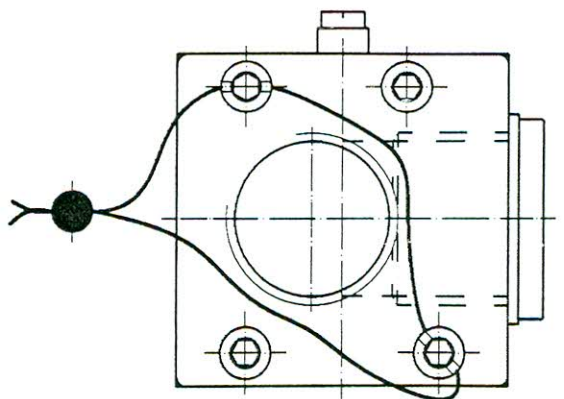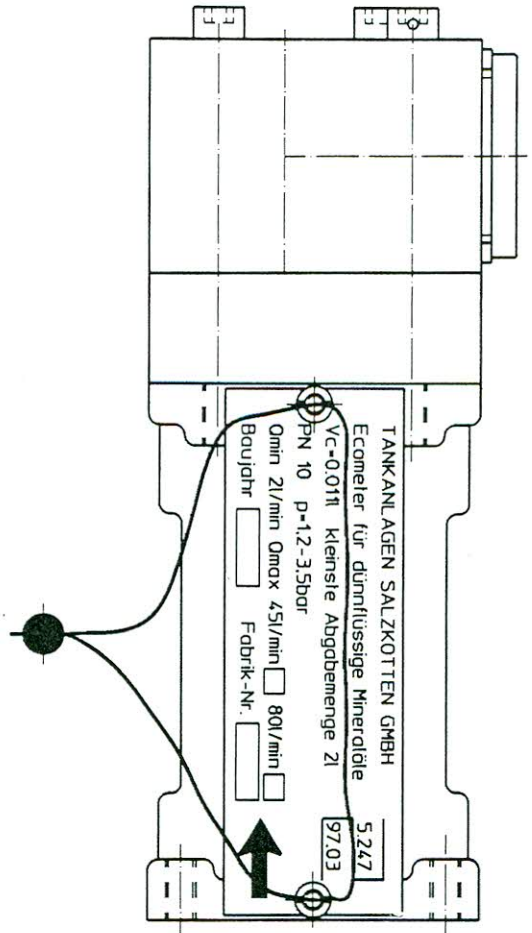

Allgemein- Toleranzen DIN ISO 2768		 TANKANLAGEN SALZKOTTEN GMBH 33147 Postfach 1157 33154 Salzkotten		Plumbenplan Ecometer		Werkstoff S.0 Werkstoff-Nr. S.0 Zeichnungs-Nr. 120 081 784			
Gen (l)	(l)								
Gen (m)	(m)								
Gen (cm)	(cm)								
Gen (mm)	(mm)								
Abt. EM	Gezeichnet	geprüft	CAD	Urtberschulzgezel nach DIN 34 beu hien. Diese Zeichnung der/ wecke veredelt, nach kllen Derenget mllgetel, nach dnen veredelt, nach kllen Sie mit der Verlegen, kllgetel zurckgeben					
Log	26. 02. 1998								
Name	Herksteler								
Kollstid									
/									

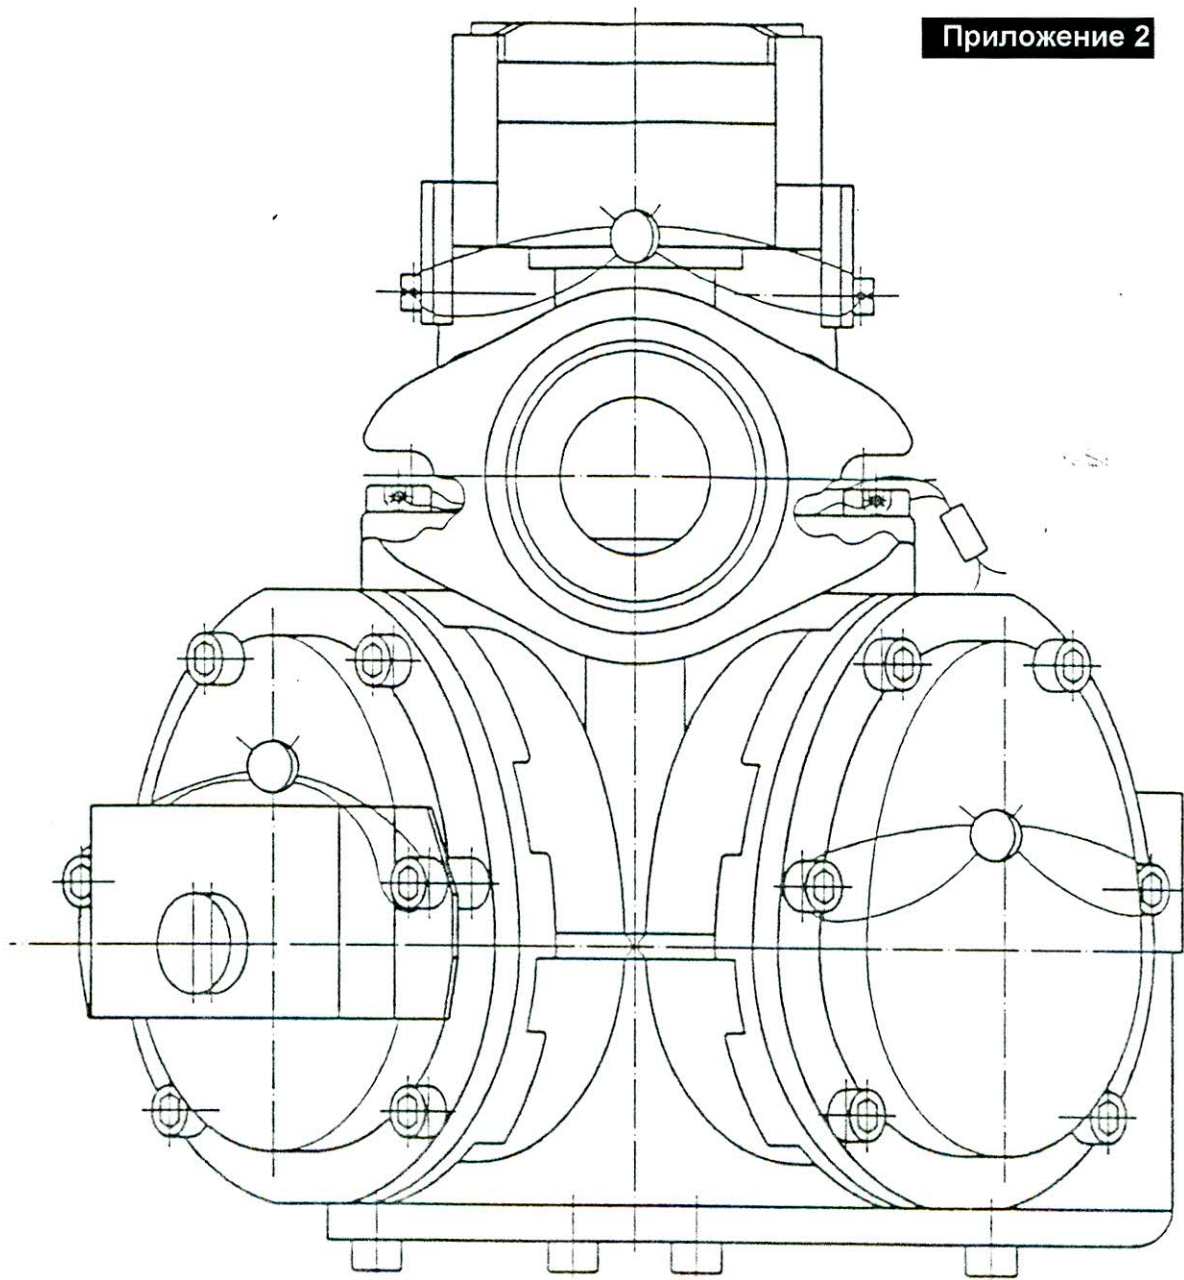

Tag		Name		Ind.	And.-Nr.	Art der Änderung	
Allgemein-Toleranzen DIN ISO 2768		 TANKANLAGEN SALZKOTTEN GMBH Ferdinand Henze Strasse 9 33154 Salzkotten				A.-Nr.	
						Werkstoff	
						Werkstoff-Nr.	
Abt.	EK	Gezeichnet	Geprüft	CAD	☒	Ersatz für	
Tag		12.08.93		INFO	☐	Ersetzt durch	
Name		Franke					
Maßstab 1:1.5		Stempelplan zum K90 mit ELTOMATIC-Impulsgeber				Artikel	
Nr. der Pause						120 063 424	