



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

5276

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

29 мая 2013 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип

Датчики крутящего момента серии Т,

фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия (DE),


который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 03 3756 08** и допущен к применению в Республике Беларусь с 29 мая 2008 г.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

С.А. Ивлев

29 мая 2008 г.

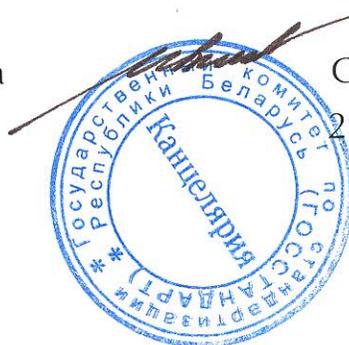

НТК по метрологии Госстандарта

№ 05-08

29 МАЙ 2008

секретарь НТК

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП "Белорусский
Государственный институт
метрологии"



Н.А. Жагора

" 10 2008

Датчики крутящего момента серии Т	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____
-----------------------------------	---

Выпускают по технической документации фирмы "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики крутящего момента серии Т предназначены для преобразования статических, квазистатических и динамических крутящих моментов в пропорциональный электрический сигнал.

Область применения — предприятия промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

ОПИСАНИЕ


Принцип действия датчиков заключается в преобразовании статических, квазистатических и динамических крутящих моментов в пропорциональный электрический сигнал. В электрической схеме датчиков предусмотрена схема термокомпенсации. Изменение электрического сопротивления тензорезисторов, соединенных в мостовую схему, при их деформации, возникающей в местах наклейки тензорезисторов к упругому элементу датчика под действием прилагаемой нагрузки вызывает разбаланс мостовой схемы и появление в диагонали моста электрического сигнала, изменяющегося пропорционально нагрузке.

Датчики выпускаются в модификациях Т4, Т4WA-S3, Т5, Т10F, Т10FM, Т10FS, Т10KF1, Т10SF1, Т10SU2, Т12, Т20WN, Т22, Т32FNA, Т34FN, Т40, ТВ1А, ТВ2.


Знак поверки на датчики не наносится.

Внешний вид датчиков приведен на рисунке 1.




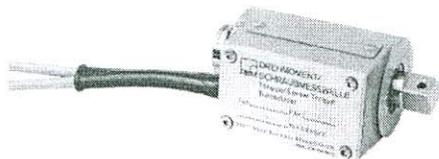


T4, T4WA-S3

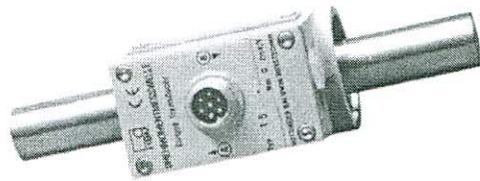


T5

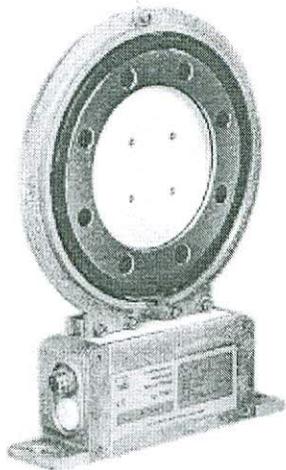

T10F

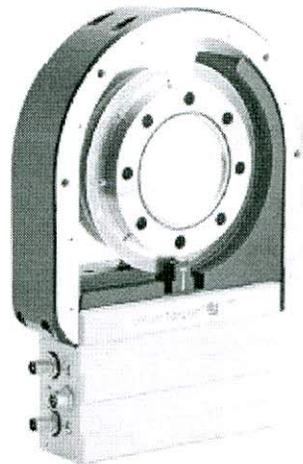

T12

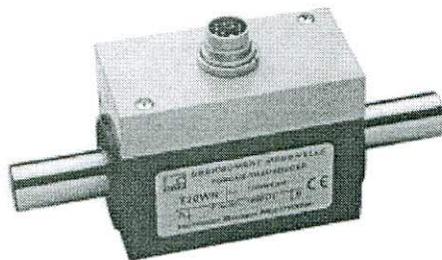

T20WN



T22



T40

Рисунок 1 - Внешний вид датчиков крутящего момента серии T



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики датчиков крутящего момента серии Т приведены в приложении А.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на фирменную табличку изделия и на техническую документацию фирмы.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки датчиков:

- датчик крутящего момента серии Т – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации – 1 комплект;
- методика поверки – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия.

МРБ МП.1827-2008 " Датчики крутящего момента серии Т. Методика поверки"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики крутящего момента серии Т соответствуют технической документации фирмы Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия.


Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (для датчиков, применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский
испытательный центр БелГИМ
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13
аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Германия
Адрес: Im Tiefen See 45, D-64293, Darmstadt, Deutschland, Postfach 100151

Начальник научно-исследовательского центра испытаний
средств измерений и техники БелГИМ

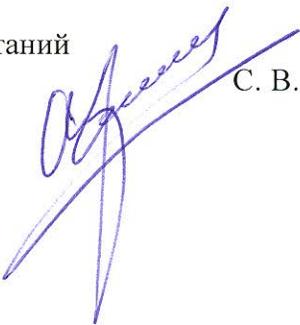
С. В. Курганский





Приложение А
Основные технические и метрологические характеристики
датчиков крутящего момента серии Т

Пределы допускаемой основной допускаемой погрешности датчиков

Серия датчиков	Диапазон измерений, Н×м	Основная допускаемая погрешность, %
Т4, Т4WA-S3, Т5	от 1 до 5	± 0,2
	от 5 до 1000	± 0,1
Т22	от 5 до 1000	± 0,5
Т10F	от 10 до 50	± 0,1
	от 50 до 10000	± 0,1
Т10FM Т10FS, Т10KF1, Т10SF1	от 3000 до 80000	± 0,1
Т10SU2	от 20 до 10000	± 0,05
Т20WN	от 0,1 до 200	± 0,2
Т32FNA	от 10 до 50	± 0,3
	от 50 до 200	± 0,2
	от 200 до 25000	± 0,1
Т34FN	от 0,2 до 20	± 0,2
ТВ1А	от 100 до 10000	± 0,05
ТВ2, Т12	от 500 до 10000	± 0,03
Т40	от 1000 до 2000	± 0,05

Технические и метрологические характеристики датчиков крутящего момента

Таблица 1

Техническая характеристика		ТВ1А						
Номинальный крутящий момент M_N	кН·м	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	±0,05						
Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности), не более	%	± 0,03						
Относительное стандартное отклонение воспроизводимости (относительно изменения выходного сигнала), не более	%	± 0,01						

Таблица 2

Техническая характеристика		ТВ2					
Номинальный крутящий момент M_N	Нм	500					
Номинальный крутящий момент M_N	кН м		1	2	3	5	10
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	±0,03					
Нелинейность, включая гистерезис, относительно номинальной чувствительности, не более	%	± 0,03					
Относительное стандартное отклонение воспроизводимости относительно изменения выходного сигнала, не более	%	± 0,01					



Таблица 3

Техническая характеристика		Т4А Т4WA-S3							
Номинальный крутящий момент M_N	Н·м	5	10	20	50	100	200	500	1000
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	±0,2	±0,1						
Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности), не более	%	±0,2	±0,1						
Относительное стандартное отклонение воспроизводимости (относительно изменения выходного сигнала), не более	%	± 0,05							

Таблица 4

Техническая характеристика		Т5				
Номинальный крутящий момент M_N	Н·м	10	20	50	100	200
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	±0,1				
Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности), не более	%	± 0,1				
Относительное отклонение воспроизводимости (относительно изменения выходного сигнала), не более	%	± 0,05				

Таблица 5

Техническая характеристика		Т10F							
Номинальный крутящий момент M_N	Н·м	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000
Пределы основной допускаемой относительной погрешности:									
- частотный выход, не более	%	± 0,1							
- выход по напряжению, не более	%	± 0,2							
- среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности, не более	%	± 0,03							

Таблица 6

Техническая характеристика		Т12					
Номинальный крутящий момент M_N	кН·м	0,5	1	2	3	5	10
Пределы основной допускаемой относительной погрешности:							
- частотный выход, не более	%	± 0,05					
- выход по напряжению, не более	%	± 0,1					
- среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности, не более	%	± 0,01					



Таблица 7

Техническая характеристика		T20WN										
Номинальный крутящий момент M_N	Н·м	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20	50	100	200
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	±0,2										
Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности), не более	%	± 0,2										
Относительное отклонение воспроизводимости (относительно изменения выходного сигнала), не более	%	± 0,1										

Таблица 8

Техническая характеристика		T22							
Номинальный крутящий момент M_N	Н·м	5	10	20	50	100	200	500	1000
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	±0,5							
Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности), не более	%	± 0,2							
Относительное отклонение воспроизводимости (относительно изменения выходного сигнала), не более	%	± 0,1							

Таблица 9

Техническая характеристика		T34FN				
Номинальный крутящий момент M_N	Н·м	1	2	5	10	20
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	±0,2				
Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности), не более	%	± 0,2				
Относительное отклонение воспроизводимости (относительно изменения выходного сигнала), не более	%	± 0,03				

Таблица 10

Техническая характеристика		T40	
Номинальный крутящий момент M_N	Н·м	1	2
Пределы основной допускаемой относительной погрешности	%	0,05	
Нелинейность, включая гистерезис (относительно номинальной чувствительности), не более	%	± 0,2	
Относительное отклонение воспроизводимости (относительно изменения выходного сигнала), не более	%	± 0,03	

