



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

5111

26 февраля 2013 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип

Весы платформенные М1100, М2200,

фирма "Marel ehf.", Исландия (IS),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 02 3663 08** и допущен к применению в Республике Беларусь с 26 февраля 2008 г.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



С.А. Ивлев

26 февраля 2008 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ 02-08

26 ФЕВ 2008

секретарь НТК

Описание типа средства измерений для Государственного реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ
Директор РУП "Белорусский
государственный институт метрологии"



Весы платформенные M1100, M2200

Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь
Регистрационный № РБ 03 02 3663 08

Выпускают по технической документации фирмы "Marel ehf." (Исландия).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы платформенные M1100, M2200 (далее – весы) предназначены для статического взвешивания грузов и определения массы продукции на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей, рыбной, консервной и других отраслей промышленности, а также для осуществления учетных операций и взаимных расчетов между предприятиями.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании веса груза, прикладываемого к грузоприемной платформе, в электрический сигнал, создаваемый весоизмерительными тензорезисторными датчиками, дальнейшем преобразовании этого сигнала весовым терминалом в цифровой вид для индикации.

Весы выпускаются в двух модификациях M1100-C2 и M2200-P02 и состоят из одной грузоприемной платформы и весового терминала, соединенных между собой при помощи кабеля или жесткой стойки. Грузоприемная платформа и корпус весового терминала изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали со степенью водонепроницаемости IP67.

Грузоприемная платформа может быть оснащена одним или несколькими (до четырех) весоизмерительными тензорезисторными датчиками и конструктивно имеет прямоугольную (PL xxxx) или U-образную форму (PU xxxx).

Весовые терминалы весов M1100-C2 и M2200-P02 отличаются количеством управляющих клавиш, прикладным программным обеспечением, объемом памяти, возможностью установки различных дополнительных интерфейсов передачи данных и подключения термопечатающих устройств. Дисплей весового терминала снабжен пылевлагонепроницаемой клавиатурой для ввода значения массы тары, обнуления показаний весов и выполнения иных функций. Результаты



измерения массы по последовательному интерфейсу RS-232C в весах M1100-C2, а в весах M2200-P02 и интерфейсу Ethernet, могут быть переданы на ПЭВМ или принтер.

Программное обеспечение весов M1100-C2 и M2200-P02 позволяет конфигурировать весы в однодиапазонном и двухдиапазонном исполнениях.

В однодиапазонном исполнении дискретность принимает одно значение во всем диапазоне измерения.

В двухдиапазонном исполнении для каждого диапазона измерений устанавливается свое конкретное значение дискретности. Весы могут работать в трех режимах:

- 1) нижний диапазон (Use Lo);
- 2) верхний диапазон (Use Hi);
- 3) совмещенный диапазон (Auto) – устанавливается по умолчанию.

При эксплуатации весов в совмещенном диапазоне происходит автоматическое переключение с нижнего на верхний диапазон измерений с изменением дискретности. Весы остаются в верхнем весовом диапазоне (даже если значение веса груза на платформе находится в нижнем диапазоне) до тех пор, пока не будет выполнена команда автоматического обнуления показаний или нажата кнопка Zero на весовом терминале.

Весы имеют следующие функции:

- тарирование (обычное и автоматическое тарирование, фиксация веса тары);
- автоматическое слежение за нулем;
- переключение диапазонов измерений;
- выбор и изменение сортировочных диапазонов, осуществление сортировки с уменьшением или увеличением веса;
- выбор и изменение диапазонов фасования/упаковывания продуктов; автоматическое или ручное фиксирование заданной номинальной массы упаковываемого продукта и заданных отклонений, а также фактической массы упаковываемого продукта;
- переключение единиц измерений (грамм, килограмм, фунт, унция и др.);
- сигнализация о перегрузке весов.

Питание весов осуществляется от сети переменного тока. Питание весов M1100-C2 и M2200-P02 может осуществляться от источника питания переменного тока, а весов M1100-C2 также от источников автономного питания (кроме моделей весов с платформой U-образной формы).

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа и указание мест нанесения поверительных клейм-наклеек и оттисков поверительный клейм, содержащих знак поверки средств измерений поверительного клейма-наклейки приведены в Приложении 1.

Общий вид весов приведен на рисунке 1.

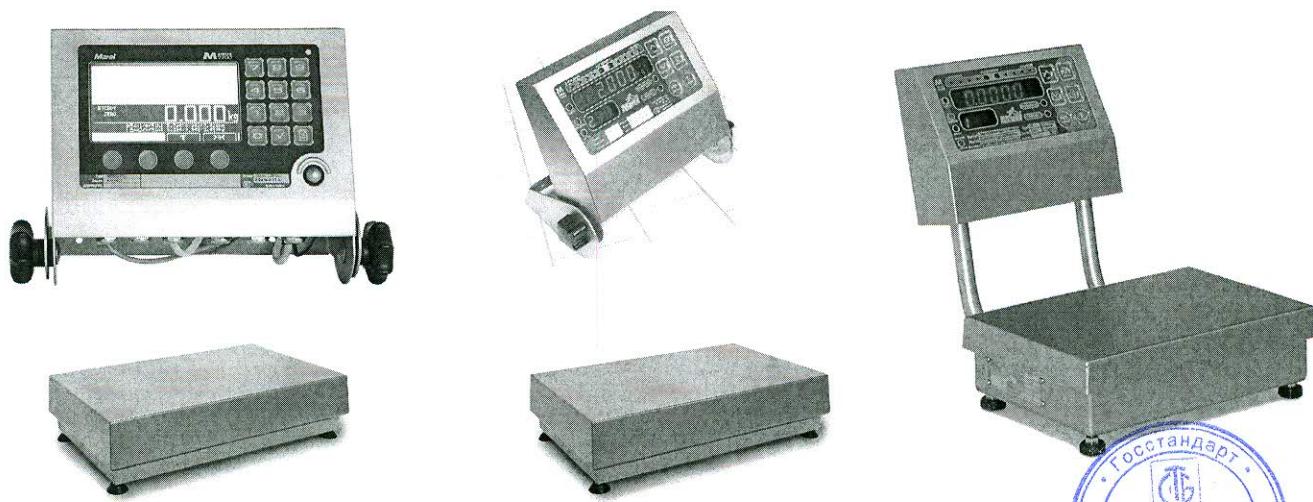


Рисунок 1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики весов приведены в таблицах 1 – 4.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Класс точности весов по ГОСТ 29329 и МОЗМ МР 76	III - средний
Цена поверочного деления (e), дискретность (d)	e = d
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг	20 e
Порог чувствительности	1,4 d
Диапазон выборки массы тары, кг	от 0 до НПВ включ.
Параметры электропитания весов M1100-C2 и M2200-P02 от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	230 $^{+23}_{-35}$ 50 ± 1
Параметры автономного электропитания весов M1100-C2: - напряжение, В - время автономной работы, час, не менее:	2 – 10 250
Потребляемая мощность, В·А, не более	37
Наибольший предел взвешивания (НПВ) однодиапазонных весов, кг	3; 6; 15; 25; 30; 60; 150; 300; 600; 1000; 1500; 2000; 3000
Число поверочных делений (n) однодиапазонных весов, не более	7500
Число поверочных делений (n_i) для i-го интервала двухдиапазонных весов, не более	3000
Дискретность (d) однодиапазонных весов, г	выбирается из ряда значений $\{1; 2; 5\} \cdot 10^k$, где k – целое число, при условии $500 \leq \text{НПВ}/d \leq n$
Диапазон рабочих температур для грузоприемной платформы и весового терминала, °C	от минус 10 до плюс 40

Пределы допускаемой погрешности однодиапазонных весов при первичной поверке и в эксплуатации представлены в таблице 2.

Таблица 2

Интервалы взвешивания	Пределы допускаемой погрешности	
	при первичной поверке	в эксплуатации
до 500 е включ.	± 0,5 е	± 1,0 е
св. 500 е до 2000 е включ.	± 1,0 е	± 2,0 е
св. 2000 е	± 1,5 е	± 3,0 е

Значения НПВ, НмПВ, дискретности (d), цены поверочного деления (e) и пределов допускаемой погрешности двухдиапазонных весов при первичной поверке и в эксплуатации для каждого интервала взвешивания приведены в таблице 3.



Таблица 3

Диапазоны взвешивания, кг	НПВ, кг	НмПВ, г	Интервалы взвешивания	д и е, г	Пределы допускаемой погрешности, г, при	
					первичной поверке	в эксплуатации
1	2	3	4	5	6	7
1,5 / 3	1,5	10	до 0,25 кг включ.	0,5	± 0,25	± 0,5
			св. 0,25 до 1 кг включ.		± 0,5	± 1,0
			св. 1 до 1,5 кг включ.		± 0,75	± 1,5
	3	20	до 0,5 кг включ.	1	± 0,5	± 1,0
			св. 0,5 до 2 кг включ.		± 1,0	± 2,0
			св. 2 кг		± 1,5	± 3,0
3 / 6	3	20	до 0,5 кг включ.	1	± 0,5	± 1,0
			св. 0,5 до 2 кг включ.		± 1,0	± 2,0
			св. 2 кг		± 1,5	± 3,0
	6	40	до 1 кг включ.	2	± 1,0	± 2,0
			св. 1 до 4 кг включ.		± 2,0	± 4,0
			св. 4 кг		± 3,0	± 6,0
6 / 15	6	40	до 1 кг включ.	2	± 1,0	± 2,0
			св. 1 до 4 кг включ.		± 2,0	± 4,0
			св. 4 кг		± 3,0	± 6,0
	15	100	до 2,5 кг включ.	5	± 2,5	± 5,0
			св. 2,5 до 10 кг включ.		± 5,0	± 10,0
			св. 10 кг		± 7,5	± 15,0
15 / 25	15	100	до 2,5 кг включ.	5	± 2,5	± 5,0
			св. 2,5 до 10 кг включ.		± 5,0	± 10,0
			св. 10 кг		± 7,5	± 15,0
	25	200	до 5 кг включ.	10	± 5,0	± 10,0
			св. 5 до 20 кг включ.		± 10,0	± 20,0
			св. 20 кг		± 15,0	± 30,0
15 / 30	15	100	до 2,5 кг включ.	5	± 2,5	± 5,0
			св. 2,5 до 10 кг включ.		± 5,0	± 10,0
			св. 10 кг		± 7,5	± 15,0
	30	200	до 5,0 кг включ.	10	± 5,0	± 10,0
			св. 5,0 до 20 кг включ.		± 10,0	± 20,0
			св. 20 кг		± 15,0	± 30,0
30 / 60	30	200	до 5,0 кг включ.	10	± 5,0	± 10,0
			св. 5,0 до 20 кг включ.		± 10,0	± 20,0
			св. 20 кг		± 15,0	± 30,0
	60	400	до 10,0 кг включ.	20	± 10,0	± 20,0
			св. 10,0 до 40 кг включ.		± 20,0	± 40,0
			св. 40 кг		± 30,0	± 60,0



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7
60 / 150	60	400	до 10,0 кг включ.	20	± 10,0	± 20,0
			св. 10,0 до 40 кг включ.		± 20,0	± 40,0
			св. 40 кг		± 30,0	± 60,0
	150	1000	до 25 кг включ.	50	± 25,0	± 50,0
			св. 25 до 100 кг включ.		± 50,0	± 100,0
			св. 100 кг		± 75,0	± 150,0
	150 / 300	150	до 25 кг включ.	50	± 25,0	± 50,0
			св. 25 до 100 кг включ.		± 50,0	± 100,0
			св. 100 кг		± 75,0	± 150,0
300 / 600	300	2000	до 50 кг включ.	100	± 50,0	± 100,0
			св. 50 до 200 кг включ.		± 100,0	± 200,0
			св. 200 кг		± 150,0	± 300,0
	600	4000	до 100 кг включ.	200	± 100,0	± 200,0
			св. 100 до 400 кг включ.		± 200,0	± 400,0
			св. 400 кг		± 300,0	± 600,0
	600 / 1000	600	до 100 кг включ.	200	± 100,0	± 200,0
			св. 100 до 400 кг включ.		± 200,0	± 400,0
			св. 400 кг		± 300,0	± 600,0
600 / 1500	1000	10000	до 250 кг включ.	500	± 250,0	± 500,0
			св. 250 кг		± 500,0	± 1000,0
			св. 400 кг		± 100,0	± 200,0
	600	4000	до 100 кг включ.	200	± 200,0	± 400,0
			св. 100 до 400 кг включ.		± 300,0	± 600,0
			св. 400 кг		± 250,0	± 500,0
	1500	10000	до 250 кг включ.	500	± 500,0	± 1000,0
			св. 250 до 1000 кг включ.		± 750,0	± 1500,0
			св. 1000 кг		± 250,0	± 500,0
1500 / 2000	1500	10000	до 250 кг включ.	500	± 500,0	± 1000,0
			св. 250 до 1000 кг включ.		± 750,0	± 1500,0
			св. 1000 кг		± 500,0	± 1000,0
	2000	20000	до 500 кг включ.	1000	± 500,0	± 1000,0
			св. 500 кг		± 1000,0	± 2000,0
			св. 1000 кг		± 250,0	± 500,0
1500 / 3000	1500	10000	до 250 кг включ.	500	± 500,0	± 1000,0
			св. 250 до 1000 кг включ.		± 750,0	± 1500,0
			св. 1000 кг		± 250,0	± 500,0
	3000	20000	до 500 кг включ.	1000	± 500,0	± 1000,0
			св. 500 до 2000 кг включ.		± 1000,0	± 2000,0
			св. 2000 кг		± 500,0	± 1500,0



Наименования исполнений весов, значения массы и габаритных размеров грузоприемных платформ весов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение исполнений весов	НПВ, кг	Габаритные размеры платформы (ширина × длина), мм	Масса платформы, кг, не более
1	2	3	4
M1100-C2 PL1000, M2200-P02 PL1000 M1100-C2 PL2010	3; 1,5/3	170 × 250 246 × 296	3,6 6,6
M1100-C2 PL2010, M2200-P02 PL2010	6; 3/6	246 × 296	6,6
M1100-C2 PL2010, M2200-P02 PL2010 M1100-C2 PL3000, M2200-P02 PL3000	15; 6/15	246 × 296 296 × 396	6,6 10,9
M1100-C2 PL3000, M2200-P02 PL3000	25; 30; 15/25; 15/30	296 × 396	10,9
M1100-C2 PL4000, M2200-P02 PL4000 M1100-C2 PL6038, M2200-P02 PL6038 M1100-C2 PL6050, M2200-P02 PL6050	60; 30/60	400 × 550 380 × 600 500 × 600	28,8 40,0 43,0
M1100-C2 PL4000, M2200-P02 PL4000 M1100-C2 PL6050, M2200-P02 PL6050	150; 60/150	400 × 550 500 × 600	28,8 43,0
M1100-C2 PL6050, M2200-P02 PL6050	300; 150/300	500 × 600	43,0
M1100-C2 PU8000, M2200-P02 PU8000 M1100-C2 PU9000, M2200-P02 PU9000 M1100-C2 PU9010, M2200-P02 PU9010	300/600; 600; 1000; 600/1000; 600/1500	845 × 1248 1100 × 1248 1230 × 1248	43,5 43,8 44,0
M1100-C2 PU8000, M2200-P02 PU8000 M1100-C2 PU9000, M2200-P02 PU9000 M1100-C2 PU9010, M2200-P02 PU9010	1500; 2000; 1500/2000	845 × 1248 1100 × 1248 1230 × 1248	43,5 43,8 44,0
M1100-C2 PU8000, M2200-P02 PU8000 M1100-C2 PU9000, M2200-P02 PU9000 M1100-C2 PU9010, M2200-P02 PU9010	3000; 1500/3000	845 × 1248 1100 × 1248 1230 × 1248	43,5 43,8 44,0

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Знак утверждения типа средств измерений наносится в виде клеевой этикетки на табличку, закрепленную на корпусе весов и/или на руководство по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Весы – 1 шт.;
2. Краткое руководство пользователя – 1 экз.;
3. CD-диск с руководством по эксплуатации – 1 экз.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29329-92 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования";
МОЗМ МР 76 «Взвешивающие устройства неавтоматического действия»;
ГОСТ 8.453-82 " Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки";
Техническая документация фирмы "Marel ehf." (Исландия).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы платформенные M1100, M2200 соответствуют требованиям ГОСТ 29329-92 и технической документации фирмы "Marel ehf." (Исландия).

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (для весов, применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ,
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13,
Аттестат аккредитации № BY 112.02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

фирма "Marel ehf." (Исландия)
Austurhraun 9, 210 Gardabaer, Iceland
Tel: +354 563 8000, Fax: +354 563 8001

Начальник НИЦИСИиТ БелГИМ

С.В.Курганский



Приложение 1
(обязательное)

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа и
указание мест нанесения поверительного клейма-наклейки и оттисков поверительный клейм,
содержащих знак поверки средств измерений

