

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич

19 12 2019



Счетчики газа диафрагменные СГД 4	Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания Регистрационный номер № <u>РБ 03 07 5778 18</u>
--------------------------------------	---

Выпускают по ТУ BY 100185185.229 - 2013 «Счетчики газа диафрагменные СГД 4».

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики газа диафрагменные СГД 4 (далее счетчики) предназначены для измерения израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542 или паров сжиженного углеводородного газа по СТБ 2262, а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях.

Область применения – объекты социального и культурно-бытового назначения, жилые дома.

ОПИСАНИЕ

Счетчик состоит из двух камер, внутренние полости которых разделены газонепроницаемыми диафрагмами. Диафрагмы перемещаются за счет разницы давления газа на входе и выходе счетчика и приводят во вращение отсчётное устройство, находящееся на лицевой панели счетчика.

Структура полного обозначения счетчиков газа в зависимости от исполнения:

СГД 4-х-х-Х х х

- Расстояние между осями штуцеров, циклический объем и резьба на присоединительных патрубках;
- Направление потока газа;
- Номинальный расход;
- Наличие устройства компенсации;
- Наличие дополнительного устройства.

По расстоянию между осями штуцеров, циклическому объему и резьбы на присоединительных патрубках:

- 1 – расстояние между осями штуцеров 110 мм и циклический объем 1,2 дм³/об, резьба на присоединительных патрубках G1;
- 2 – расстояние между осями штуцеров 150 мм и циклический объем 2 дм³/об, резьба на присоединительных патрубках G1^{1/4};
- 3 – расстояние между осями штуцеров 110 мм и циклический объем 1,2 дм³/об, резьба на присоединительных патрубках G1^{1/4};

По направлению потока газа:

- 1 – направление потока газа левое;
- 2 – направление потока газа правое;



По номинальному расходу:

- 1,6 – номинальный расход типоразмера G1,6;
- 2,5 – номинальный расход типоразмера G2,5;
- 4 – номинальный расход типоразмера G4;
- 6 – номинальный расход типоразмера G6;
- U – универсальный.

По наличию устройства компенсации, которое производит коррекцию показаний счетного механизма в зависимости от температуры пропускаемого газа:

- СГД 4-х-х-Х х – без устройства компенсации;
- СГД 4-х-х-Х Т х – с устройством механического термокомпенсатора.

По наличию дополнительного устройства:

- СГД 4-х-х-Х х И – с устройством импульсного выхода;
- СГД 4-х-х-Х х R – с каналом беспроводной передачи данных.

Счетчики исполнений СГД 4-х-х-Х х И, СГД 4-х-х-Х х R могут быть встроены в единую систему автоматизированного сбора и обработки информации.

По устойчивости и прочности к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики должны соответствовать по ГОСТ 12997 группе исполнения С3 при температуре от минус 10 °C до плюс 50 °C для типоразмеров G1,6, G2,5 и группе исполнения С4 при температуре от минус 40 °C до плюс 50 °C для типоразмеров G4, G6.

Степень защиты счетчиков исполнений СГД 4-х-х-XR, СГД 4-х-х-XTR от проникновения воды и пыли IP30 по ГОСТ 14254.

По стойкости к термическому воздействию окружающей среды счетчики относятся к I классу (стальной корпус) по СТБ 1159.

Наибольшее избыточное рабочее давление счетчиков:

- исполнение СГД 4-1-..., СГД 4-3-... – 30 кПа;
- исполнение СГД 4-2-... – 60 кПа.

Условное обозначение вариантов исполнения счетчиков приведено в приложении А.

Направление потока газа обозначено стрелкой на крышке счетчика

Внешний вид счетчиков представлен на рисунках 1-3.

Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведено в приложении Б к описанию типа.



Рисунок 1 – Общий вид счетчиков газа СГД 4-х-х-Х, СГД 4-х-х-XT

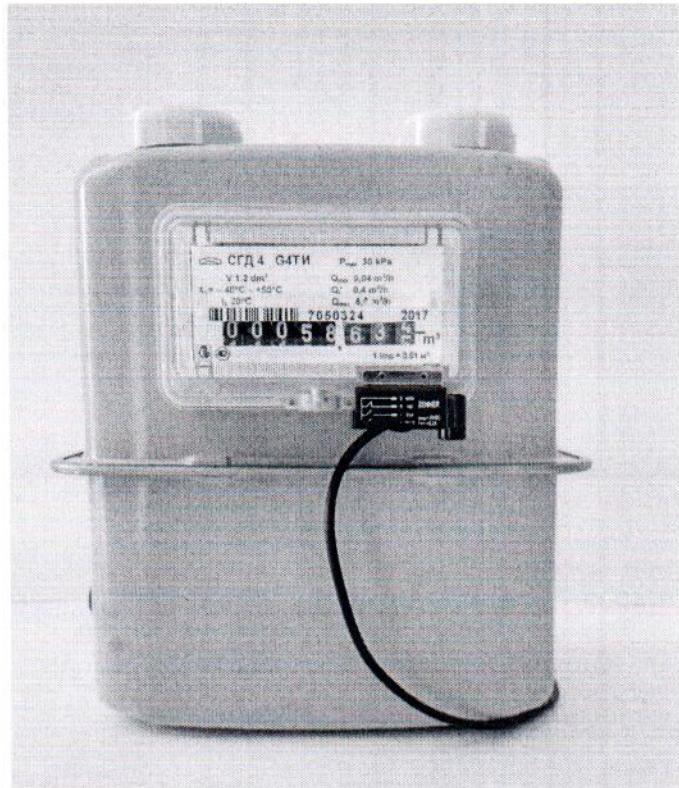


Рисунок 2 – Общий вид счетчиков газа СГД 4-х-х-ХИ, СГД 4-х-х-ХТИ

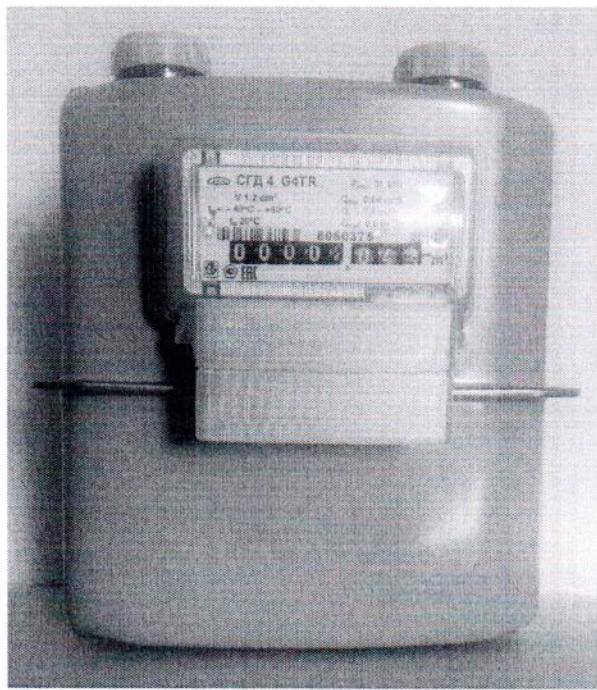


Рисунок 3 – Общий вид счетчиков газа СГД 4-х-х-ХР, СГД 4-х-х-ХТР



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры счетчиков приведены в таблице 1
Таблица 1

Наименование	Типоразмер					
	СГД 4-1-х / СГД 4-3-х-			СГД 4-х-х-	СГД 4-2-х-	
	G1,6	G2,5	G4	U	G4	G6
1 Номинальный расход ($Q_{\text{ном}}$), $\text{м}^3/\text{ч}$	1,6	2,5	4	2,5	4	6
2 Минимальный расход ($Q_{\text{мин}}$), $\text{м}^3/\text{ч}$, не более	0,016	0,025	0,04	0,016	0,04	0,06
3 Максимальный расход ($Q_{\text{макс}}$), $\text{м}^3/\text{ч}$, не менее	2,5	4	6	6	6	10
4 Допускаемая потеря давления на счетчике при номинальном расходе ($\Delta P_{Q_{\text{ном}}}$), Па, не более	80				125	
5 Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе ($\Delta P_{Q_{\text{макс}}}$), Па, не более	200				250	
6 Габаритные размеры (длина \times ширина \times высота), мм, не более	210×175×245				240×195×270	
7 Расстояние между осями штуцеров, мм	$110 \pm 0,15$				$150 \pm 0,15$	
8 Масса, кг, не более	2,3				4,1	
9 Резьба на присоединительных патрубках, трубная по ГОСТ 6357	G1 / G1 $\frac{1}{4}$			G1 $\frac{1}{4}$		

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика при выпуске из производства и после ремонта:

± 3 % в диапазоне расходов от $Q_{\text{мин}}$ до $0,1 Q_{\text{ном}}$ включительно;

± 1,5 % в диапазоне расходов свыше $0,1 Q_{\text{ном}}$ до $Q_{\text{макс}}$ включительно.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности в процессе эксплуатации:

± 4 % в диапазоне расходов от $Q_{\text{мин}}$ до $0,1 Q_{\text{ном}}$ включительно;

± 3 % в диапазоне расходов свыше $0,1 Q_{\text{ном}}$ до $Q_{\text{макс}}$ включительно.

Дополнительная относительная погрешность счетчиков, вызванная отклонением температуры измеряемого газа от нормальной, по сравнению с основной относительной погрешностью не должна превышать:

– ± 0,45 % при изменении температуры на 1 °C в пределах от минус 10 °C до плюс 50 °C для счетчиков газа исполнений СГД 4-х-х-G1,6, СГД 4-х-х-G1,6И, СГД 4-х-х-G1,6R, СГД 4-х-х-G2,5, СГД 4-х-х-G2,5И, СГД 4-х-х-G2,5R;

– ± 0,1 % при изменении температуры на 1 °C в пределах от минус 10 °C до плюс 50 °C для счетчиков газа исполнений СГД 4-х-х-G1,6T, СГД 4-х-х-G1,6ТИ, СГД 4-х-х-G1,6TR, СГД 4-х-х-G2,5T, СГД 4-х-х-G2,5ТИ, СГД 4-х-х-G2,5TR;

– ± 0,45 % при изменении температуры на 1 °C в пределах от минус 40 °C до плюс 50 °C для счетчиков газа исполнений СГД 4-х-х-G4, СГД 4-х-х-G4И, СГД 4-х-х-G4R, СГД 4-3-х-U, СГД 4-3-х-УИ, СГД 4-3-х-UR, СГД 4-2-х-G6, СГД 4-2-х-G6И;

– ± 0,1 % при изменении температуры на 1 °C в пределах от минус 40 °C до плюс 50 °C для счетчиков газа исполнений СГД 4-х-х-G4T, СГД 4-х-х-G4ТИ, СГД 4-х-х-G4TR, СГД 4-3-х-UT, СГД 4-3-х-УТИ, СГД 4-х-х-UTR;

– ± 0,45 % при изменении температуры на 1 °C в пределах от плюс 35 °C до плюс 50 °C для счетчиков газа исполнений СГД 4-2-х-G4T, СГД 4-2-х-G4ТИ, СГД 4-2-х-G6T;



СГД 4-2-х-Г6ТИ;

– ± 0,1 % при изменении температуры на 1 °C в пределах от минус 40 °C до плюс 35 °C для счетчиков газа исполнений СГД 4-2-х-Г4Т, СГД 4-2-х-Г4ТИ, СГД 4-2-х-Г6Т, СГД 4-2-х-Г6ТИ;

Порог чувствительности счетчиков не более 0,002 Q_{ном}.

Циклический объем счетчиков:

- 1,2 дм³/об для исполнений: СГД 4-1-х-Х х х, СГД 4-3-х-Х х х;
- 2 дм³/об для исполнений СГД 4-2-х-Х х х.

Один импульс устройства импульсного выхода соответствует объему 0,01 м³, прошедшего через счетчик газа, что соответствует одному обороту цифрового диска младшего разряда.

Электрические характеристики цепи устройства импульсного выхода:

- напряжение U_{max} ≤ 12 В,
- сила тока I_{max} ≤ 10 мА.

Технические характеристики модуля бесконтактной передачи данных и сервисные программы – согласно ТУ производителя.

Счетчик прочный и герметичный при воздействии внутреннего давления в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление.

Конструкция соединительных элементов счетчика обеспечивает прочность и герметичность при присоединении счетчика к подводящему газопроводу при воздействии внутреннего давления в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление, изгибающего момента 20 Н·м и крутящего момента 80 Н·м. для счетчиков с резьбой на патрубках G1 и изгибающего момента 110 Н·м и крутящего момента 140 Н·м для счетчиков с резьбой на патрубках G1^{1/4}.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевой панели счетчика методом тампопечати и в паспорте типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
Счетчик газа диафрагменный СГД 4-х-х-Х х х	1
Крышка	2
Переходник (Сталь ГОСТ 380 или ГОСТ 1050) *	2
Гайка (Чугун КЧ 30-6-Ф ГОСТ 1215) *	2
Прокладка (Резина МБС ГОСТ 7338) *	2
Упаковка	1
Паспорт	1
Устройство импульсного выхода **	1
Шуруп 4-2,5 × 10.016 ГОСТ 1144 **	1
Методика поверки МРБ МП.1778-2008 ***	1

* Входят в комплект счетчиков, планируемых к применению на территории Республики Беларусь и по требованию заказчика.

** Устанавливаются на счетчик или входят в комплект счетчиков СГД 4-х-х-Х х И, планируемых к применению на территории Республики Беларусь и по требованию заказчика.

*** Поставляется специализированным газораспределительным предприятием.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ BY 100185185.229-2013 «Счетчики газа диафрагменные СГД 4».

СТБ 1159 – 99 «Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний».

СТБ 8011 – 99 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа. Методика поверки»

МРБ МП.1778-2008 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа СГМН-1, СГД-1, СГД-3Т, СГД 4. Методика поверки» - применяется только для счетчиков исполнений СГД 4-х-х-Х х И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики газа диафрагменные СГД 4 соответствуют требованиям СТБ1159-99, ТУ BY 100185185.229-2013.

Межповерочный интервал – не более 120 месяцев.

Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии Республики Беларусь – не более 96 месяцев.

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ

г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13

Аттестат аккредитации № BY/112 1.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО». Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23, Тел. 267-11-90

Начальник научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники БелГИМ

Д.М. Каминский

Заместитель генерального директора –
главный инженер ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова –
управляющая компания холдинга «БелОМО»



Д.В. Михальцов



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ

Таблица А.1

Условное обозначение варианта исполнения	Обозначение основного конструкторского документа	Наибольшее избыточное рабочее давление, кПа	Расстояние между осями штуцеров, мм	Циклический объем, дм ³ /об	Резьба на присоединительных патрубках, трубная	Направление потока газа	
1	2	3	4	5	6	7	8
СГД 4 – 2 – 1 – G6	8266.00.00.000	G6				Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G6		-01				Правое	
СГД 4 – 2 – 1 – G4		-02	G4			Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G4		-03				Правое	
СГД 4 – 2 – 1 – G6Т		-40	G6			Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G6Т		-41				Правое	
СГД 4 – 2 – 1 – G4Т		-42	G4			Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G4Т		-43		150		Правое	
СГД 4 – 2 – 1 – G6И		-04				Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G6И		-05	G6			Правое	
СГД 4 – 2 – 1 – G6ТИ		-44				Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G6ТИ		-45				Правое	
СГД 4 – 2 – 1 – G4И		-06				Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G4И		-07	G4			Правое	
СГД 4 – 2 – 1 – G4ТИ		-46				Левое	
СГД 4 – 2 – 2 – G4ТИ		-47				Правое	



Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
СГД 4 – 3 – 1 – G4	8336.00.00.000						Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G4							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G4И							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G4И							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G4Т							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G4Т							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G4ТИ							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G4ТИ							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G4R							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G4R							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G4TR							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G4TR							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – U							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – U							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – UI							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – UI							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – UT							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – UT							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – UTI							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – UTI							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – UR							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – UR							Правое
СГД 4 – 3 – 1 – UTR							Левое
СГД 4 – 3 – 2 – UTR							Правое

G4

1,2

30

G1^{1/4}

110



Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
СГД 4 – 1 – 1 – G4	8336.00.000 – 40						Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G4		-41					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G4И		-42					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G4И		-43					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G4Т		-44					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G4Т		-45					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G4ТИ		-46					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G4ТИ		-47					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G4R		-48					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G4R		-49					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G4TR		-50					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G4TR		-51					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G1,6		-52					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G1,6		-53					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G1,6И		-54					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G1,6И		-55					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G1,6Т		-56					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G1,6Т		-57					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G1,6ТИ		-58					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G1,6ТИ		-59					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G1,6R		-60					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G1,6R		-61					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G1,6TR		-62					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G1,6TR		-63					Правое

G1

1,2

110

30

G1,6



Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
СГД 4 – 1 – 1 – G2,5	8336.00.00.000 – 64						Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G2,5		-65					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G2,5И		-66					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G2,5И		-67					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G2,5Т		-68					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G2,5Т		-69					Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G2,5ТИ		G2,5					Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G2,5ТИ			-70				Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G2,5R			-71				Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G2,5R			-72				Правое
СГД 4 – 1 – 1 – G2,5TR			-73				Левое
СГД 4 – 1 – 2 – G2,5TR			-74				Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G1,6			-75				Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G1,6			-76				Правое
СГД 4 – 3 – 2 – G1,6И			-77				Левое
СГД 4 – 3 – 1 – G1,6И			-78				Правое
СГД 4 – 3 – 2 – G1,6И			-79				Левое
СГД 4 – 3 – 1 – G1,6Т			-80				Правое
СГД 4 – 3 – 2 – G1,6Т			-81				Левое
СГД 4 – 3 – 1 – G1,6ТИ			-82				Правое
СГД 4 – 3 – 2 – G1,6ТИ			-83				Левое
СГД 4 – 3 – 1 – G1,6R			-84				Правое
СГД 4 – 3 – 2 – G1,6R			-85				Левое
СГД 4 – 3 – 1 – G1,6TR			-86				Правое
СГД 4 – 3 – 2 – G1,6TR			-87				Правое

G1

1,2

110

30

G1,6

G1^{1/4}



Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
СГД 4 – 3 – 1 – G2,5	83336.00.000.000 – 88						Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G2,5		- 89					Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G2,5И		- 90					Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G2,5И		- 91					Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G2,5Т		- 92					Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G2,5Т		- 93					Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G2,5ТИ		- 94					Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G2,5ТИ		- 95					Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G2,5R		- 96					Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G2,5R		- 97					Правое
СГД 4 – 3 – 1 – G2,5TR		- 98					Левое
СГД 4 – 3 – 2 – G2,5TR		- 99					Правое

G1^{1/4}

1,2

G2,5


30

110



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Места пломбирования и клеймения

Место нанесения знака поверки
в виде клейма-наклейки

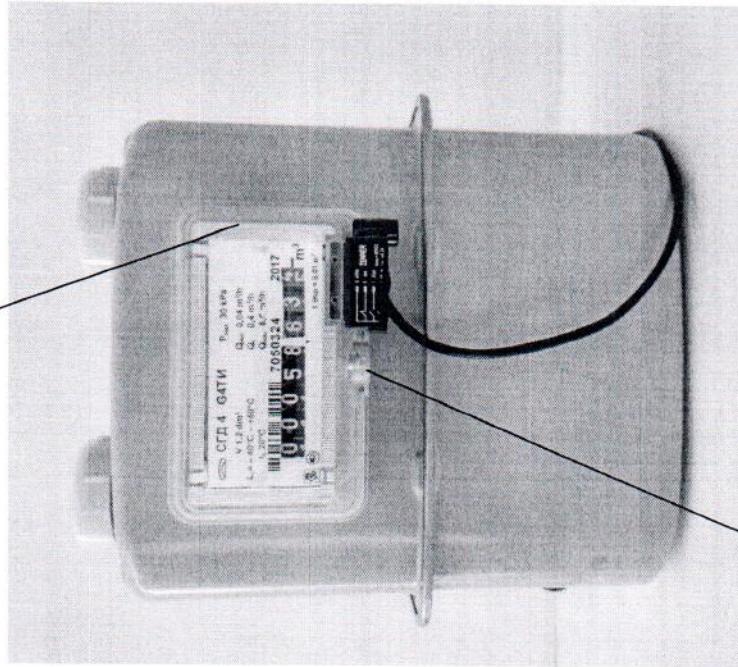

Места пломбирования

