

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**



УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич

" 28 " 08 2020

Пипетки градуированные «Klin» 2 класса точности	Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный номер № РБ 03 27 7738 20
--	--

Выпускают по технической документации фирмы «Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company», Китай.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пипетки градуированные «Klin» 2 класса точности (далее – пипетки) предназначены для отмеривания точных объемов жидкостей.

Область применения – только на Государственном предприятии «Белорусская АЭС».

ОПИСАНИЕ

Пипетки представляют собой прямые стеклянные цилиндрические трубки с узким вытянутым концом. На пипетках нанесена шкала, соответствующая номинальной вместимости. Пипетки вымеряют на слив. На все пипетки нанесен цветной код.

Пипетки изготавливают из стекла, обладающего необходимыми свойствами химической и термической стойкости. Пипетки отличаются вместимостью.

Общий вид пипеток представлен на рисунке 1. Пломбирование пипеток не предусмотрено.

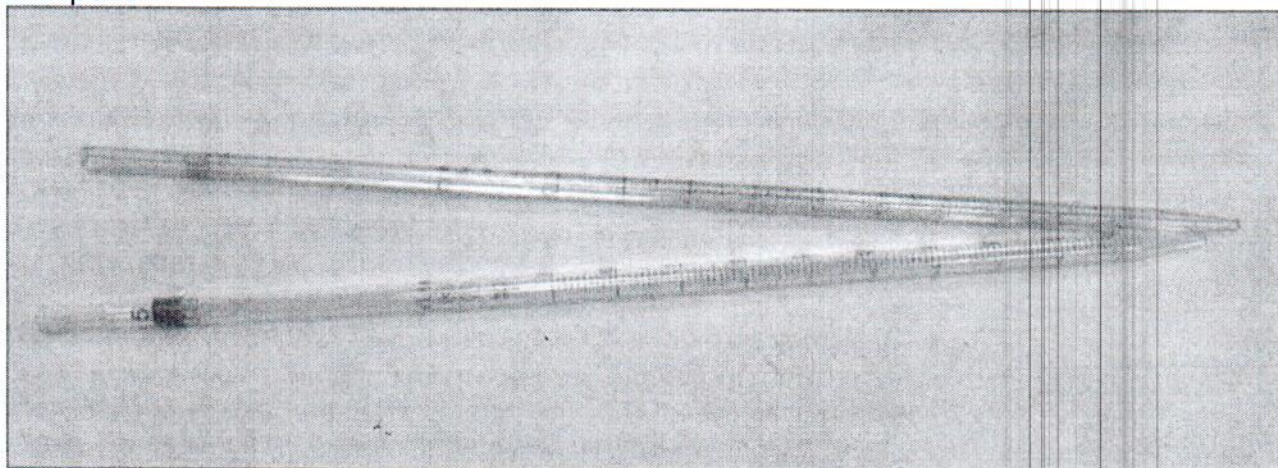


Рис. 1 – Общий вид пипеток градуированных «Klin» 2 класса точности



ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные метрологические характеристики пипеток приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номинальная вместимость, мл	Цена наименьшего деления, мл	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мл	Время слива, с
1	0,01	$\pm 0,01$	6
2	0,02	$\pm 0,02$	6
5	0,05	$\pm 0,05$	8
10	0,10	$\pm 0,10$	8

Основные технические характеристики пипеток приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм, не более - длина	300
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	20 ± 5 от 20 до 80 от 84 до 102

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа Республики Беларусь наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки пипеток приведена в таблице 3.

Таблица 3

№ пп	Наименование изделия	Количество	Примечание
1	Пипетка	-	по требованию заказчика
2	Коробка упаковочная	1 шт.	-
3	Этикетка	1 экз.	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пипетки градуированные Klin 2 класса точности соответствуют требованиям технической документации фирмы «Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company», Китай.

Поверку для Республики Беларусь проводить по ГОСТ 8.234-2013.

Межповерочный интервал – только первичная поверка при выпуске из производства.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company», Китай

Адрес: No.3 people's road, longgang town, Yancheng city, Jiangsu province, China

Тел.: 0086-515-88710001

Факс: 0086-515-88704052

Email: labware@qq.com

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Адрес: Российская Федерация, 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Тел.: (812) 251-76-01

Факс: (812) 713-01-14

Email: info@vniim.ru

Веб-сайт: www.vniim.ru

Начальник научно-исследовательского отдела
законодательной и теоретической метрологии,
научно-технических программ

М.В. Шабанов

