

8012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№14178 от 1 июня 2021 г.

Срок действия до 18 декабря 2024 г.

Наименование типа средств измерений:

Газоанализаторы ГИАМ-315

Производитель:

ФГУП «СПО «Аналитприбор», г. Смоленск, Российская Федерация

Документ на поверку: **ИБЯЛ.413311.025 РЭ «Газоанализаторы ГИАМ-315. Руководство по эксплуатации»**

Интервал времени между государственными поверками **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 01.06.2021 №60

Средства измерений данного типа средства измерений разрешаются к применению в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 1 июня 2021 г. № 14178

Наименование типа средства измерения и его обозначение

Лист № 1
Всего листов 5

Газоанализаторы ГИАМ-315

Назначение средства измерений

Газоанализаторы ГИАМ-315 предназначен для непрерывного автоматического измерения суммарной массовой концентрации предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ (в пересчете на углерод).

Описание средства измерений

Принцип измерений газоанализаторов – опико-абсорбционный, основанный на поглощении ИК–излучения анализируемым газом. Степень поглощения ИК–излучения зависит от содержания анализируемого компонента в газовой смеси. Для каждого газа существует своя область поглощения ИК–излучения, что обуславливает высокую степень избирательности этого метода.

Газоанализатор представляет собой переносной одноблочный автоматический прибор непрерывного действия.

Рабочее положение газоанализатора – горизонтальное или вертикальное, индикатором вверх.

Способ подачи пробы – принудительный, за счет встроенного побудителя расхода.

Газоанализатор обеспечивает выполнение следующих функций:

а) измерение суммарной массовой концентрации предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ (в пересчете на углерод);

б) обмен данными с внешними устройствами (далее – ВУ) по интерфейсу RS-232;

в) цифровую индикацию номера версии программного обеспечения (далее – ПО) и цифрового идентификатора ПО;

г) цифровую индикацию измеренного значения суммарной массовой концентрации предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ (в пересчете на углерод);

д) выдачу звуковой и световой предупредительной и аварийной сигнализации при достижении содержания суммарной массовой концентрации предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ (в пересчете на углерод) пороговых значений;

е) цифровую индикацию установленных пороговых значений;

ж) просмотр значения напряжения блока аккумуляторов;

з) цифровую индикацию данных, сохраненных в режиме автоматической записи с привязкой к дате и времени записи;

и) световую индикации о работе встроенного побудителя расхода;

к) индикацию о разряде блока аккумуляторов.

Корпус газоанализатора выполнен из полиамида угленасыщенного. Передняя и задняя панель газоанализатора выполнены из металла. На передней панели газоанализатора расположены цифровой жидкокристаллический индикатор, кнопки управления, индикаторы предупредительной и аварийной сигнализации, индикатор «НАСОС», окно звукового излучателя, тумблеры включения газоанализатора и встроенного побудителя расхода. На боковой поверхности корпуса расположены штуцеры для подачи и сброса пробы. К боковым поверхностям крепится ремень для ношения газоанализатора. На задней панели расположен разъем для подключения зарядного устройства и ВУ по каналу связи RS 232.

Газоанализатор относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой взрывозащиты IExibdПВТ6 X.



Вид снизу

Вид сверху

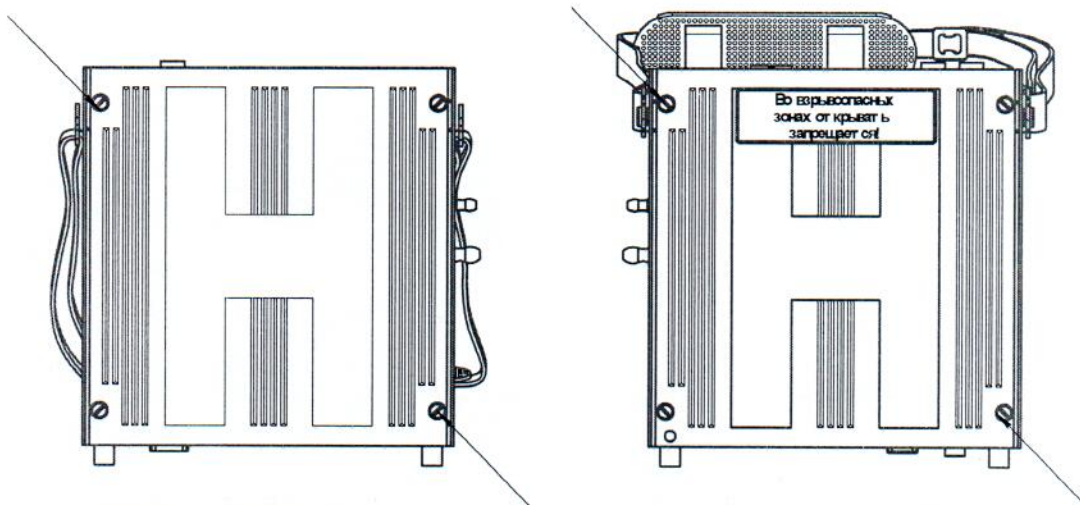


Рисунок 1 - Внешний вид газоанализатора с указанием мест пломбировки

Программное обеспечение

Газоанализатор имеет встроенное программное обеспечение (далее - ПО), разработанное предприятием-изготовителем. ПО предназначено:

- для преобразования сигналов ИК-излучателя в цифровые показания газоанализатора пропорциональные содержанию суммарной массовой концентрации предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ (в пересчете на углерод);
- для обмена данными с ВУ по интерфейсу RS232;
- для обеспечения цифровой индикации номера версии ПО, цифрового идентификатора ПО;
- выдача световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Ad 315bc
Номер версии (идентификационный номер) ПО	4.0
Цифровой идентификатор ПО	2E3A
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC-16

Уровень защиты встроенного ПО и измерительной информации от непреднамеренных и преднамеренных изменений осуществляется посредством механического опечатывания и соответствует среднему уровню защиты в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений суммарной массовой концентрации предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ (в пересчете на углерод), $мг/м^3$ от 0 до 1500

Диапазон показаний суммарной массовой концентрации предельных углеводородов $C_1 - C_{10}$ (в пересчете на углерод), $мг/м^3$ от 0 до 3000

Вид выходного кода по цифровому каналу связи RS232 - двоично-десятичный. Разрядность кода – 6. Цена единицы наименьшего разряда кода, $мг/м^3$ 1

Определяемый компонент, пределы допускаемой абсолютной (относительной) погрешности газоанализатора Δ_d (δ_d) должны соответствовать данным, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Определяемый компонент	Участок диапазона измерений, в котором нормируется погрешность измерений, $мг/м^3$	Пределы допускаемой абсолютной [относительной] погрешности газоанализатора (в пересчете на углерод), Δ_d , $мг/м^3$ [δ_d , %]
$\sum C_1 - C_{10}$	от 0 до 300	± 75
	от 300 до 1500	[± 25]

Предел допускаемой вариации показаний газоанализатора, не более $0,5\Delta_d$ ($0,5\delta_d$)

Предел допускаемого времени установления показаний $t_{0,9}$, с, не более: 60

Газоанализатор соответствует требованиям к допускаемой абсолютной (относительной) погрешности:

- при изменении температуры окружающей и анализируемой среды от минус 30 до 40 °С;
- при изменении атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.)
- при изменении относительной влажности анализируемой газовой смеси до 98 % при температуре 25°С (без конденсации влаги);
- при воздействии неопределяемых компонентов с содержанием, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Неопределяемый компонент	Единица физической величины	Содержание неопределяемого компонента, не более
СО	$мг/м^3$	50
СО ₂	объемная доля, %	1
Непредельные и ароматические углеводороды	$мг/м^3$	10

Газоанализатор устойчив к перегрузке по содержанию определяемого компонента, равной 233 % от верхнего предела диапазона измерений.

Допускаемый интервал времени непрерывной работы газоанализатора до разряда блока аккумуляторов при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, ч, не менее 8

Электрическое питание газоанализатора осуществляется от встроенного блока аккумуляторов. Напряжение питания, В $(7,4 \pm 1,2)$

При разряде блока аккумуляторов газоанализатор имеет непрерывную звуковую и световую сигнализацию. Порог срабатывания сигнализации, В $(6,0 \pm 0,1)$

Допускается питание газоанализатора вне взрывоопасной зоны от сети переменного тока напряжением (220_{-33}^{+22}) А частотой (50 ± 1) Гц с помощью сетевого адаптера.

Время прогрева газоанализатора, мин, не более 15

Предел допускаемого интервала времени работы газоанализатора без корректировки чувствительности по ГСО-ПГС, месяцев, не менее 6

Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более:	
- длина	210
- ширина	210
- высота	95
Масса газоанализатора, кг, не более	3
Средняя наработка на отказ газоанализатора в условиях эксплуатации, с учетом технического обслуживания, ч, не менее	15000
Средний срок службы газоанализатора в условиях эксплуатации, лет, не менее	10
Условия эксплуатации газоанализатора:	
а) диапазон температуры окружающей и анализируемой среды, °С	от минус 30 до плюс 40
б) диапазон атмосферного давления: и давления анализируемой среды	
- кПа	от 84 до 106,7
- мм рт. ст.	от 630 до 800
в) диапазон относительной влажности окружающей и анализируемой среды при температуре 25 °С, без конденсации влаги, %	от 30 до 98
д) синусоидальная вибрация с амплитудой смещения 0,350 мм в диапазоне частот	от 10 до 55 Гц
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP30
По устойчивости к воздействию климатических факторов газоанализатор соответствует климатическому исполнению УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69	
По способу защиты персонала от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 газоанализатор относится к классу	III
Газоанализаторы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51522-99, для оборудования класса	A

Знак утверждения типа

наносится:

- 1) на титульный лист (центр листа) руководства по эксплуатации типографским способом;
- 2) на табличку, методом фотохимпечати, расположенную на задней панели корпуса.

Комплектность средства измерений

Таблица 4

Наименование	Количество
Газоанализатор ГИАМ-315	1 шт
Ведомость эксплуатационных документов	1 экз
Комплект эксплуатационных документов, в составе: <ul style="list-style-type: none"> - Руководство по эксплуатации – 1 экз. - Методика поверки является приложением А к руководству по эксплуатации – 1 экз. - Ведомость ЗИП – 1 экз. 	
Комплект ЗИП (согласно ведомости ЗИП)	1 шт

Поверка

осуществляется по документу ИБЯЛ.413311.025 РЭ (Приложение А) «Газоанализатор ГИАМ-315. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС 20 сентября 2004 г.

Основные средства поверки ГСО-ПГС по ТУ 2114-001-00226247-2010, в баллонах под давлением:

- метан в азоте ГСО по ТУ 6-16-2956-92;
- азот газообразный особой чистоты ГОСТ 9293-74.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых счётчиков с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы, устанавливающие требования к Газоанализатору ГИАМ-315

ГОСТ 8.578-2008. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах

ГОСТ 13320-81. Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»

ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Искробезопасная электрическая цепь «i»

ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ Р 51522.1-2011. Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний

ГОСТ 12.2.091-2012. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

Изготовитель

Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)

ИНН 6731002766

Адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3

Тел.: +7 (4812) 31-07-04, +7 (4812) 31-32-39, 8-800-100-19-50

Факс: +7 (4812) 31-75-18

E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru, market@analitpribor-smolensk.ru

Web-сайт: www.analitpribor-smolensk.ru, аналитприбор.рф

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: +7 (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Директор БелГИМ



В.Л. Гуревич