



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14926 от 1 марта 2022 г.

Срок действия до 21 декабря 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4

Производитель:

ООО «Специальное конструкторское бюро Стройприбор», г. Челябинск, Российская Федерация

Документ на поверку:

КБСП.427121.015 РЭ «Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4. Руководство по эксплуатации»

Интервал времени между государственными поверками **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 01.03.2022 № 21

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Мисюк

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 1 марта 2022 г. № 14926

Наименование типа средств измерений и их обозначение: прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: пределы нагружений и цена единицы наименьшего разряда, пределы допускаемой относительной погрешности, диапазон регулирования скорости возрастания напряжения, пределы допускаемой абсолютной погрешности поддержания заданной скорости, значения приведены в таблицах 1, 2, в разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: высота, ширина и глубина рабочего пространства, размеры опорных плит и ход поршня рабочего цилиндра, габаритные размеры и масса прессов, электрическое питание прессов, потребляемая мощность, средняя наработка на отказ, средний срок службы, значения приведены в таблицах 3, 4, 5, в разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Комплектность: в соответствии с разделом «Комплектность средства измерений» Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Проверка осуществляется по разделу 4 КБСП.427121.015 РЭ «Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4. Руководство по эксплуатации», утвержденной в 2011 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.



Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенная по тексту Приложения ссылка на документ ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы» для Республики Беларусь носит справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 1 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 49130-12, на 7 листах.

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4

Назначение средства измерений

Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4 (далее – прессы) предназначены для создания и измерения нагрузки (силы), при статических испытаниях на сжатие и изгиб контрольных образцов из бетона, а так же других строительных материалов, в том числе при испытаниях: на растяжение при расколе, на сдвигоустойчивость, на дробимость, и уплотнении образцов асфальтобетона прессованием.

Описание средства измерений

Принцип действия прессов основан на преобразовании нагрузки (силы), приложенной к испытываемому образцу, тензорезисторным датчиком в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально этой нагрузке. Электрический сигнал регистрируется пультом управления, где обрабатывается и результаты измерений, в единицах силы, отображаются на жидкокристаллическом дисплее.

Конструктивно пресс представляет собой машину, состоящую из нагружающего устройства и силоизмерителя. Нагружающее устройство состоит из силовой рамы, гидронасоса и рабочего цилиндра. Силоизмеритель состоит из тензопреобразователя, блока обработки и пульта управления с дисплеем, соединяемого при помощи кабеля с тензопреобразователем и электроприводом.

Пульт управления служит для управления процессом измерений и отображения результатов измерений. На лицевой панели пульта управления имеется жидкокристаллический дисплей и клавиатура из семи кнопок: **РЕЖИМ**, **ВВОД**, **↑**, **↓**, **СЕРИЯ**, **F**, **ВКЛ**.

На правой боковой панели пульта управления расположены соединительные разъемы для подключения через соответствующие кабели к прессу и персональному компьютеру.

Прессы выпускаются в нескольких модификациях, которые отличаются пределами измерений, габаритными размерами и массой

Обозначения прессов ПГМ-ХМГ4, ПГМ-ХМГ4А, где

ПГМ-МГ4 – обозначение типа;

Х – наибольший предел измерений, кН;

А – обозначение варианта исполнения.

Прессы варианта исполнения «А» имеют увеличенный ход поршня рабочего цилиндра, что позволяет проводить испытания асфальтобетонных образцов на сдвигоустойчивость, одноосное сжатие и уплотнение прессованием, а так же испытания щебня на дробимость.

Внешний вид пресса показан на рисунке 1



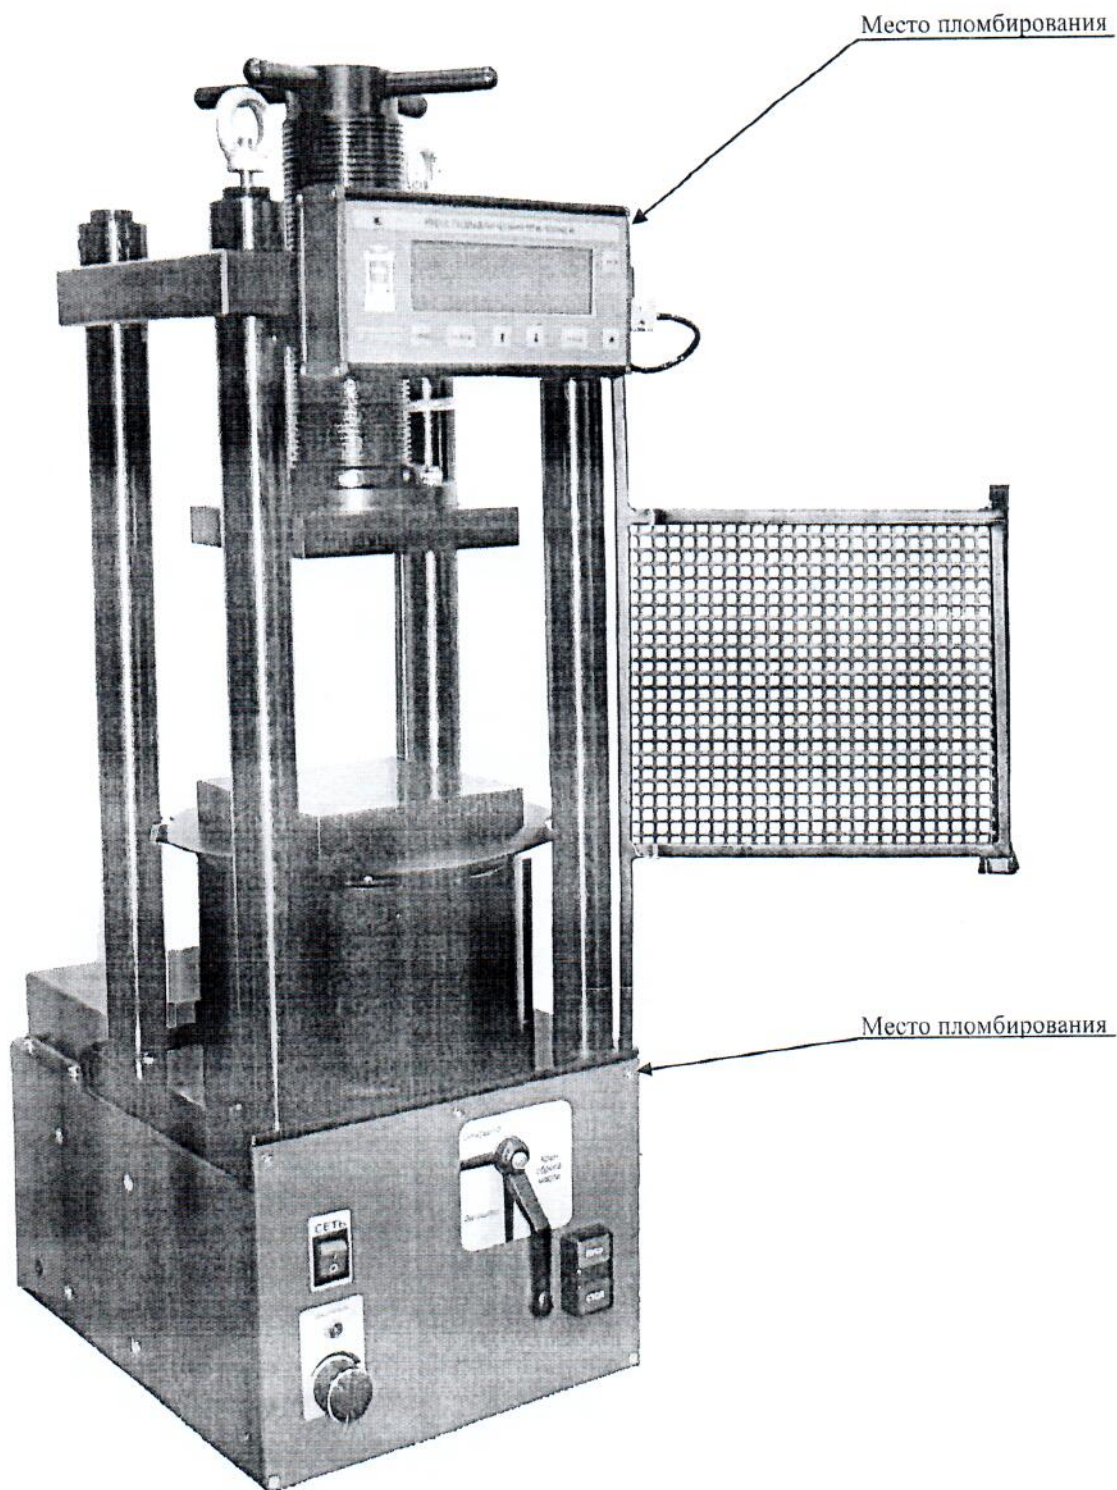


Рисунок 1 – Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ-МГ4



Программное обеспечение

Приборы имеют программное обеспечение:

- 1) встроенное (микропрограмма контроллера прибора версии V1.01 и выше);
- 2) внешнее (программа «ПО ПК» версии 1.0.1 и выше для персонального компьютера).

Встроенное программное обеспечение прибора разработано изготовителем специально для решения задач измерения силы. Встроенное программное обеспечение идентифицируется по запросу пользователя через сервисное меню путем вывода на экран версии программного обеспечения (версия V1.01 и выше). Конструктивно прессы имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

Внешнее программное обеспечение «ПО ПК» предназначено для установки на персональный компьютер под управлением операционной системы семейства Microsoft Windows и предназначено для:

- 1) считывания результатов измерений, сохраненных в памяти прессы;
- 2) удаленного доступа к меню настройки прессы.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Встроенное программное обеспечение	PGM_EL	V1.01	A14D	CRC16
ПО ПК	ПГМ-МГ4	1.0.1	91f3f72726137f4471 edfc867f39d166	md5

Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом того, что встроенное программное обеспечение версии V1.01 является неотъемлемой частью прибора.

Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений - А в соответствии с МИ 3286-2010.

Относительное отличие тестовых результатов вычислений от опорных (δ) не превышает 0,001.

Внешнее программное обеспечение «ПО ПК» версии 1.0.1 предназначено для сбора, сохранения, удаления данных из памяти прессов и удаленного доступа к меню прессы в лабораторных условиях и не используется при выполнении измерений силы.



Метрологические и технические характеристики

1. Пределы нагрузжений и цена единицы наименьшего разряда в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Модификация пресса	Пределы нагрузжений, кН		Цена единицы наименьшего разряда, кН
	наименьший	наибольший	
ПГМ-50МГ4	1	50	0,005
ПГМ-100МГ4	1	100	0,01
ПГМ-100МГ4А	1	100	
ПГМ-500МГ4	5	500	0,1
ПГМ-500МГ4А			
ПГМ-1000МГ4	10	1000	
ПГМ-1500МГ4	15	1500	
ПГМ-2000МГ4	20	2000	

2. Пределы допускаемой относительной погрешности в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Диапазон нагрузжений, %, от наибольшего предела нагрузжения	Пределы допускаемой относительной погрешности, %
от 1 до 5	± 3
св. 5 до 100	± 1

3. Высота, ширина и глубина рабочего пространства не менее указанных в таблице 3.

Таблица 3

Модификация пресса	Высота рабочего пространства, мм	Глубина рабочего пространства, мм	Ширина рабочего пространства, мм
ПГМ-50МГ4	160	140	140
ПГМ-100МГ4			
ПГМ-100МГ4А			
ПГМ-500МГ4	230	145	198
ПГМ-500МГ4А	337	140	198
ПГМ-1000МГ4	240	245	154
ПГМ-1500МГ4	277	243	152
ПГМ-2000МГ4	410	200	200

4. Диапазон регулирования скорости возрастания напряжения в образце от 0,2 до 1,0 МПа/с.

5. Пределы допускаемой абсолютной погрешности поддержания заданной скорости ± 0,2 МПа/с.

6. Размеры опорных плит и ход поршня рабочего цилиндра в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Модификация пресса	Размеры опорных плит, мм, не менее	Ход поршня рабочего цилиндра, мм, не менее
1	2	3
ПГМ-50МГ4	110×110	10
ПГМ-100МГ4		
ПГМ-100МГ4А		20



продолжение таблицы 4

1	2	3
ПГМ-500МГ4	160×160	10
ПГМ-500МГ4А	160×160	50
ПГМ-1000МГ4	210×210	10
ПГМ-1500МГ4	210×210	
ПГМ-2000МГ4	210×210	100

7. Габаритные размеры и масса прессов не более указанных в таблице 5.

Таблица 5

Модификация пресса	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПГМ-50МГ4	315×480×700	60
ПГМ-100МГ4		
ПГМ-100МГ4А		65
ПГМ-500МГ4	320×445×800	140
ПГМ-500МГ4А	320×455×945	145
ПГМ-1000МГ4	410×445×845	230
ПГМ-1500МГ4	410×445×905	255
ПГМ-2000МГ4	400×450×1350	405
Пульт управления	200×50×100	0,1

8. Электрическое питание прессов осуществляется от сети переменного тока частотой (50±0,5) Гц, напряжение (220±22) В.

9. Потребляемая мощность, Вт:

– ПГМ – 50МГ4	– 200;
– ПГМ-100МГ4	– 200;
– ПГМ-100МГ4А	– 200;
– ПГМ-500МГ4	– 300;
– ПГМ-500МГ4А	– 300;
– ПГМ-1000МГ4	– 300;
– ПГМ-1500МГ4	– 320;
– ПГМ-2000МГ4	– 450;

10. Средняя наработка на отказ, не менее 5000 ч.

11. Средний срок службы, не менее 10 лет.



Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации, в центре листа, типографским способом и на табличку, закрепленную на основании пресса, фотохимическим способом

Комплектность средства измерений

1	пресс	1
2	пульт управления	1
3	кабель USB	1
4	сетевой кабель	1
5	CD с программным обеспечением	1
6	вставка плавкая 5А, 250 В	1
7	емкость с маслом	1
8	приспособление для испытания на изгиб цементных и гипсовых балок (по спецзаказу)	1
9	руководство по эксплуатации с методикой поверки	1

Поверка

осуществляется по методике поверки изложенной в разделе 4 «Руководства по эксплуатации КБСП.427121.015 РЭ», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Челябинский ЦСМ» 30 ноября 2011 г.

Основные средства измерений, применяемые при поверке:

- динамометры сжатия в диапазоне измерений от 0,05 кН до 2 МН, пределы допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности при $p=0,95$ 0,24 %;
- секундомер механический СОС пр 26-2 60 мин, 60 с;
- индикатор часового типа ИЧ-25 диапазон измерений от 0 до 25 мм, класс точности 1.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в руководстве по эксплуатации прессов гидравлических малогабаритных ПГМ-МГ4 (КБСП.427121.015 РЭ)

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к прессам

1. ГОСТ Р 8.663-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы.
2. ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования.
3. ТУ 4271-015-12585810-2011. Технические условия. Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4.



Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель (Заявитель)

ООО «Специальное конструкторское бюро Стройприбор»
Адрес: Россия, 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 11-Г
Тел/Факс (351) 277-85-55

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ФБУ «Челябинский ЦСМ»
Регистрационный номер № 30059-10
Адрес: 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101
Телефон, факс (351) 2320401, e-mail: stand@chel.surnet.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



[Handwritten signature]
Е.Р.Петросян
«16» 03 2012 г.

КОПИЯ ВЕРНА *[Handwritten signature]*

В.В. Гулунов

