

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15933 от 3 января 2023 г.

Срок действия до 3 февраля 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2»

Производитель:

ООО НПФ «РАДИУС», г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 21721-07 «Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2». Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 03.01.2023 № 1

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Мессинг

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 3 января 2023 г. № 15933

Наименование типа средств измерений и их обозначение: устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2»

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицей 1 в разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: напряжение питания переменного тока; частота питающей сети; потребляемая мощность по цепям питания; время установления рабочего режима; продолжительность непрерывной работы без нагрузки; габаритные размеры; масса; наработка на отказ; средний срок службы с заменой комплектующих изделий; нормальные условия применения; рабочие условия применения, устойчивость к воздействию внешних механических и климатических факторов в условиях работы, транспортировки и хранения устройства, значения приведены в разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения; продолжительность непрерывной работы под нагрузкой, значения приведены в таблице 2 в разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Комплектность: в соответствии с разделом «Комплектность средства измерений» Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по документу МП 21721-07 «Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2». Методика поверки», утвержденному в 2007 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: в соответствии с разделом «Поверка» Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: наносится в виде наклейки на лицевую панель корпуса устройств.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 21721-07, на 5 листах.

Заместитель директора по оценке соответствия



А.Д.Шевцова-Ронина

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2»

Назначение средства измерений

Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2» (далее устройства) предназначены для измерений электрических величин: напряжения, силы переменного тока, напряжения постоянного тока при проведении проверки электромеханических и электронных реле систем релейной защиты и автоматики (напряжение 0,4 и 6—35 кВ), а также временных уставок их срабатывания.

Описание средства измерений

Устройство («Нептун», «Нептун-2») представляет собой переносной прибор, выполненный в виде блока со съемной крышкой, закрывающей на время транспортировки и хранения органы управления и элементы индикации.

Силовая часть электрической схемы включает в себя:

- регулировочный автотрансформатор с максимальным выходным напряжением 240 В;
- нагрузочный трансформатор с четырьмя вторичными обмотками по 6,3 В и переключателем выходных обмоток;
- трансформатор и выпрямитель вспомогательного изолированного источника питания контактов проверяемого объекта;
- силовой выпрямитель со сглаживающим фильтром для получения постоянного напряжения канала напряжения;
- переключатель режимов работы канала напряжения, выключатели нагрузки и питания.

Выходные клеммы канала напряжения и канала тока выведены отдельно для проверки различных типов реле. Входные клеммы для подключения контактов проверяемого реле также выведены отдельно.

Измерительная электрическая схема включает в себя четыре измерительных преобразователя напряжения и силы постоянного и переменного тока, работа которых основана на эффекте Холла.

Схема обработки измерительной информации содержит цифровую часть и аналоговую часть.

В состав цифровой части входят:

- микропроцессор (МП) со встроенным аналого-цифровым преобразователем (АЦП);
- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ);
- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);
- два входных порта;
- выходной регистр;
- интерфейсы связи с органами управления и жидкокристаллическим дисплеем;
- схема формирования звукового сигнала;


Аналоговая часть имеет в своем составе формирователь опорных напряжений, усилители сигналов.

Питание устройств осуществляется от однофазной сети переменного тока.

На лицевой панели устройств находятся жидкокристаллический дисплей для отображения измерительной информации и органы управления.

Устройства имеют встроенную автоматическую самодиагностику.

Общий вид устройств приведен на рисунке 1.

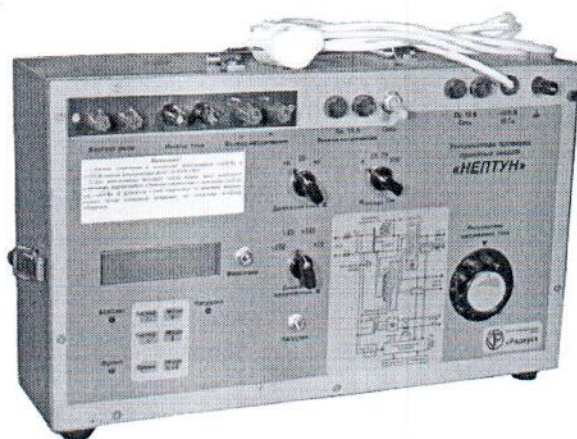

Устройство «Нептун»



Устройство «Нептун-2»

Рисунок 1

Принцип действия устройств заключается в следующем:

На проверяемое реле, подключенное к выходам силовой части электрической схемы осуществляется подача плавно регулируемого сигнала (для реле напряжения — переменного или постоянного напряжения, для реле тока — силы тока) с измерением его значения и индикацией момента срабатывания контактов проверяемого реле.

Устройства обеспечивают возможность проверки временных характеристик реле напряжения, тока и времени подачи предварительно установленного переменного или постоянного напряжения и переменного тока с измерением времени срабатывания и отпускания.

Органами управления выбираются режимы работы, вводятся необходимые параметры, выбираются режимы индикации результатов измерений.

Знак поверки в виде наклейки наносится на лицевую панель корпуса устройств.

Пломбы для защиты от несанкционированного доступа устанавливаются на крепежный элемент лицевой панели корпуса устройств внутри специальной чашевидной оснастки.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2.



Место пломбировки

Рисунок 2

Программное обеспечение

Устройства имеют программное обеспечение (ПО), исполняемое микропроцессором (микропрограмму).

ПО является встроенным и полностью метрологически значимым.

ПО записано в машинных кодах в энергонезависимом (ПЗУ), и не доступно для изменения вне заводских условий без использования специализированных средств.

Для доступа к микросхеме ПЗУ, содержащей управляющую программу, необходимо вскрыть опломбированный корпус устройства.

Уровень защиты «А» согласно МИ 3286-2010.

Идентификация ПО не применяется.

Метрологические и технические характеристики

| Измеряемая величина, единица измерений | Диапазон | Пределы допускаемой погрешности измерений |
|--|--|--|
| Напряжение переменного тока, В «Нептун», на пределе «≈25 В» «Нептун», на пределе «≈250 В» «Нептун-2», на пределе «≈50 В» «Нептун-2», на пределе «≈250 В» | от 1 до 25 от 10 до 240 от 2 до 50 от 10 до 250 | ±2,5 % от верхнего значения диапазона измерений плюс 3 ед. мл. разр. |
| Напряжение постоянного тока, В «Нептун», на пределе «=35 В» «Нептун», на пределе «=350 В» «Нептун-2», на пределе «=70 В» «Нептун-2», на пределе «=320 В» | от 1 до 35 от 10 до 320 от 2 до 70 от 10 до 320 | ±2,5 % от верхнего значения диапазона измерений плюс 3 ед. мл. разр. |
| Сила переменного тока, А «Нептун», на пределе «≈10 А» «Нептун», на пределе «≈20 А» «Нептун», на пределе «≈40 А» «Нептун-2», на пределе «≈5 А» «Нептун-2», на пределе «≈25 А» «Нептун-2», на пределе «≈50 А» «Нептун-2», на пределе «≈100 А» | от 0,1 до 10 от 0,2 до 20 от 0,4 до 40 от 0,05 до 5 от 0,25 до 25 от 0,5 до 50 от 1 до 100 | ±2,5 % от верхнего значения диапазона измерений плюс 3 ед. мл. разр. |
| Время срабатывания и отпускания контактов, с | от 0,002 до 99,99 | (0,01·T _{изм} + 0,002) |

Напряжение питания переменного тока от 187 до 242

Частота питающей сети Гц 50±1

Потребляемая мощность по цепям питания, Вт
«Нептун» 500
«Нептун-2» 1000

Время установления рабочего режима не более, мин 10

Продолжительность непрерывной работы без нагрузки не менее, ч 8

Продолжительность непрерывной работы под нагрузкой:

| Устройство | Выходная мощность, ВА | Время работы, минут |
|------------|-----------------------|---------------------|
| «Нептун» | 150 | 60 |
| | 300 | 5 |
| | 500 | 1 |
| «Нептун-2» | 300 | 60 |
| | 600 | 5 |
| | 1000 | 1 |

| | |
|--|---------------|
| Габаритные размеры блока не более, мм | |
| «Нептун» (высота, ширина, глубина) | 480, 300, 170 |
| «Нептун-2» (высота, ширина, глубина) | 570, 300, 200 |
| Масса не более, кг | |
| «Нептун» | 16 |
| «Нептун-2» | 21 |
| Наработка на отказ не менее, ч | 10000 |
| Средний срок службы с заменой комплектующих изделий, лет, не менее | 10 |

Нормальные условия применения:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| температура окружающего воздуха | плюс 20±5 °С |
| относительная влажность | от 30 до 80 % |

Рабочие условия применения

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| температура окружающего воздуха | от минус 10 до плюс 45 °С |
| относительная влажность | до 80% при плюс 25 °С |

По устойчивости к воздействию внешних механических и климатических факторов в условиях работы, транспортировки и хранения устройства относятся к квалификационной группе 3 по ГОСТ 22261-91.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель устройств заводским способом и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

| | |
|------------------------------------|-------|
| Устройство «Нептун» или «Нептун-2» | 1 шт. |
| Вставка плавкая (номинал 10 А) | 4 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Методика поверки | 1 шт. |

Поверка

осуществляется по документу МП 21721-07 «Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 18 декабря 2006 г.

Основные средства поверки:

Измерительный комплект К540 (класс точности амперметра 0,5, класс точности вольтметра на диапазоне с конечным значением 15 В – 2,5; с конечным значением 30 В – 1,0; с конечным значением от 75 до 600 В – 0,5).

Частотомер электронно-счетный ЧЗ-57 пределы основной относительной погрешности 0,1 %

Сведения о методиках (методах) измерений

Документ «Устройство проверки простых защит «Нептун-2». Руководство по эксплуатации», раздел 8 .

Документ «Устройство проверки простых защит «Нептун». Руководство по эксплуатации», раздел 8 .

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам проверки простых защит «Нептун» и «Нептун-2»

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

2. ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия».

3. ТУ 3430-012-17326295-99 «Устройства проверки простых защит «Нептун», «Нептун-2» Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственная фирма «РАДИУС» (ООО НПФ «РАДИУС»)
124489, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, строение 3.
Тел./факс: (499) 735-22-91, 735-54-41, 732-26-34, 732-73-95.
<http://www.rza.ru>

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккредитации № 30004-08.
119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.
Тел.: (495) 437 5577, факс: (495) 437 5666.
<http://www.vniims.ru>; E-mail: Office@vniims.ru

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии



Е.Р. Петросян

М.п.

« 05 » 06 2012

al