

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18112 от 25 октября 2024 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:

Анализатор общего органического углерода ТОС-1500 № MS-ТОС-240516

Производитель:

«Shanghai Metash Instrument Co., Ltd.», Китай

Выдан:

ООО «Лабинтертрейд», г. Минск, Республика Беларусь

Документ на поверку:

**МП.ВТ.368-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.
Анализаторы общего органического углерода ТОС-1500. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25.10.2024 № 112

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 25 октября 2024 г. № 18112

Наименование типа средств измерений и их обозначение:
Анализатор общего органического углерода TOC-1500 № MS-TOC-240516

Назначение и область применения:

Анализатор общего органического углерода TOC-1500 № MS-TOC-240516 (далее - анализатор) предназначен для измерений массовой концентрации общего органического углерода в пробах воды.

Область применения – предприятия фармацевтической промышленности и ветеринарного производства.

Описание:

Принцип действия анализатора основан на измерении удельной электрической проводимости. В анализатор подается проба, которая разделяется на два потока. Органический углерод в первом потоке под воздействием ультрафиолетового излучения окисляется, в результате чего образуется общий неорганический углерод (CO_2). На второй поток ультрафиолетовое излучение не воздействует. С помощью размещенных в анализаторе кондуктометрических ячеек происходит измерение удельной электрической проводимости для каждого потока. Затем происходит расчёт концентрации общего неорганического углерода в образце (TIC), выделенного в результате окисления под воздействием ультрафиолетового излучения, а также концентрации общего углерода (TC), присутствующего в образце. Массовая концентрация общего органического углерода (TOC) вычисляется как разность TC и TIC образца.

Конструктивно анализатор включает в себя узел подготовки пробы, систему ультрафиолетовой обработки, кондуктометрические ячейки, системную плату. Управление анализатором осуществляется при помощи сенсорного дисплея, расположенного на передней панели корпуса.

Встроенное программное обеспечение (далее – ПО) позволяет проводить измерения, выводить информацию на дисплей, проводить настройку и управление анализатором, обрабатывать и сохранять полученные результаты. ПО используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части и не может быть модифицировано или не санкционировано загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств.

Общий вид анализатора представлен в приложении 1.

Место для нанесения знака поверки приведено в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений массовой концентрации общего органического углерода, мкг/дм^3	от 50 до 1000
Пределы допускаемой приведенной (к верхнему пределу диапазона измерений) погрешности анализатора при измерении массовой концентрации общего органического углерода, %	$\pm 5,0$

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон показаний массовой концентрации общего органического углерода, мкг/дм ³ *	от 0 до 1500
Условия эксплуатации: - диапазон температур окружающего воздуха, °С *	от 10 до 40
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, % *	от 20 до 85
Параметры питающей сети переменного тока: - номинальное напряжение питающей сети, В *	220
- номинальная частота питающей сети, Гц *	50
Потребляемая мощность, Вт, не более *	100
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более	443х220х300
Масса, кг, не более	20
* Согласно руководству по эксплуатации, при проведении метрологической экспертизы характеристика не подтверждалась	

Комплектность: представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Анализатор общего органического углерода ТОС-1500	1
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта.

Поверка осуществляется по МП.ВТ.368-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы общего органического углерода ТОС-1500. Методика поверки»

Сведения о методиках (методах измерений): отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

техническая документация фирмы «Shanghai Metash Instrument Co., Ltd.», Китайская Народная Республика.

методику поверки:

МП.ВТ.368-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы общего органического углерода ТОС-1500. Методика поверки».

Перечень средств поверки:

- прибор измерительный ПИ-002/1;
- сахара кваліфікацыі «ч.д.а» па ГОСТ 5833-75;
- весы лабараторныя электронныя I (спецыяльнага) класа дакладнасці па ГОСТ OIML R 76-1-2011 з дыяпазонам вымярэнняў ад 0,001 г да 220 г;
- мерныя колбы 2-га класа дакладнасці па ГОСТ 1770-74;

- пипетки 2-го класса по ГОСТ 29227-91, ГОСТ 29169-91;
- вода для лабораторного анализа первой степени чистоты по ГОСТ ISO 3696-2013.

Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Идентификация программного обеспечения: представлена в таблице 4

Таблица 4

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО
METASH	ТОС1500

Заключение о соответствии утвержденного типа требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: анализатор общего органического углерода ТОС-1500 № MS-ТОС-240516 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», технической документации производителя.

Производитель средства измерений:

Фирма «Shanghai Metash Instrument Co., Ltd.», Китайская Народная Республика

Адрес: F6, Block9, No.115, Lane 1276 Nanle Road, Songjiange District,

Shanghai, 201611, P. R. China

Телефон: + 0086-(0)21-64550709

Веб-сайт: www.metash.com

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений

Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (РУП «Витебский ЦСМС»)

ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск,

тел./факс: (0212) 48-04-19

E-mail: info@vcsms.by

Приложения: 1. Фотографии общего вида средств измерений на 1 листе.

2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Заместитель директора – главный метролог
РУП «Витебский ЦСМС»



В.А. Хандогина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное)

Фотографии общего вида средств измерений



Рисунок 1.1 – Фотография общего вида анализатора общего органического углерода TOC-1500 № MS-TOC-240516

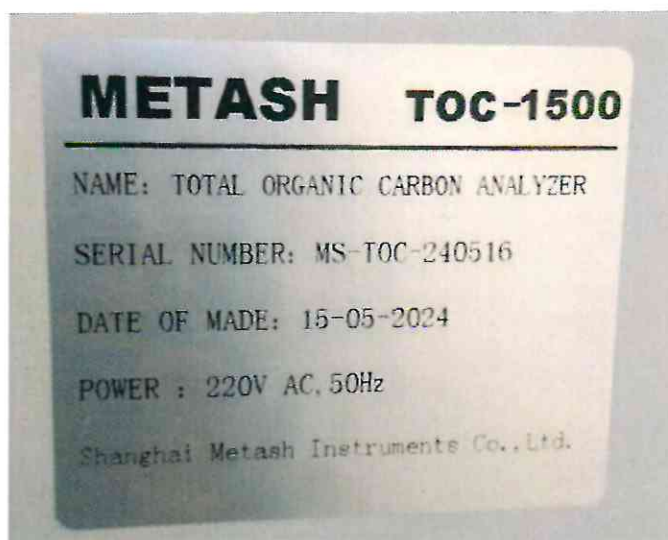


Рисунок 1.2 – Фотография маркировки анализатора общего органического углерода TOC-1500 № MS-TOC-240516

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений



Место для нанесения знака поверки

Рисунок 2.1 - Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений