

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 16688 от 29 июня 2023 г.

Срок действия до 28 июня 2028 г.

Наименование типа средств измерений:  
Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X

Производитель:  
АО «АРТГАЗ», г. Москва, Российская Федерация

Выдан:  
АО «АРТГАЗ», г. Москва, Российская Федерация

Документ на поверку:  
МП-525/07-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений.  
Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X. Методика поверки» (для газоанализаторов,  
изготовленных до 13.02.2025);  
МП-525/07-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений.  
Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X. Методика поверки» с изменением № 1.  
(для газоанализаторов, изготовленных с 14.02.2025)

Интервал времени между государственными поверками: **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.06.2023 № 48  
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 14.02.2025 действует в редакции изменения № 1, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14.02.2025 № 22).

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
(в редакции изменения № 1 от 14.02.2025)  
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений  
от 29 июня 2023 г. № 16688

Наименование типа средств измерений и их обозначение: газоанализаторы  
Бинар-XX-XXX-X

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицей 3 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: в соответствии с таблицами 4, 5 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 6 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка газоанализаторов Бинар-XX-XXX-X, изготовленных до 13.02.2025 осуществляется по МП-525/07-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X. Методика поверки»;

поверка газоанализаторов Бинар-XX-XXX-X, изготовленных с 14.02.2025, осуществляется по МП-525/07-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X. Методика поверки» с изменением № 1.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: отсутствует.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах», Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (п. 4.43) для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа: не предусмотрена.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер:  
№ 71645-18, на 21 листе.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «05» апреля 2024 г. № 895

Регистрационный № 71645-18

Лист № 1  
Всего листов 21

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X**

**Назначение средства измерений**

Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X (далее - газоанализаторы) предназначены для автоматического непрерывного измерения объемной доли или массовой концентрации компонентов в воздухе рабочей зоны и газовых средах.

**Описание средства измерений**

Принцип действия газоанализаторов основан на непрерывном преобразовании сигналов, поступающих с газочувствительных измерительных преобразователей (сенсоров), в аналоговую или в цифровую форму, с последующей обработкой встроенным микропроцессором и выводом результатов измерений на цифровой индикатор газоанализатора и (или) передачу их внешнему компьютеру и другим регистрирующим устройствам или исполнительным механизмам.

Газоанализаторы могут комплектоваться сенсорами следующих типов: оптический, полупроводниковый, термокаталитический, фотоионизационный, электрохимический.

Газоанализаторы имеют диффузионный способ отбора пробы.

Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций:

- непрерывное измерение объемной доли или массовой концентрации определяемого компонента;
- сигнализацию о превышении заданных пороговых значений определяемого компонента;
- самодиагностику;
- сохранение журнала событий, включая пиковые значения концентрации определяемого компонента, тип и длительность события, время, прошедшее с момента регистрации тревоги.

Газоанализаторы выпускаются в модификациях в зависимости от функционального исполнения и контролируемых газов, и имеют следующее обозначение Бинар-XX-XXX-X, где первая цифра (-XX-) это обозначение определяемого компонента согласно таблице 3, вторая цифра (-XXX-) функциональное исполнение прибора согласно таблице 1, третья цифра (-X-) тип корпуса (А – алюминий, Н – нержавеющая сталь).

Таблица 1 – Функциональное исполнение газоанализаторов

Обозначение	Функциональное исполнение
Бинар-XX-000-X	Измерение концентрации контролируемого газа без индикации, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Функциональное исполнение
Бинар-XX-001-X	Измерение концентрации контролируемого газа без индикации, наличие аккумуляторного блока питания, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus
Бинар-XX-010-X	Контроль и индикация контролируемого газа на LED-индикаторе, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus
Бинар-XX-100-X	Измерение концентрации контролируемого газа без индикации, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus, наличие управляющего контакта типа «Сухой контакт»
Бинар-XX-011-X	Контроль и индикация контролируемого газа на LED-индикаторе, наличие аккумуляторного блока питания, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus
Бинар-XX-111-X	Контроль и индикация контролируемого газа на LED-индикаторе, наличие аккумуляторного блока питания, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus, наличие управляющего контакта типа «Сухой контакт»
Бинар-XX-110-X	Контроль и индикация контролируемого газа на LED-индикаторе, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus, наличие управляющего контакта типа «Сухой контакт»
Бинар-XX-101-X	Измерение концентрации контролируемого газа без индикации, наличие аккумуляторного блока питания, выдача унифицированного сигнала от 4 до 20 мА об объемной доле контролируемого газа (по отдельному заказу с HART протоколом) или RS-485 протокол ModBus, наличие управляющих контактов типа наличие управляющего контакта типа «Сухой контакт»

Газоанализатор любой модификации при производстве может быть оснащен цифровым выходом с протоколом HART.

Общий вид газоанализатора с указанием мест нанесения знака утверждения типа, заводского номера приведен на рисунке 1.

Пломбирование и нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится термографическим способом или лазерной гравировкой на маркировочную табличку в месте, указанном на рисунке 1.

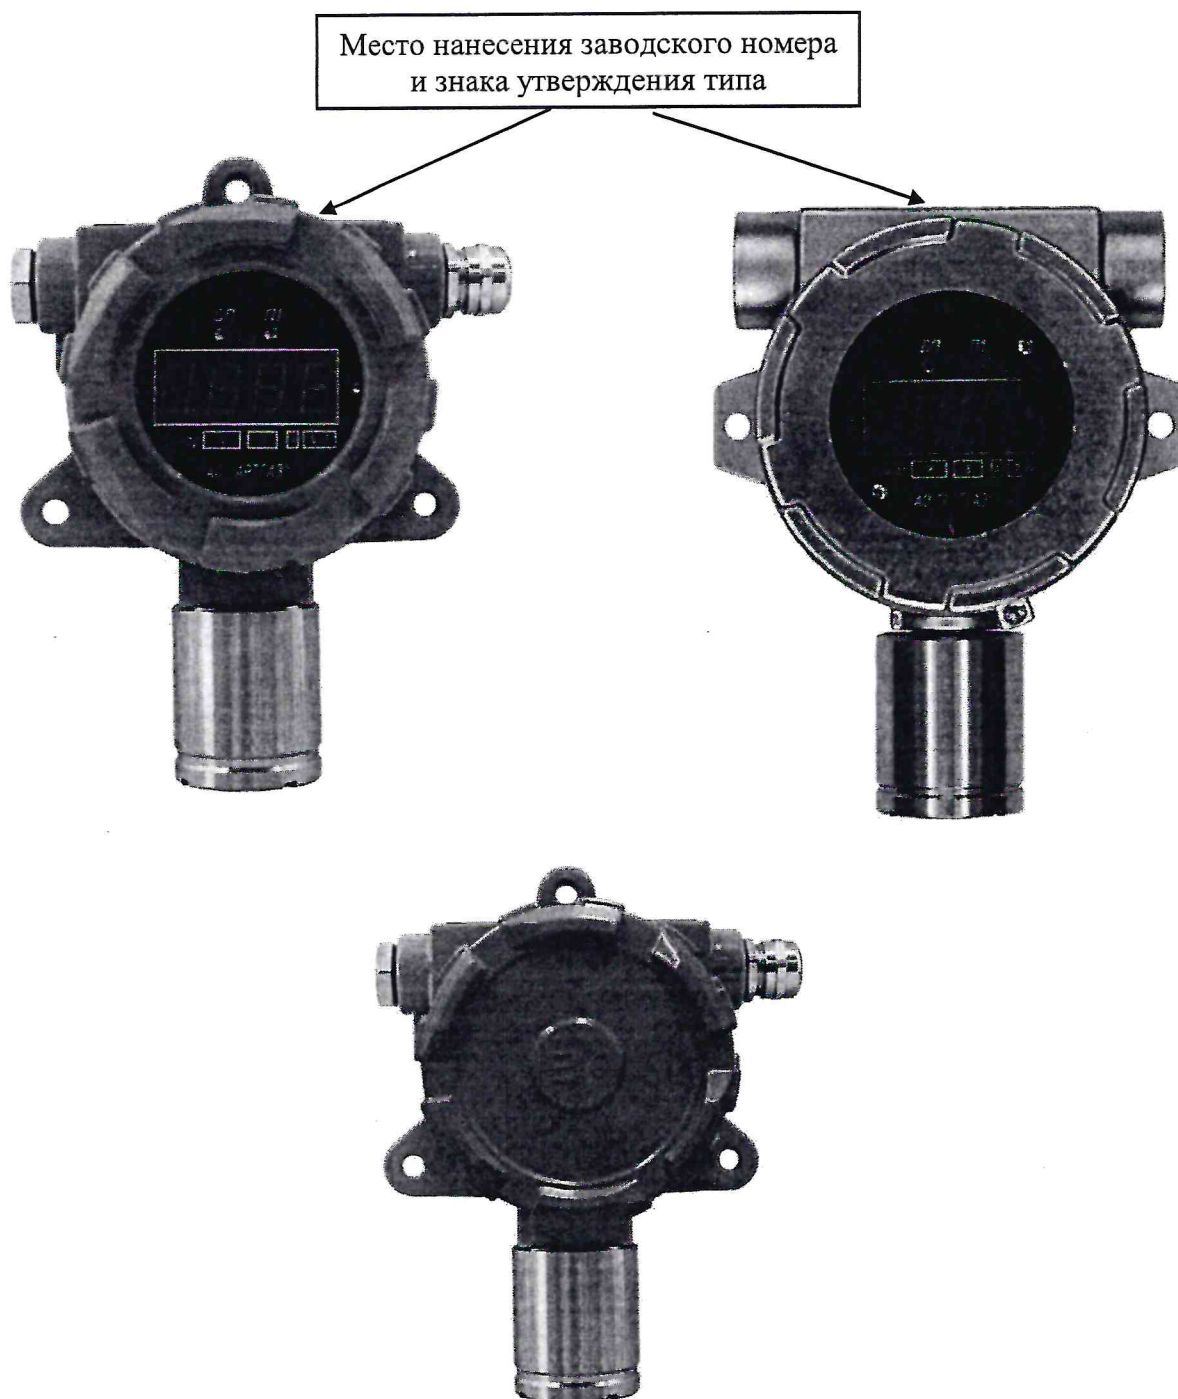


Рисунок 1 – Общий вид газоанализатора с указанием мест нанесения знака утверждения типа, заводского номера

### Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют защиту программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства посредством установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

Уровень защиты встроенного программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 - высокий.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Binar
Номер версии (идентификационный номер ПО):	не ниже 7.3
Цифровой идентификатор ПО	-
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	-

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Аммиак (NH <sub>3</sub> )	ЭХ	120	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 71 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±2 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 100 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Аммиак (NH <sub>3</sub> )	ФИ	40	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 71 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup>	±10 млн <sup>-1</sup>	-
Аммиак (NH <sub>3</sub> )	ЭХ	120	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 710 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±15 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±15 %
Аммиак (NH <sub>3</sub> )	ФИ	40	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 710 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±20 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Арсин (AsH <sub>3</sub> )	ЭХ	30	от 0 до 1 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 3,24 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 0,5 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 0,5 до 1 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Ацетилен (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	ФИ	60	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 216,5 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %



Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Ацетилен (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	ТК, ИК	40	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Ацетилен (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )	ТК, ИК	40	от 0 до 1,15 % об. д.		±0,1 % об. д.	-
Ацетон (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O)	ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 483 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Ацетон (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O)	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Ацетон (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O)	ТК, ИК	20	от 0 до 1,25 % об. д.		±0,1 % об. д.	-
Бензол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	ФИ, ЭХ	20	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 65 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 5 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Бензол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	ФИ, ЭХ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 650 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±15 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±15 %
Бензол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Бензол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,6 % об. д.		±0,06 % об. д.	-
Бензол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±5 % НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Бензол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )	ИК	20	от 0 до 1,2 % об. д.	от 0 до 0,6 % об. д. включ.	±0,06 % об. д.	-
				св. 0,6 до 1,2 % об. д.	-	±10 %
Бутан (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±3% НКПР	-
Бутан (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,7 % об. д.		±0,04% об. д.	-

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Бутан (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±3% НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±5 %
Бутан (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	ИК	20	от 0 до 1,4 % об.д.	от 0 до 0,7 % об. д. включ.	±0,04 % об. д.	-
				св. 0,7 до 1,4 % об. д.	-	±5 %
Водород (H <sub>2</sub> )	ЭХ	20	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 84 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±15 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±15 %
Водород (H <sub>2</sub> )	ЭХ	20	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 167,6 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±20 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Водород (H <sub>2</sub> )	ЭХ	20	от 0 до 4000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 335 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> включ.	±20 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 200 до 4000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Водород (H <sub>2</sub> )	ТК, ЭХ	20	от 0 до 50 % НКПР		±5% НКПР	-
Водород (H <sub>2</sub> )	ТК, ЭХ	20	от 0 до 2 % об. д.		±0,2 % об. д.	-
Водород (H <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±5% НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Водород (H <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 4 % об. д.	от 0 до 2 % об. д. включ.	±0,2 % об. д.	-
				св. 2 до 4 % об. д.	-	±10 %
Гексан (C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Гексан (C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,5 % об. д.		±0,05 % об. д.	-
Гексан (C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР		±5 % НКПР	-

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Гексан (C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> )	ИК	20	от 0 до 1 % об. д.		±0,05 % об. д.	-
Гептан (C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> )	ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 833 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Гептан (C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> )	ФИ	20	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 8330 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> включ.	±20 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 200 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Гептан (C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50% НКПР		±5 % НКПР	-
Гептан (C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,55 % об. д.		±0,05 % об. д.	-
Гептан (C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±5 % НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Гептан (C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> )	ИК	20	от 0 до 1,1 % об. д.	от 0 до 0,55 % об. д.	±0,05 % об. д.	-
				св. 0,55 до 1,1 % об. д.	-	±10 %
Горючие газы (ЕХ) <sup>2)</sup>	ТК, ИК	30	от 0 до 50 % НКПР		±3 % НКПР	-
Горючие газы (ЕХ) <sup>2)</sup>	ИК	30	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±3 % НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±5 %
Диоксид азота (NO <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 38,2 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 5 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Диоксид азота (NO <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 95,6 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±2 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 50 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Диоксид азота (NO <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 190,8 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> включ.	±4 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 20 до 100 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Диоксид азота (NO <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 500 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 956 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 500 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Диоксид серы (SO <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 53 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 3,8 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,76 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 3,8 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Диоксид серы (SO <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 530 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Диоксид углерода (CO <sub>2</sub> )	ИК	20	от 0 до 5 % об. д.	от 0 до 2,0 % об. д. включ.	±0,2 % об. д.	-
				св. 2 до 5 % об. д.	-	±10 %
Изобутан (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 483 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Изобутан (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Изобутан (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,65 % об. д.		±0,06 % об. д.	-
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ФИ	20	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 46,6 мг/м <sup>3</sup> )		±1 млн <sup>-1</sup>	-
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 466 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ФИ	20	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 2332 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±15 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±15 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ФИ	20	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 4665 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> включ.	±30 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 200 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±15 %
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ФИ	20	от 0 до 5000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 11662 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 500 млн <sup>-1</sup> включ.	±75 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 500 до 5000 млн <sup>-1</sup>	-	±15%
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ФИ	20	от 0 до 10000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 23324 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> включ.	±150 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 1000 до 10000 млн <sup>-1</sup>	-	±15%
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,9 % об. д.		±0,09 % об. д.	-
Кислород (O <sub>2</sub> )	ЭХ, ИК	40	от 0 до 30 % об. д.		±0,6 % об. д.	-
Ксилол (C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )	ФИ	20	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 88 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 5 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Ксилол (C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )	ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 880 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Метан (CH <sub>4</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±3 % НКПР	-
Метан (CH <sub>4</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 2,2 % об. д.		±0,1% об. д.	-
Метан (CH <sub>4</sub> )	ИК, ПП	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±3 % НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±5 %
Метан (CH <sub>4</sub> )	ИК, ПП	20	от 0 до 4,4 % об. д.	от 0 до 2,2% об. д. включ.	±0,1% об. д.	-
				св. 2,2 до 4,4 % об. д.	-	±5 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Метанол (CH <sub>3</sub> OH)	ЭХ, ФИ	20	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 26,6 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 5 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Метанол (CH <sub>3</sub> OH)	ЭХ, ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 266 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Метанол (CH <sub>3</sub> OH)	ТК, ИК	40	от 0 до 50 % НКПР		±5% НКПР	-
Метанол (CH <sub>3</sub> OH)	ТК, ИК	40	от 0 до 3 % об. д.		±0,3 % об. д.	-
Метилмеркаптан (CH <sub>3</sub> SH)	ЭХ, ФИ	20	от 0 до 15 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 30 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 3 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,6 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 3 до 15 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Метилмеркаптан (CH <sub>3</sub> SH)	ЭХ, ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 400 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Метилмеркаптан (CH <sub>3</sub> SH)	ТК, ИК	20	от 0 до 50% НКПР		±5% НКПР	-
Метилмеркаптан (CH <sub>3</sub> SH)	ТК, ИК	20	от 0 до 2,65 % об. д.		±0,3 % об. д.	-
Озон (O <sub>3</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 1 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 2 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 0,1 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,02 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 0,1 до 1 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Оксид азота (NO)	ЭХ	60	от 0 до 25 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 31 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 25 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Оксид азота (NO)	ЭХ	60	от 0 до 250 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 310 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 250 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Оксид углерода (СО)	ЭХ	60	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 116 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 100 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Оксид углерода (СО)	ЭХ	60	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 232 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> включ.	±2 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 20 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Оксид углерода (СО)	ЭХ	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 1160 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Оксид углерода (СО)	ЭХ	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 2320 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Пары нефтепродуктов (СхНу) <sup>3)</sup> (по гексану)	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5% НКПР	-
Пары нефтепродуктов (СхНу) <sup>3)</sup> (по гексану)	ТК, ИК	20	от 0 до 0,5 % об. д.		±0,05 % об. д.	-
Пары нефтепродуктов (СхНу) <sup>3)</sup> (по гексану)	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР		±5% НКПР	-
Пары нефтепродуктов (СхНу) <sup>3)</sup> (по гексану)	ИК	20	от 0 до 1 % об. д.		±0,05 % об. д.	-
Пары нефтепродуктов (СхНу) <sup>4)</sup> (по пропану)	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5% НКПР	-
Пары нефтепродуктов (СхНу) <sup>4)</sup> (по пропану)	ТК, ИК	20	от 0 до 0,85 % об. д.		±0,085 % об. д.	-

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Пары нефтепродуктов (C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> ) <sup>4)</sup> (по пропану)	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР		±5 % НКПР	-
Пары нефтепродуктов (C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> ) <sup>4)</sup> (по пропану)	ИК	20	от 0 до 1,7 % об. д.		±0,085 % об. д.	-
Пентан (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Пентан (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,7 % об. д.		±0,07 % об. д.	-
Пентан (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±5% НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Пентан (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )	ИК	20	от 0 до 1,4 % об. д.	от 0 до 0,7 % об. д. включ.	±0,07 % об. д.	-
				св. 0,7 до 1,4 % об. д.	-	±10 %
Пропан (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±3 % НКПР	-
Пропан (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,85 % об. д.		±0,07 % об. д.	-
Пропан (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±3 % НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Пропан (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	ИК	20	от 0 до 1,7 % об. д.	от 0 до 0,85 % об. д. включ.	±0,07 % об. д.	-
				св. 0,85 до 1,7 % об. д.	-	±10 %
Пропилен (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 353,5 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Пропилен (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-



Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Пропилен (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50% НКПР включ.	±5% НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Пропилен (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> )	ИК	20	от 0 до 2 % об. д.	от 0 до 1 % об. д. включ.	±0,1 % об. д.	-
				св. 1 до 2 % об. д.	-	±10 %
Сероводород (H <sub>2</sub> S)	ЭХ	60	от 0 до 7,1 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 10 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 2,5 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 2,5 до 7,1 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Сероводород (H <sub>2</sub> S)	ЭХ	60	от 0 до 30 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 43 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 7,1 млн <sup>-1</sup> включ.	±1,4 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 7,1 до 30 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Сероводород (H <sub>2</sub> S)	ЭХ	60	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 283 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Сероводород (H <sub>2</sub> S)	ЭХ	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 2827,7 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> включ.	±20 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 200 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Сероуглерод (CS <sub>2</sub> )	ФИ	20	от 0 до 15 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 47 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 3,1 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,62 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 3,1 до 15 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Синильная кислота (HCN)	ЭХ	60	от 0 до 3 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 3,4 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 0,6 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,12 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 0,6 до 3 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Синильная кислота (HCN)	ЭХ	60	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 11,3 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 2 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,4 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 2 до 10 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Синильная кислота (HCN)	ЭХ	100	от 0 до 30 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 34 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 6 млн <sup>-1</sup> включ.	±1,2 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 6 до 30 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний $T_{0,9}$ , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Стирол ( $C_8H_8$ )	ФИ	20	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 86,4 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 5 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Стирол ( $C_8H_8$ )	ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 864 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Толуол ( $C_6H_5CH_3$ )	ТК, ИК	20	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 76,6 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Толуол ( $C_6H_5CH_3$ )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Толуол ( $C_6H_5CH_3$ )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,55 % об. д.		±0,05 % об. д.	-
Фенол ( $C_6H_6O$ )	ФИ	20	от 0 до 4 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 15,6 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 0,8 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,16 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 0,8 до 4 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Формальдегид ( $H_2CO$ )	ЭХ	30	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 12,5 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 2 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,4 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 2 до 10 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Формальдегид ( $H_2CO$ )	ЭХ	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 1247 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> включ.	±20 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 200 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Фосген ( $COCl_2$ )	ЭХ	120	от 0 до 1 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 4,1 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 0,2 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,04 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 0,2 до 1 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Фосфин ( $PH_3$ )	ЭХ	60	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 7 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 2 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,3 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 2 до 5 млн <sup>-1</sup>	-	±15 %
Фосфин ( $PH_3$ )	ЭХ	60	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 28,3 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> включ.	±1 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 5 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Фтороводород (HF)	ЭХ	90	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 8,3 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 2 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,4 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 2 до 10 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Хлор (Cl <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 29,5 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 2 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,4 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 2 до 10 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Хлор (Cl <sub>2</sub> )	ЭХ	60	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 147,5 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±2 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 50 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Хлороводород (HCL)	ЭХ	70	от 0 до 20 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 30,3 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 2 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,2 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 2 до 20 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Циклогексан (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )	ФИ	20	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 686 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Циклогексан (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		± 5 % НКПР	-
Циклогексан (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,6 % об. д.		±0,06 % об. д.	-
Циклопентан (C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		± 5 % НКПР	-
Циклопентан (C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 0,7 % об. д.		±0,07 % об. д.	-
Этан (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Этан (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 1,2 % об. д.		±0,1 % об. д.	-
Этан (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50 % НКПР включ.	±5 % НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Этан (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	ИК	20	от 0 до 2,4 % об. д.	от 0 до 1,2 % об. д. включ.	±0,1 % об. д.	-
				св. 1,2 до 2,4 % об. д.	-	±10 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Этанол (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)	ЭХ, ФИ	60	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 383 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Этанол (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)	ИК, ТК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Этанол (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)	ИК, ТК	20	от 0 до 1,55 % об. д.		±0,1 % об. д.	-
Этилен (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	ЭХ, ФИ	20	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 11,7 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 5 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 5 до 10 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Этилен (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	ЭХ, ФИ	20	от 0 до 1500 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 1755 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 250 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 250 до 1500 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Этилен (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5% НКПР	-
Этилен (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	ТК, ИК	20	от 0 до 1,15 % об. д.		±0,1 % об. д.	-
Этилен (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР		±5% НКПР	-
Этилен (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	ИК	20	от 0 до 2,3 % об. д.		±0,1 % об. д.	-
Этиленоксид (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	ЭХ	140	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 18,3 мг/м <sup>3</sup> )		±0,1 млн <sup>-1</sup>	-
Этиленоксид (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	ЭХ	140	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 183 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 100 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Этиленоксид (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	ЭХ	120	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 1830 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±10 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Этиленоксид (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	ТК, ИК	20	от 0 до 50 % НКПР		±5 % НКПР	-
Этиленоксид (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	ТК, ИК	20	от 0 до 1,3 % об. д.		±0,1 % об. д.	-

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Этиленоксид (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	ИК	20	от 0 до 100 % НКПР	от 0 до 50% НКПР включ.	±5% НКПР	-
				св. 50 до 100 % НКПР	-	±10 %
Этиленоксид (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	ИК	20	от 0 до 2,6 % об. д.	от 0 до 1,3 % об. д. включ.	±0,1 % об. д.	-
				св. 1,3 до 2,6 % об. д.	-	±10 %
Этилмеркаптан (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> SH)	ЭХ, ФИ	60	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 25,8 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 1 млн <sup>-1</sup> включ.	±0,2 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 1 до 10 млн <sup>-1</sup>	-	±20 %
Этилмеркаптан (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> SH)	ЭХ, ФИ	60	от 0 до 200 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 516,6 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 50 млн <sup>-1</sup> включ.	±5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 50 до 200 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %
Этилмеркаптан (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> SH)	ТК, ИК	60	от 0 до 50 % НКПР		±5% НКПР	-
Этилмеркаптан (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> SH)	ТК, ИК	60	от 0 до 1,4 % об. д.		±0,1 % об. д.	-
Хлордифторметан (CHClF <sub>2</sub> , Хладон R22)	ПП, ИК	60	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 360 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±2,5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	-	±25 %
Хлордифторметан (CHClF <sub>2</sub> , Хладон R22)	ПП, ИК	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 3600 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Хлордифторметан (CHClF <sub>2</sub> , Хладон R22)	ПП, ИК	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 7200 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Пентафторэтан (C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> , Хладон R125)	ПП, ИК	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 10000 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %

Продолжение таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
1,1,1,2-тетрафторэтан (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> , Хладон R134a)	ПП, ИК	60	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 424 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup> включ.	±2,5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 100 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
1,1,1,2-тетрафторэтан (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> , Хладон R134a)	ПП, ИК	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 4240 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
1,1,1,2-тетрафторэтан (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> , Хладон R134a)	ПП, ИК	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 8480 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
1,1,1-трифторэтан (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> , Хладон R143a)	ПП, ИК	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 7000 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Хладон R404a (C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> +C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> +C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> )	ПП, ИК	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 8480 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Хладон R407a (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> +C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> +C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> )	ПП, ИК	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 3850 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> включ.	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Хладон R407c (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> +C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> +C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> )	ПП, ИК	60	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 385 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup>	±2,5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 100 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Хладон R407c (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> +C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> +C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> )	ПП, ИК	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 3850 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup>	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Хладон R410a (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> +C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> )	ПП, ИК	60	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 358 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 10 млн <sup>-1</sup>	±2,5 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 10 до 100 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Хладон R410a (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> +C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> )	ПП, ИК	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup> (от 0 до 3580 мг/м <sup>3</sup> )	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup>	±25 млн <sup>-1</sup>	-
				св. 100 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %

Окончание таблицы 3

Определяемый компонент	Тип применяемого сенсора <sup>1)</sup>	Время установления показаний T <sub>0,9</sub> , не более, с	Диапазон измерений концентраций определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности	
					абсолютной	относительной
Хладон R410a (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> +C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub> )	ПП, ИК	60	от 0 до 2000 млн <sup>-1</sup>	от 0 до 100 млн <sup>-1</sup>	±25 млн <sup>-1</sup>	-
			(от 0 до 7160 мг/м <sup>3</sup> )	св. 100 до 2000 млн <sup>-1</sup>	-	±25 %
Гексафторид серы (SF <sub>6</sub> )	ИК	60	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup>	от 0 до 82,4 млн <sup>-1</sup> включ.	±8,2 млн <sup>-1</sup>	-
			(от 0 до 6000 мг/м <sup>3</sup> )	св. 82,4 до 1000 млн <sup>-1</sup>	-	±10 %

<sup>1)</sup> – Тип применяемого сенсора: ЭХ - электрохимический; ФИ - фотоионизационный; ТК - термокаталитический; ИК - инфракрасный оптический; ПП - полупроводниковый. Тип сенсора указывается вместе с диапазоном измерений на корпусе датчика;

<sup>2)</sup> – Поверочным компонентом является один из следующих определяемых компонентов: метан (CH<sub>4</sub>), бутан (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>), гексан (C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>), водород (H<sub>2</sub>), ацетилен (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>), этилен (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>), пропан (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>);

<sup>3)</sup> – Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, керосин по ТУ 38.71-5810-90. Поверочным компонентом является гексан (C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>);

<sup>4)</sup> – Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, керосин по ТУ 38.71-5810-90. Поверочным компонентом является пропан (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>).

Значения НКПР для горючих газов и паров в соответствии с ГОСТ 31610.20-1-2020, для паров нефтепродуктов - в соответствии с государственными стандартами на нефтепродукты конкретного вида;

Пересчет в массовую концентрацию указан в нормальных условиях эксплуатации (20 °С и 760 мм рт. ст., 60 % отн. влажности).

Таблица 4 – Дополнительные метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	±0,2
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов от изменения относительной влажности в диапазоне рабочих условий, на каждые 10 %, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	±0,2

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В	24±6
Потребляемая мощность, Вт, не более: - стандартное исполнение - арктическое исполнение	1,5 5
Габаритные размеры, мм, не более: - высота - ширина - длина	183 143 107
Масса, кг, не более: - алюминиевый корпус - стальной корпус	2 3,5
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С  - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа	от -10 до +60 (Бинар-XX-XX1-X) от -40 до +60 (Бинар-XX-X1X-X, Бинар-XX-1XX-X) от - 60 до +60 (арктическое исполнение) 95, при температуре +35 °С от 87,8 до 119,7
Средний срок службы, лет, не менее	10
Средняя наработка на отказ, ч	30000
Маркировка взрывозащиты	1Ex d [ib Gb] IIC T6 Gb X
Время прогрева, мин, не более: - для сенсоров фотоионизационного, термокаталитического, инфракрасного, полупроводникового - для электрохимических сенсоров	3 10

### Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку термографическим способом или лазерной гравировкой и на титульный лист руководства по эксплуатации, паспорта типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Газоанализатор Бинар-XX-XXX-X	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	КДГА.413214.002.000 РЭ	1 экз. на поставку
Паспорт	КДГА.413214.002.000 ПС	1 экз.
Насадка для подачи газа	-	1 шт. на поставку
Программное обеспечение	-	по отдельному заказу
Козырек защиты от погодных условий	-	по отдельному заказу
Комплект для монтажа на трубу	-	по отдельному заказу
Комплект для монтажа в воздуховоде	-	по отдельному заказу
Кабельный ввод	-	по отдельному заказу
Магнитный ключ	-	по отдельному заказу



**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделе 1.4 «Устройство и принцип работы» документа КДГА.413214.002.000 РЭ «Газоанализаторы Бинар-XX-XXX-Х. Руководство по эксплуатации».

**Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (п. 4.43);

ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия;

ГОСТ ИЕС 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ТУ 4215-001-11425056-2015 с изм. 2 Газоанализаторы Бинар XX-XXX-Х Технические условия.

**Изготовитель**

Акционерное общество «АРТГАЗ» (АО «АРТГАЗ»)

ИНН 7726703380

Адрес: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, помещ. 282

Тел.: +7 (495) 123-34-14

E-mail: info@art-gas.com

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: +7 (495) 437-55-77/437-56-66

Web сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

**в части вносимых изменений**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»  
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, эт. 4, помещ. I, ком. 28

Телефон: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312126.