

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18588 от 17 марта 2025 г.

Срок действия до 25 декабря 2029 г.

Наименование типа средств измерений:

Измерители прочности бетона ПОС-МГ4

Производитель:

ООО «СКБ Стройприбор», г. Челябинск, Российская Федерация

Выдан:

ООО «СКБ Стройприбор», г. Челябинск, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 26.51.62.120-007-2019 «Измерители прочности бетона ПОС-МГ4. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 17.03.2025 № 32

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко

Секрет *М.А.Кисленко*

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 17 марта 2025 г. № 18588

Наименование типа средств измерений и их обозначение: измерители прочности бетона ПОС-МГ4

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: диапазон измерений силы; пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы, значения приведены в таблице 2 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий; нормальные условия измерений; диапазон показаний прочности бетона, значения приведены в таблице 2 Приложения, в соответствии с таблицами 3, 4 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 5 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по МП 26.51.62.120-007-2019 «Измерители прочности бетона ПОС-МГ4. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: в соответствии с разделом «Поверка» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», Приказ Росстандарта от 22 октября 2019 г. № 2498 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотографии общего вида средств измерений носят иллюстративный характер и представлены на рисунках 1 – 5 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 6 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 77107-19, на 6 листах.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1583 от 22.09.2020 г.)

Измерители прочности бетона ПОС-МГ4

Назначение средства измерений

Измерители прочности бетона ПОС-МГ4 (далее по тексту – измерители) предназначены для измерений силы в процессе нагружения.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителей основан на преобразовании силы, приложенной к испытываемому образцу, тензометрическим преобразователем в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально приложенной силе. Электрический сигнал регистрируется электронным блоком, где он обрабатывается, и результаты измерений в единицах силы отображаются на дисплее, передаются в память измерителя и на персональный компьютер через USB-порт.

Измерители состоят из электронного блока и силовозбудителя, в зависимости от метода испытаний силовозбудитель устанавливается в опорную плиту с двумя или тремя опорами, либо в раму. Силовозбудитель состоит из рабочего цилиндра, датчика силы и поршневого насоса. Электронный блок может встраиваться в силовозбудитель, либо соединяется с ним посредством радиоканала или кабеля с разъемом. На лицевой панели электронного блока расположены ЖК - дисплей и органы управления. Питание измерителя осуществляется от элементов питания либо от аккумулятора.

Измерители выпускаются шести модификаций, обозначение модификаций имеет следующую структуру: ПОС-ХМГ4.В.З, где

ПОС-МГ4 – обозначение типа

Х – наибольший предел измерений;

В – вариант исполнения;

З – исполнение электронного блока.

Измерители, предназначенные для испытаний бетона методом отрыва со скалыванием и вырыва анкерных устройств, выпускаются в четырех вариантах исполнения:

О – силовозбудитель с осевым расположением рабочего цилиндра и поршневого насоса;

ОД – силовозбудитель с осевым расположением рабочего цилиндра и поршневого насоса, комплектуется датчиком перемещения, измеряющим хода штока рабочего цилиндра;

П – силовозбудитель с параллельным расположением рабочего цилиндра и поршневого насоса,;

У – исполнение с усиленными опорной плитой и силовозбудителем.

Вариант исполнения СКОЛ – предназначен для испытаний бетона методом скалывания ребра и методом отрыва со скалыванием, комплектуется рамой и опорной плитой.

Вариант исполнения ПБ – предназначен для испытаний прочности ячеистого бетона методом вырыва спирального анкера.

Исполнения электронного блока:

1 – электронный блок встроен в силовозбудитель;

2 – электронный блок соединяется с силовозбудителем посредством кабеля с разъемом;

3 – электронный блок соединяется с силовозбудителем посредством радиоканала.

Общий вид измерителей представлен на рисунках 1-5.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 6.



Рисунок 1 – Общий вид измерителей мод. ПОС-60МГ4.О и ПОС-60МГ4.ОД



Рисунок 2 – Общий вид измерителей мод. ПОС-60МГ4.П



Рисунок 3 – Общий вид измерителей мод. ПОС-100МГ4.У



Рисунок 4 – Общий вид измерителей
мод. ПОС-60МГ4.СКОЛ



Рисунок 5 – Общий вид измерителей
мод. ПОС-2МГ4.ПБ



Электронный блок исполнения 2 и 3

Электронный блок исполнения 1

Рисунок 6 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Измерители имеют встроенное программное обеспечение (ПО) (микропрограмма электронного блока с защитой от считывания и перезаписи), управляющая программа электронного блока реализует сбор, передачу, обработку, хранение и представление измерительной информации. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует среднему уровню по Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения (ПО)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	POS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.01
Цифровой идентификатор ПО	E7F9

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений силы, кН	
– мод. ПОС-60МГ4.СКОЛ, ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П	от 5,0 до 60,0
– мод. ПОС-100МГ4.У	от 7,0 до 100,0
– мод. ПОС-2МГ4.ПБ	от 0,2 до 2,0

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы, %	± 2
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий, %/10 °C	$\pm 0,8$
Нормальные условия измерений – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха, %, не более	от +15 до +25 80
Диапазон показаний прочности бетона, МПа – мод. ПОС-60МГ4.СКОЛ, ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П, ПОС-100МГ4.У – мод. ПОС-2МГ4.ПБ	от 5 до 100 от 0,5 до 8,0

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Электропитание измерителей: – от элементов питания напряжением, В – от аккумуляторной батареи напряжением, В	от 1,8 до 3,5 от 3,3 до 4,5
Потребляемая мощность, Вт, не более – с элементами питания – с аккумуляторной батареей	0,3 0,8
Ход штока рабочего цилиндра, мм, не менее – мод. ПОС-60МГ4.СКОЛ, ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П, ПОС-100МГ4.У – мод. ПОС-2МГ4.ПБ	9 20
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха, %, не более	от – 20 до + 50 95
Средняя наработка на отказ, ч	5 000
Средний срок службы, лет	10

Таблица 4 – Максимальные габаритные размеры и масса

Обозначение модификаций	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	высота	ширина	длина	
ПОС-60МГ4.СКОЛ; ПОС-60МГ4.П	520	200	290	5,5
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на трех опорах	650	200	290	6,4
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на двух опорах	620	230	250	4,5
ПОС-60МГ4.СКОЛ (в раме)	360	150	740	10,0
ПОС-60МГ4.П.1	550	90	220	4,5
ПОС-100МГ4.У	660	200	230	12,4
ПОС-2МГ4.ПБ	440	160	200	3,0

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации в центре листа, и фотохимическим способом на табличку, закрепленную на силовозбудителе измерителя.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Кол-во	Примечание
Измеритель прочности бетона ПОС-МГ4	1 шт.	
Тяга с микрометрической гайкой	1 шт.	кроме ПОС-60МГ4.ОД
Рама (метод скалывания ребра)	1 шт.	для ПОС-60МГ4.СКОЛ
Опорное кольцо		для ПОС-2МГ4.ПБ
Анкерное устройство Ø 24мм	1 шт.	для всех модификаций кро- ме ПОС-2МГ4.ПБ
Анкерное устройство Ø 16мм	2 шт.	
Спиральный анкер Ø 8мм	1 шт.	для ПОС-2МГ4.ПБ
Устройство для установки спирального анкера	1 шт.	
Соединительный кабель для электронного блока	1 шт.	исполнение 2
Руководство по эксплуатации Э 26.51.62.120-007-2019	1 экз.	
Методика поверки МП 26.51.62.120-007-2019	1 экз.	
Кабель связи с ПК	1 шт.	
Программное обеспечение	1 шт.	

Поверка

осуществляется по документу МП 26.51.62.120-007-2019 «Измерители прочности бетона ПОС-МГ4. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Челябинский ЦСМ» 08.10.2019.

Основные средства поверки:

– динамометры 2-го разряда, согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений силы, утвержденной приказом Росстандарта от 22 октября 2019 г. № 2498.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт (формуляр) СИ.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационных документах

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям прочности бетона ПОС-МГ4

Приказ Росстандарта от 22 октября 2019 г. № 2498 « Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы».

ТУ 26.51.62.120-007-12585810-2019 «Измеритель прочности бетона ПОС-МГ4. Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Специальное конструкторское бюро Стройприбор» (ООО «СКБ Стройприбор»)

ИНН 7447005971

Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 11-Г

Телефон (факс): (351) 277-8-555

Web-сайт: www.stroypribor.com

E-mail: info@stroypribor.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области» (ФБУ «Челябинский ЦСМ»)

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.101


Телефон (факс): (351) 232-04-01

E-mail: stand@chelcsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Челябинский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311280 от 16.11.2015 г.

Заместитель


Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



А.В. Кулешов

25» 09 2020 г.

КОПИЯ ВЕРНА

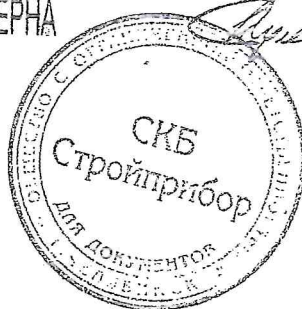

В.В. Гулунов