

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18041 от 27 сентября 2024 г.

Срок действия до 17 октября 2029 г.

Наименование типа средств измерений:

Системы измерительные «АЛКО-1М»

Производитель:

АО «АПЗ», г. Арзамас, Нижегородская обл., Российская Федерация

Выдан:

АО «АПЗ», г. Арзамас, Нижегородская обл., Российская Федерация

Документ на поверку:


**ЛГФИ.407219.004-30 МИ «Государственная система обеспечения единства измерений.
Системы измерительные «АЛКО-1М». Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27.09.2024 № 103

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 21.05.2025 действует в редакции изменения № 1, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21.05.2025 № 62).

Заместитель Председателя

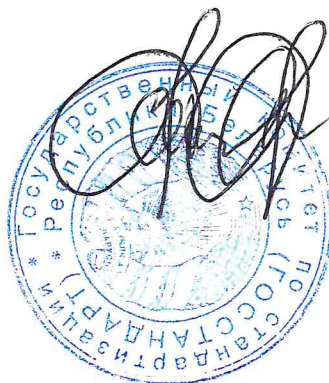

И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции изменения № 1 от 21.05.2025)

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 27 сентября 2024 г. № 18041

Наименование типа средств измерений и их обозначение: системы измерительные «АЛКО-1М»

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: пределы допускаемой относительной погрешности системы при измерении суммарного объема; диапазон измерений крепости; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости; пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20 °С; диапазон температур измеряемой среды; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, значения приведены в таблице 3 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: давление измеряемой среды; длина соединительных кабелей между СВ и датчиками; напряжение питания; потребляемая мощность; время готовности системы к работе; степень защиты датчиков; масса СВ; средняя наработка на отказ; средний срок службы, значения приведены в таблице 3 Приложения, в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 4 Приложения.

При проведении поверки, средства измерений, используемые в системах измерительных «АЛКО-1М», могут применяться в составе системы при условии их наличия в Государственном Реестре средств измерений Республики Беларусь.

К применению в Республике Беларусь допущены системы измерительные «АЛКО-1М» только в составе с первичными преобразователями расхода ППР-7 с диаметром условного прохода $D_u < 50$ мм, $D_u = 50$ мм (согласно решению НТК № 11-17 от 28.11.2017).

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по ЛГФИ.407219.004-30 МИ «Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерительные «АЛКО-1М». Методика поверки», утвержденной в 2014 г.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: отсутствует.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия», Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости

в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 2 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 59515-14, на 8 листах.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

Регистрационный № 59515-14

Лист № 1
Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Системы измерительные «АЛКО-1М»

Назначение средства измерений

Системы измерительные «АЛКО-1М» (в дальнейшем – системы) предназначены для измерений и учета объема коньячных спиртов, спиртных напитков (в том числе водки), вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков, пива и напитков на основе пива (в дальнейшем – измеряемая среда) с удельной электропроводностью от $4 \cdot 10^{-3}$ до 10 См/м, объемной концентрации (в дальнейшем - крепость) и объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, температуры измеряемой среды, а также формирования информации для передачи в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Описание средства измерений

Принцип действия систем основан на измерении и учете объема (объемного расхода), процентного содержания (концентрации), температуры измеряемой среды с последующим расчетом объема безводного спирта, а также подсчете количества бутылок, прошедших по линии розлива.

Система включает в себя специализированный вычислитель СВ-5 (в дальнейшем – СВ) и устройства, именуемые в дальнейшем датчиками:

- первичный преобразователь расхода ГПР-7 электромагнитный для измерений расхода среды;
- оптический спиртомер «ИКОНЭТ-МП» (регистрационный № 19880-07) или плотномер-спиртомер ПЛОТ-ЗС-М-Ц (регистрационный № 58753-14), являющийся для СВ датчиком объемной концентрации этилового спирта в измеряемой среде;
- термопреобразователь сопротивления платиновый с градуировочной характеристикой 100П типа ТС-Б-Р (регистрационный № 43287-09) или ТС-Б, ТС-Б-Ех (регистрационный № 72995-20) или ТСП-Н (регистрационный № 38959-17), или ТП-9201-02 (регистрационный № 48114-11) или ТСП-1199, ТСП-1199Ехd (регистрационный № 49041-12) или ТСП012 (регистрационный № 43587-10) или ОВЕН ДТС035-100П.А4.60.МГ, ОВЕН ДТС035-100П.А4.60.МГ Ех (регистрационный № 28354-10) для измерений температуры среды;
- универсальный счетчик бутылок УСБ-3 (УСБ-5) или управляющий модуль учета продукции УМУП (в дальнейшем - счетчик бутылок) для измерений количества бутылок, прошедших через зону контроля счетчика.

Сигналы от всех перечисленных датчиков передаются на специализированный вычислитель СВ, который производит их обработку, индикацию и архивацию параметров измеряемой среды.

Для визуализации всех показателей измеряемой среды, вывода их на печать, формирование информации для передачи в ЕГАИС система должна быть подключена к устройству сбора и передачи данных – персональному компьютеру (УСПД-ПК).

Один контроллер связи КС позволяет подключать до 4-х систем к одному УСПД-ПК. Возможно каскадное включение 4-х КС. В этом случае имеется возможность использовать один УСПД-ПК для вывода информации с 13-ти систем.

Система выводит на индикатор СВ и экран дисплея следующие параметры: суммарный объем измеряемой среды при рабочей температуре и приведенный к температуре 20 °С; суммарный объем безводного спирта, содержащегося в измеряемой среде, приведенный к температуре 20 °С; текущий объемный расход; крепость измеряемой среды; температуру измеряемой среды; суммарное количество бутылок, прошедших по линии розлива; текущее время и текущую дату; сообщения об ошибках.

Система также обеспечивает: сохранение ранее измеренных значений объемов, крепости, количества бутылок и времени наработки при отключении питания системы с отметкой в памяти момента отключения; индикацию показателей за смену с возможностью сброса текущей индикации; хранение в архиве шестнадцати сброшенных информации о показателях за смену; создание суточного архива глубиной 5 лет, часового глубиной 6 месяцев и возможность вывода из архивов на собственный индикатор информации о суммарных объемах, крепости, температуре, количестве бутылок, отключении питания системы и ошибках за любые сутки пяти лет или за любой час шести месяцев по отношению к текущей дате, индицируемой СВ; вывод на экран УСПД-ПК информации из архивов; возможность корректировки текущей даты и текущего времени, изменения масштабирующего коэффициента, ввода кода пользователя системы, изменения пароля пользователя.

Условное обозначение системы состоит из наименования «АЛКО-1М», значения Ду входящего в комплект поставки ППР-7, обозначения исполнения в зависимости от типа спиртомера и диапазона измеряемой крепости (только для систем, укомплектованных спиртомером).

В зависимости от типа спиртомера и диапазона измерений крепости система выпускается в нескольких исполнениях:

- «2» – спиртомер типа «ИКОНЭТ-МП» «1», диапазон от 3 до 60 %;
- «3» – спиртомер типа «ИКОНЭТ-МП» «3», диапазон от 38 до 75 %;
- «4» – спиртомер типа ПЛОТ-3С-М-Ц-А, диапазон от 3 до 60 %;
- «5» – спиртомер типа ПЛОТ-3С-М-Ц-Б, диапазон от 36 до 75 %.

ППР-7 в комплекте с СВ, а также каждый из остальных датчиков системы обладают взаимозаменяемостью.


Конкретный состав системы (наличие в системе счетчиков бутылок, спиртомера, модемов, КС) определяется вариантом поставки (по заказу потребителя).

Наименование систем, их заводские номера, основные технические характеристики указываются термотрансферным методом на информационный шильдик, устанавливаемый на монтажный шкаф. Заводские номера систем состоят из арабских цифр по системе нумерации предприятия-изготовителя. Пример информационного шильдика представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Пример информационного шильдика

Общий вид СВ и места пломбирования приведены на рисунке 2.

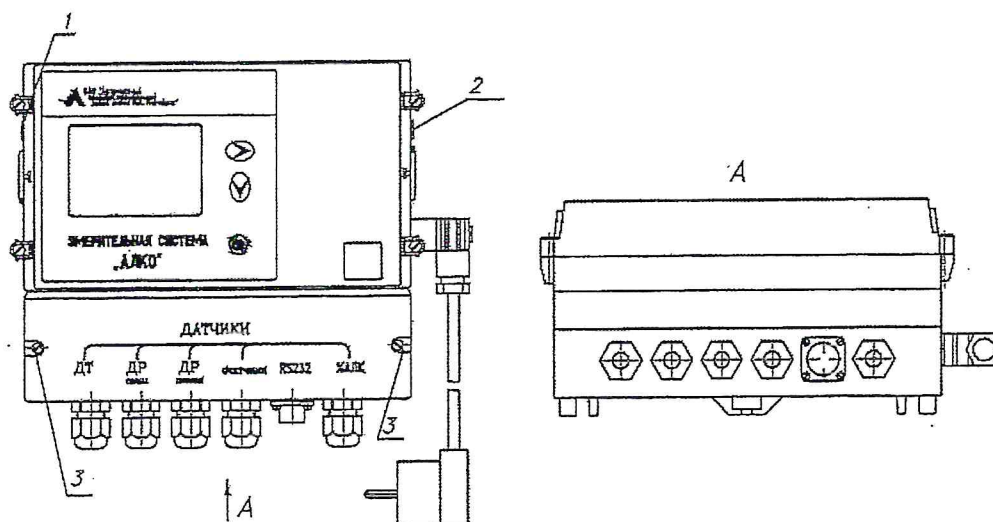

1 — пломба завода-изготовителя; 2 — клеймо поверителя;
3 — пломбы специалиста, проводившего пуско-наладочные работы

Рисунок 2 – Общий вид СВ и места пломбирования

Схема соединений составных частей системы приведена на рисунке 3.

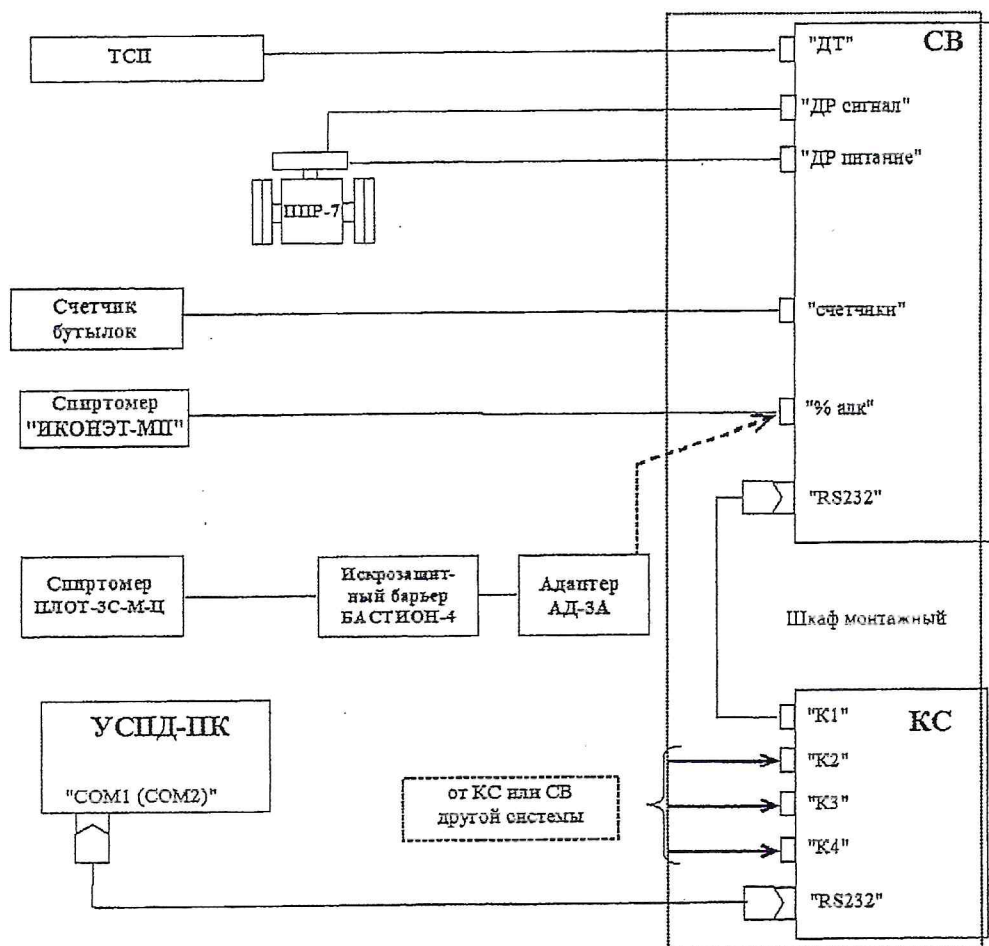


Рисунок 3 – Схема соединений составных частей системы

Программное обеспечение

Программное обеспечение, записанное в микроконтроллер СВ, обрабатывает данные, поступающие от датчиков, производит вычисление расхода, объемов, температуры измеряемой среды, определяет внештатные ситуации с формированием сигнала аварии, производит отображение текущей и архивной информации на собственном индикаторе, формирует часовой и суточный архивы, обеспечивает передачу данных на УСЦД-ПК.

Запись программного обеспечения в микроконтроллер осуществляется через технологический разъем, находящийся внутри электронного блока СВ. При выходе из производства СВ пломбируется пломбами ОТК и поверителя согласно рисунку 2. Конструкция СВ не допускает каким-либо иным способом запись программного обеспечения в микроконтроллер.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения, записанного в СВ

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
W_5_15.txt	ЛГФИ.00242-01	версия 5.15	07A3	16-ти битная сумма всех байт, входящих в файл кода программы

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - С, в соответствии с МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Диапазоны расходов и масса ППР-7 в зависимости от диаметра условного прохода

Наименование параметра	Значение параметра						
	20	32	40	50	80	100	150
Диаметр условного прохода ППР-7, мм							
Максимальный расход ($Q_{\max}$), л/с ($\text{м}^3/\text{ч}$)	1,00 (3,60)	3,33 (12,0)	4,00 (14,4)	6,4 (23,04)	22,2 (80)	33,3 (120)	69,4 (250)
Минимальный расход ($Q_{\min}$), л/с ($\text{м}^3/\text{ч}$)	0,034 (0,12)	0,22 (0,80)	0,40 (1,44)	0,64 (2,30)	0,8 (2,88)	1,26 (4,54)	3,2 (11,52)
Масса ППР-7, кг, не более	4,0	4,3	5,0	6,0	9,0	11,0	19,5

Таблица 3 – Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности системы при измерении суммарного объема, %	$\pm 0,5$
Диапазон измерений крепости, %, для систем исполнений: «2» и «4» «3» «5»	от 3 до 60 от 38 до 75 от 36 до 75
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %, для систем исполнений: «3», «4», «5» «2» в диапазоне: от 9 до 60 % от 3 до 9 %	$\pm 0,2$ $\pm 0,2$ $\pm 0,25$

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20 °С, %:	
- в диапазоне крепости от 38 до 75 %	±0,8
- в диапазоне крепости от 20 до 38 %	±1,5
- в диапазоне крепости от 8 до 20 % для исполнения «4» и в диапазоне крепости от 9 до 20 % для исполнения «2»	±3,0
- в диапазоне крепости от 6 до 8 % для исполнения «4» и в диапазоне крепости от 7 до 9 % для исполнения «2»	±4,0
- в диапазоне крепости от 3 до 6 % для исполнения «4» и в диапазоне крепости от 3 до 7 % для исполнения «2»	$\pm(\Delta S \cdot 100)/S^*$
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от - 30 до +80**
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С	±0,5
Давление измеряемой среды, МПа, не более:	
- для систем со спиртомером ПЛОТ-3С-М-Ц и систем без спиртомера	1,6
- для систем со спиртомером «ИКОНЭТ-МП»	0,25
Длина соединительных кабелей между СВ и датчиками, м, не более	50
Напряжение питания:	
- частота, Гц	50±1
- напряжение, В	220 ⁺²² ₋₃₃
Потребляемая мощность, В·А, не более	250
Система устойчива к воздействию внешнего магнитного поля:	
- постоянного напряженностью, А/м	до 400
- переменного частотой 50 Гц, напряженностью, А/м	до 80
Время готовности системы к работе, с, не более	
- для систем, укомплектованных спиртомером ПЛОТ-3С-М-Ц	30
- для систем, укомплектованных спиртомером «ИКОНЭТ-МП»	600
Степень защиты датчиков системы по ГОСТ 14254-2015, не менее	IP54
Масса СВ, КС, кг, не более	4,0
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	12 000
Средний срок службы, лет, не менее	12
* – где ΔS – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %; S – измеряемое значение крепости, %.	
** – диапазон может быть ограничен эксплуатационной документацией изготовителя спиртомера в зависимости от его исполнения и крепости измеряемой спиртосодержащей жидкости.	

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель вычислителя СВ методом трафаретной печати и на титульный лист паспорта - типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Система измерительная	«АЛКО-1М»	1 экз.	Состав согласно заказу
Комплект эксплуатационной документации	—	1 компл.	
Системы измерительные «АЛКО-1М». Методика поверки.	—	1 экз.	

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2.2 ЛГФИ.407219.004 РЭ «Система измерительная «АЛКО-1М». Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2466 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»;

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

ЛГФИ.407219.004 ТУ Системы измерительные «АЛКО-1М». Технические условия.

Изготовитель

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина» (АО «АПЗ»)

ИНН 5243001742

Адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8а

Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26

www.aopz.com

E-mail: apz@aopz.com

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, д. 46
Телефон / факс (495) 437-55-77 / 437-56-66.
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502B7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Рудольфович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

Е.Р.Лазаренко

«13» августа 2024 г.

