

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14604 от 2 декабря 2021 г.

Срок действия до 9 сентября 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414

Производитель:

ООО «ЭРИС», г. Чайковский, Пермский край, Российская Федерация

Выдан:

ООО «ЭРИС», г. Чайковский, Пермский край, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 128-221-2020 «Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414. Методика поверки» (для газоанализаторов, произведенных до 22.06.2025)


МП 128-221-2020 с изменением № 1 «Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414. Методика поверки» (для газоанализаторов, произведенных с 23.06.2025)

Интервал времени между государственными поверками: **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.12.2021 № 122

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 23.06.2025 действует в редакции изменения № 2, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23.06.2025 № 77).

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции изменения № 2 от 23.06.2025)

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 2 декабря 2021 г. № 14604

Наименование типа средств измерений и их обозначение: газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицами 2 – 5 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: в соответствии с таблицами 6 – 8 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 9 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по МП 128-221-2020 «Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414. Методика поверки» (для газоанализаторов, произведенных до 22.06.2025);

поверка осуществляется по МП 128-221-2020 с изменением № 1 «Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414. Методика поверки» (для газоанализаторов, произведенных с 23.06.2025)

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: отсутствует.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», Постановление правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (п. 4.43), Приказ Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах», ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия», ГОСТ Р 52350.29.1-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов», Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 506 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотографии общего вида средств измерений носят иллюстративный характер и представлены на рисунках 2 – 5 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунками 2 – 5 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 65108-16, на 30 листах.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414

Назначение средства измерений

Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 (далее – газоанализаторы) предназначены для измерений содержания токсичных, горючих, углеводородных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов.

Описание средства измерений

Принцип действия газоанализаторов основан на измерении и преобразовании сигнала входящих в его состав сенсоров (чувствительных элементов):

- электрохимический при измерении объёмной доли, массовой концентрации токсичных газов, O_2 ;
- оптический инфракрасный и термодаталитический при измерении объёмной доли, массовой концентрации, ДВК горючих и углеводородных газов, в том числе газов образованных в результате испарения горючих жидкостей таких как пары нефти, бензина, авиационного топлива, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива, керосина;
- фотоионизационный при измерении массовой концентрации и объёмной доли вредных веществ.

Газоанализатор состоит из электронного блока и заменяемых сенсоров, размещённых в корпусе с креплением на одежду. Элемент питания ПГ ЭРИС-414 размещён в изолированном отсеке корпуса, имеющем собственную крышку и отделённом стенками от остального внутреннего объёма. Элемент питания ПГ ЭРИС-411 размещён в основном корпусе прибора.

Газоанализатор проводит анализ определяемых компонентов газовой смеси (в зависимости от исполнения), осуществляет непрерывный мониторинг и отображение измеренных данных и показаний состояний газоанализатора на буквенно-цифровом дисплее (для ПГ ЭРИС-411 – низкотемпературном жидкокристаллическом дисплее с многоцветной подсветкой, для ПГ ЭРИС-414 – низкотемпературном OLED графическом дисплее).

Газоанализатор обеспечивает:

- непрерывное измерение объёмной доли и (или) массовой концентрации газов в воздухе и отображение измеренных значений на дисплее;
- диффузионный забор пробы воздуха (в отсутствии подключённого насоса);
- непрерывный забор пробы воздуха при подключении ручного или моторизованного насоса на расстоянии до 30 м от места забора;
- автоматическую и принудительную настройку нуля;
- самодиагностику при включении и во время работы;

- ведение и сохранение в энергонезависимой памяти архива событий. Вместимость архива до 70000 записей с перезаписью старых событий;
- подсчет показателей STEL (предельно допустимой концентрации ПДК) и TWA (среднесменное значение предельно допустимой концентрации ПДК);
- обмен данными с устройствами на базе Android;
- выбор единиц измерений с помощью меню прибора;
- интеграцию прибора в систему мониторинга персонала в комплекте с персональным многофункциональным трекером, базовой станцией, радиомаяками, кнопкой SOS (устройством персональной безопасности) и специализированным ПО (опционально);
- определение падения (датчик удара) и положения (опционально);
- управление моторизированным насосом (опция);
- измерение среднесменного значения ПДК с записью результатов во внутреннюю энергонезависимую память прибора;
- запись событий и измеренных значений во внутреннюю энергонезависимую память с возможностью дальнейшего анализа на ПК;
- передачу данных по радиоканалу по протоколу E-WIRE, LORA, LORAWAN (в зависимости от исполнения);
- передачу цифровых сигналов, управление режимами работы бесконтактно по стандарту связи Bluetooth, NB-IoT, LTE, GSM, GPRS, MXair, WiSUN, Zigbee, IEEE 802.15.4, ISA100.11a (по заказу);
- определение геолокации GPS, ГЛОНАСС (опционально);
- фотофиксацию (опционально);
- видеофиксацию (опционально);
- передачу данных на ПК при помощи кабеля передачи данных. Кабель подключается к компьютеру через USB порт.

Газоанализаторы оснащены цифровой индикацией, световой, звуковой, вибрационной предупреждающей сигнализацией о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений. Пороги сигнализации устанавливаются изготовителем или потребителем.

Газоанализаторы выпускаются 4 исполнений: ПГ ЭРИС-411-1, ПГ ЭРИС-411-2, ПГ ЭРИС-414-1, ПГ ЭРИС-414-2 – отличающихся конструкцией, количеством устанавливаемых сенсоров и количеством определяемых компонентов.

Газоанализаторы могут быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.

Заводской номер газоанализаторов наносится типографским способом или методом лазерной гравировки на маркировочную табличку, закрепленную на заднюю часть корпуса газоанализаторов способом наклейки, и имеет буквенно-цифровой формат. Маркировочные таблички с указанием заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунке 1.

Конструкцией газоанализаторов не предусмотрена возможность нанесения знака поверки.

Для защиты от несанкционированного доступа в газоанализаторах предусмотрена установка разрушаемой пломбы-наклейки изготовителя. Общий вид газоанализаторов с указанием мест пломбирования представлен на рисунках 2-5.



Рисунок 1 – Маркировочные таблички газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с указанием заводского номера и знака утверждения типа



Рисунок 2 – Общий вид газоанализатора портативного ПГ ЭРИС-411-1 и схема пломбировки

Рисунок 3 – Общий вид газоанализатора портативного ПГ ЭРИС-411-2 и схема пломбировки

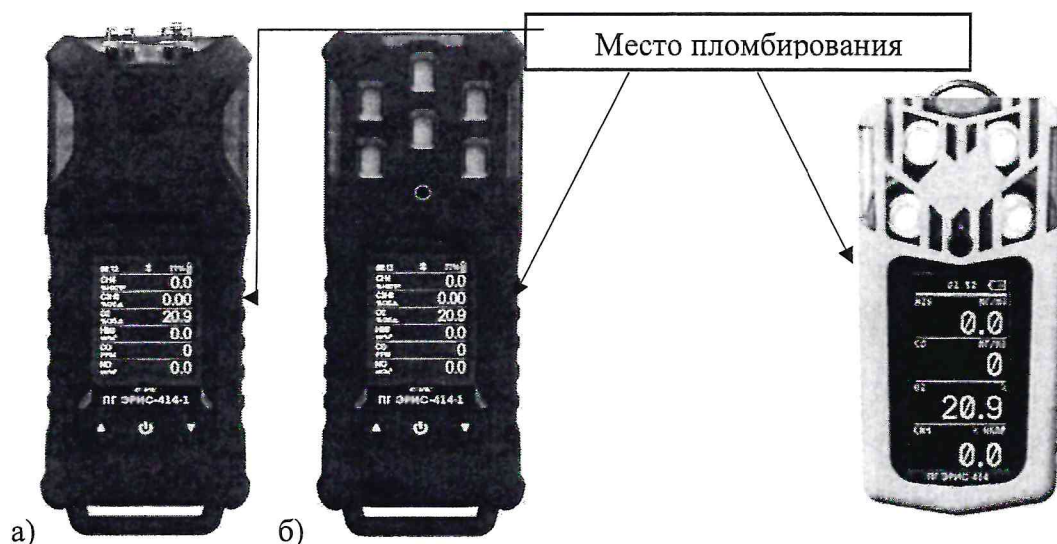


Рисунок 4 – Общий вид газоанализатора портативного ПГ ЭРИС-414-1 ((а) с насосом; б) без насоса) и схема пломбировки

Рисунок 5 – Общий вид газоанализатора портативного ПГ ЭРИС-414-2 и схема пломбировки

Программное обеспечение

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения (ПО) газоанализаторов указаны в таблице 1.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.

Таблица 1— Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Газоанализатор	ПГ ЭРИС-411	ПГ ЭРИС-414
Идентификационное наименование ПО	FW_PG411	FW_PG414
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже v01.00	не ниже v01.00
Цифровой идентификатор ПО	-	

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 – 8.

Таблица 2 – Диапазоны измерений объемной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с электрохимическим сенсором (ЕС)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ)		Пределы допускаемой основной погрешности, %		Время установившегося выходного сигнала Т _{0,9} ⁽³⁾ с
		объемной доли, % (млн ⁻¹)	массовой концентрации ⁽²⁾ , мг/м ³	приведенной к ДИ	относительной	
1	2	3	4	5	6	7
Кислород O ₂	ЕС-O ₂ -30	от 0 до 10 % включ.	-	±5	-	10
		св. 10 до 30 %	-	-	±5	
Диоксид серы SO ₂	ЕС-SO ₂ -5	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 2,66 включ.	±15	-	15
		св. 1 до 5 млн ⁻¹	св. 2,66 до 13,3	-	±15	
	ЕС-SO ₂ -20	от 0 до 4 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 10,64 включ.	±15	-	
		св. 4 до 20 млн ⁻¹	св. 10,64 до 53,2	-	±15	
	ЕС-SO ₂ -50	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 26,6 включ.	±10	-	
		св. 10 до 50 млн ⁻¹	св. 26,6 до 133	-	±10	
	ЕС-SO ₂ -100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 53,2 включ.	±10	-	
		св. 20 до 100 млн ⁻¹	св. 53,2 до 266,0	-	±10	
Сероводород H ₂ S	ЕС-SO ₂ -2000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 266 включ.	±20	-	15
		св. 100 до 2000 млн ⁻¹	св. 266 до 5320	-	±20	
	ЕС-H ₂ S-7,1	от 0 до 7,1 млн ⁻¹	от 0 до 10,0 включ.	±15	-	
	ЕС-H ₂ S-20	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 7,1 включ.	±10	-	
		св. 5 до 20 млн ⁻¹	св. 7,1 до 28,4	-	±10	
	ЕС-H ₂ S-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 7,1 включ.	±10	-	
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 7,1 до 71	-	±10	
	ЕС-H ₂ S-100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 14,2 включ.	±10	-	
		св. 10 до 100 млн ⁻¹	св. 14,2 до 142,0	-	±10	
	ЕС-H ₂ S-200	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 28,4 включ.	±15	-	
		св. 20 до 200 млн ⁻¹	св. 28,4 до 284	-	±15	
	ЕС-H ₂ S-2000	от 0 до 200 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 284 включ.	±15	-	
		св. 200 до 2000 млн ⁻¹	св. 284 до 2840	-	±15	

1	2	3	4	5	6	7
Цианистый водород HCN	ЕС-HCN-10	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,56 включ.	±10	-	10
		св. 0,5 до 10 млн ⁻¹	св. 0,56 до 11,2	-	±10	
	ЕС-HCN-15	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,12 включ.	±15	-	
		св. 1 до 15 млн ⁻¹	св. 1,12 до 16,8	-	±15	
	ЕС-HCN-30	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 5,6 включ.	±15	-	
		св. 5 до 30 млн ⁻¹	св. 5,6 до 33,6	-	±15	
Фтористый водород HF	ЕС-HF-5	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,08 включ.	±20	-	90
		св. 0,1 до 5 млн ⁻¹	св. 0,08 до 4,15	-	±20	
	ЕС-HF-10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,8 включ.	±20	-	
		св. 1 до 10 млн ⁻¹	св. 0,8 до 8,3	-	±20	
	ЕС-HF-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 4,2 включ.	±20	-	
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 4,2 до 42	-	±20	
Фосфин PH ₃	ЕС-PH ₃ -1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,14 включ.	±20	-	10
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹	св. 0,14 до 1,41	-	±20	
	ЕС-PH ₃ -5T	от 0 до 0,16 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,225 включ.	±10	-	
		св. 0,16 до 5 млн ⁻¹	св. 0,225 до 7,05	-	±10	
	ЕС-PH ₃ -5	от 0 до 0,16 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,225 включ.	±20	-	
		св. 0,16 до 5 млн ⁻¹	св. 0,225 до 7,05	-	±20	
Оксид углерода CO	ЕС-CO-200	от 0 до 15 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 17,4 включ.	±20	-	10
		св. 15 до 200 млн ⁻¹	св. 17,4 до 232	-	±20	
	ЕС-CO-500	от 0 до 15 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 17,4 включ.	±20	-	
		св. 15 до 500 млн ⁻¹	св. 17,4 до 580	-	±20	
	ЕС-CO-5000	от 0 до 1000 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1160 включ.	±20	-	
		св. 1000 до 5000 млн ⁻¹	св. 1160 до 5800	-	±20	
Аммиак NH ₃	ЕС-NH ₃ -100	от 0 до 30 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 21,3 включ.	±15	-	20
		св. 30 до 100 млн ⁻¹	св. 21,3 до 71,0	-	±15	
	ЕС-NH ₃ -500	от 0 до 30 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 21,3 включ.	±15	-	
		св. 30 до 500 млн ⁻¹	св. 21,3 до 355	-	±15	
	ЕС-NH ₃ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 71 включ.	±20	-	
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹	св. 71 до 710	-	±20	
Хлор Cl ₂	ЕС-Cl ₂ -5	от 0 до 0,3 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,88 включ.	±20	-	30
		св. 0,3 до 5 млн ⁻¹	св. 0,88 до 14,75	-	±20	
	ЕС-Cl ₂ -10	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,475 включ.	±15	-	
		св. 0,5 до 10 млн ⁻¹	св. 1,475 до 29,5	-	±15	
	ЕС-Cl ₂ -20	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,475 включ.	±15	-	30
		св. 0,5 до 20 млн ⁻¹	св. 1,475 до 59,0	-	±15	
	ЕС-Cl ₂ -50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 14,75 включ.	±20	-	30
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 14,75 до 147,5	-	±20	

1	2	3	4	5	6	7
Водород H ₂	ЕС-H ₂ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹	от 0 до 8,0 включ.	±10	-	20
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹	св. 8,0 до 80,0	-	±10	
	ЕС-H ₂ -10000	от 0 до 1000 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 80,0 включ.	±10	-	
		св. 1000 до 10000 млн ⁻¹	св. 80,0 до 800	-	±10	
Диоксид углерода CO ₂	ЕС-CO ₂ -5	от 0 до 0,5 % включ.	-	±10	-	45
		св. 0,5 до 5 %	-	-	±10	
	ЕС-CO ₂ -2,5	от 0 до 0,5 % включ.	-	±10	-	
		св. 0,5 до 2,5 %	-	-	±10	
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	ЕС-C ₂ H ₄ O-5	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,915 включ.	± 20	-	50
		св. 0,5 до 5 млн ⁻¹	св. 0,915 до 9,15	-	± 20	
	ЕС-C ₂ H ₄ O-10	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 3 включ.	± 20	-	
		св. 1,65 до 10 млн ⁻¹	св. 3 до 18,3	-	± 20	
	ЕС-C ₂ H ₄ O-20	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 9,15 включ.	±20	-	
		св. 5 до 20 млн ⁻¹	св. 9,15 до 36,6	-	±20	
Оксид азота NO	ЕС-NO-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 6,25 включ.	±20	-	20
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 6,25 до 62,5	-	±20	
	ЕС-NO-250	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 62,5 включ.	±10	-	
		св. 50 до 250 млн ⁻¹	св. 62,5 до 312,5	-	±10	
Диоксид азота NO ₂	ЕС-NO ₂ -20	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,91 включ.	±15	-	15
		св. 1 до 20 млн ⁻¹	св. 1,91 до 38,2 включ.	-	±15	
	ЕС-NO ₂ -50	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 5,73 включ.	±15	-	
		св. 3 до 50 млн ⁻¹	св. 5,73 до 95,5 включ.	-	±15	
	ЕС-NO ₂ -100	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 5,73 включ.	±15	-	
		св. 3 до 100 млн ⁻¹	св. 5,73 до 191,0	-	±15	
Озон O ₃	ЕС-NO ₂ -250	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 19 включ.	±15	-	20
		св. 10 до 250 млн ⁻¹	св. 19 до 477	-	±15	
Метанол CH ₃ OH	ЕС-O ₃ -0,25	от 0 до 0,05 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,1 включ.	±20	-	90
		св. 0,05 до 0,25 млн ⁻¹	св. 0,1 до 0,5	-	±20	
	ЕС-CH ₃ OH-22,5	от 0 до 0,75 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1 включ.	±20	-	
		св. 0,75 до 22,5 млн ⁻¹	св. 1 до 30	-	±20	
	ЕС-CH ₃ OH-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 6,65 включ.	±20	-	
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 6,65 до 66,5	-	±20	
	ЕС-CH ₃ OH-200	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 66,5 включ.	±20	-	
		св. 50 до 200 млн ⁻¹	св. 66,5 до 266	-	±20	
	ЕС-CH ₃ OH-1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 133,0 включ.	±20	-	
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹	св. 133,0 до 1330	-	±20	

1	2	3	4	5	6	7
Этилмеркаптан (этантиол) C_2H_5SH	ЕС- C_2H_5SH-4	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1 включ.	±20	-	90
		св. 0,4 до 4 млн ⁻¹	св. 1 до 10	-	±20	
	ЕС- C_2H_5SH-14	от 0 до 0,78 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 2 включ.	±20	-	
		св. 0,78 до 14 млн ⁻¹	св. 2 до 36,12	-	±20	
Метилмеркаптан (метантиол) CH_3SH	ЕС- CH_3SH-4	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,8 включ.	±20	-	90
		св. 0,4 до 4 млн ⁻¹	св. 0,8 до 8	-	±20	
	ЕС- CH_3SH-14	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,96 включ.	±20	-	
		св. 1 до 14 млн ⁻¹	св. 1,96 до 27,4	-	±20	
Формальдегид CH_2O	ЕС- CH_2O-10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,5 включ.	±20	-	30
		св. 0,4 до 10 млн ⁻¹	св. 0,5 до 12,5	-	±20	
Хлористый водород HCl	ЕС- $HCl-20$	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 4,56 включ.	±20	-	70
		св. 3 до 20 млн ⁻¹	св. 4,56 до 30,4	-	±20	
	ЕС- $HCl-30$	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 4,56 включ.	±20	-	
		св. 3 до 30 млн ⁻¹	св. 4,56 до 45,6	-	±20	
Моносилан (силан) SiH_4	ЕС- SiH_4-50	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 13,4 включ.	±20	-	30
		св. 10 до 50 млн ⁻¹	св. 13,4 до 67	-	±20	
Карбонилхлорид (фосген) $COCl_2$	ЕС- $COCl_2-1$	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,41 включ.	±20	-	40
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹	св. 0,41 до 4,11	-	±20	
Фтор F_2	ЕС- F_2-1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,16 включ.	±20	-	30
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹	св. 0,16 до 1,58	-	±20	
Арсин AsH_3	ЕС- AsH_3-1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,32 включ.	±20	-	20
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹	св. 0,32 до 3,24	-	±20	
Уксусная кислота $C_2H_4O_2$	ЕС- $C_2H_4O_2-10$	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 5 включ.	±20	-	30
		св. 2 до 10 млн ⁻¹	св. 5 до 25	-	±20	
	ЕС- $C_2H_4O_2-30$	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 12,5 включ.	±20	-	
		св. 5 до 30 млн ⁻¹	св. 12,5 до 75,0	-	±20	
Гидразин N_2H_4	ЕС- N_2H_4-2	от 0 до 0,2 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,26 включ.	±20	-	30
		св. 0,2 до 2 млн ⁻¹	св. 0,26 до 2,66	-	±20	
Несимметричный диметилгидразин $C_2H_8N_2$	ЕС- $C_2H_8N_2-0,5$	от 0 до 0,12 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,3 включ.	±20	-	30
		св. 0,12 до 0,5 млн ⁻¹	св. 0,3 до 1,24	-	±20	

(1) Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведенными в таблице, но указанными в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов.

(2) Пересчет значений объемной доли X , млн⁻¹, в массовую концентрацию C , мг/м³, проводится по формуле: $C=X \times M/V_m$, где C – массовая концентрация компонента, мг/м³; M – молярная масса компонента, г/моль; V_m – молярный объем газа-разбавителя - воздуха, равный 24,06 дм³/моль при условиях 20 °С и 101,3 кПа по ГОСТ 12.1.005-88.

(3) Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации (периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем).

Таблица 3 – Диапазоны измерений объёмной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с термокаталитическим сенсором (СТ)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ)		Пределы допускаемой основной погрешности		Время установления выходного сигнала Т _{0,9} ⁽⁴⁾
		объёмной доли, % (ДВК, % НКПР) ^{(2) (5)}	массовой концентрации, мг/м ³	приведенной к ДИ, %	абсолютной, % (% НКПР, мг/м ³)	
1	2	3	4	5	6	7
Метан СН ₄	СТ-СН ₄ -7000	-	от 0 до 500 включ.	±15	-	15
		-	св. 500 до 7000	-	±(0,15×С _{вх}) мг/м ³	
	СТ-СН ₄ -50Т	от 0 до 2,2 %	-	-	±0,13 % (±3 % НКПР)	
	СТ-СН ₄ -50	(от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,22 % (±5 % НКПР)	
Этилен С ₂ Н ₄	СТ-С ₂ Н ₄ -50Т	от 0 до 1,15 %	-	-	±0,069 % (±3 % НКПР)	15
	СТ-С ₂ Н ₄ -50	(от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,12 % (±5 % НКПР)	
Пропан С ₃ Н ₈	СТ-С ₃ Н ₈ -7000	-	от 0 до 500 включ.	±15	-	15
		-	св. 500 до 7000	-	±(0,15×С _{вх}) мг/м ³	
	СТ-С ₃ Н ₈ -50Т	от 0 до 0,85 %	-	-	±0,051 % (±3 % НКПР)	
	СТ-С ₃ Н ₈ -50	(от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,085 % (±5 % НКПР)	

1	2	3	4	5	6	7
Сумма угле- водородов (C _x -C _y) ⁽³⁾	СТ-C _x H _y -3000	-	от 0 до 300 включ.	±10	-	15
		-	св. 300 до 3000	-	±(0,155×C _{вх} - 16,5) мг/м ³	
	СТ-C _x H _y -3000	-	от 0 до 500 включ.	±15	-	
		-	св. 500 до 3000	-	±(0,15×C _{вх}) мг/м ³	
	СТ-C _x H _y (C ₃ H ₈)- 50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,051 % (±3 % НКПР)	
	СТ-C _x H _y (C ₃ H ₈) - 50		-	-	±0,085 % (±5 % НКПР)	
Сумма угле- водородов (C _x -C _y) ⁽³⁾	СТ-C _x H _y (CH ₄)- 50T	от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,13 % (±3 % НКПР)	15
	СТ- C _x H _y (CH ₄)- 50		-	-	±0,22 % (±5 % НКПР)	
н-бутан C ₄ H ₁₀	СТ-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,042 % (±3 % НКПР)	15
	СТ-C ₄ H ₁₀ -50		-	-	±0,07 % (±5 % НКПР)	
1-бутен C ₄ H ₈	СТ- C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,048 % (±3 % НКПР)	15
	СТ- C ₄ H ₈ -50		-	-	±0,08 % (±5 % НКПР)	
2-метилпро- пан (изобутан) i-C ₄ H ₁₀	СТ- i-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,039 % (±3 % НКПР)	15
	СТ- i-C ₄ H ₁₀ -50		-	-	±0,065 % (±5 % НКПР)	
н-пентан C ₅ H ₁₂	СТ-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,033 % (±3 % НКПР)	15
	СТ-C ₅ H ₁₂ -50		-	-	±0,055 % (±5 % НКПР)	
Циклопентан C ₅ H ₁₀	СТ-C ₅ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,042 % (±3 % НКПР)	15
	СТ-C ₅ H ₁₀ -50		-	-	±0,07 % (±5 % НКПР)	
н-гексан C ₆ H ₁₄	СТ-C ₆ H ₁₄ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,03 % (±3 % НКПР)	15
	СТ-C ₆ H ₁₄ -50		-	-	±0,05 % (±5 % НКПР)	
Циклогексан C ₆ H ₁₂	СТ-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,03 % (±3 % НКПР)	15
	СТ-C ₆ H ₁₂ -50		-	-	±0,05 % (±5 % НКПР)	

1	2	3	4	5	6	7
1,2-дихлор-этан $C_2H_4Cl_2$	СТ- $C_2H_4Cl_2$ -50T	от 0 до 3,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,19$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- $C_2H_4Cl_2$ -50		-	-	$\pm 0,31$ % (± 5 % НКПР)	
Оксид пропилена C_3H_6O	СТ- C_3H_6O -50T	от 0 до 0,95 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,057$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_3H_6O -50		-	-	$\pm 0,095$ % (± 5 % НКПР)	
Аммиак NH_3	СТ- NH_3 -50T	от 0 до 7,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,45$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- NH_3 -50		-	-	$\pm 0,75$ % (± 5 % НКПР)	
Этан C_2H_6	СТ- C_2H_6 -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,072$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_2H_6 -50		-	-	$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	
Метанол CH_3OH	СТ- CH_3OH -50T	от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,18$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- CH_3OH -50		-	-	$\pm 0,3$ % (± 5 % НКПР)	
Бензол C_6H_6	СТ- C_6H_6 -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,036$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_6H_6 -50		-	-	$\pm 0,06$ % (± 5 % НКПР)	
Пропилен C_3H_6	СТ- C_3H_6 -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,06$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_3H_6 -50		-	-	$\pm 0,1$ % (± 5 % НКПР)	
Этанол C_2H_5OH	СТ- C_2H_5OH -50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,093$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_2H_5OH -50		-	-	$\pm 0,16$ % (± 5 % НКПР)	
н-гептан C_7H_{16}	СТ- C_7H_{16} -50T	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,025$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_7H_{16} -50		-	-	$\pm 0,042$ % (± 5 % НКПР)	
Оксид этилена C_2H_4O	СТ- C_2H_4O -50T	от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,078$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_2H_4O -50		-	-	$\pm 0,13$ % (± 5 % НКПР)	
2-пропанон (ацетон) C_3H_6O	СТ- C_3H_6O -50T	от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,075$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_3H_6O -50		-	-	$\pm 0,13$ % (± 5 % НКПР)	

1	2	3	4	5	6	7
Водород H_2	СТ- H_2 -50T	от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,12$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- H_2 -50		-	-	$\pm 0,2$ % (± 5 % НКПР)	
2-метилпро- пен (изобутилен) $i-C_4H_8$	СТ- $i-C_4H_8$ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,048$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- $i-C_4H_8$ -50		-	-	$\pm 0,08$ % (± 5 % НКПР)	
2-метил- 1,3-бутадиен (изопрен) C_5H_8	СТ- C_5H_8 -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,051$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_5H_8 -50		-	-	$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	
Ацетилен C_2H_2	СТ- C_2H_2 -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,069$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_2H_2 -50		-	-	$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	
Акрилонит- рил C_3H_3N	СТ- C_3H_3N -50T	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,084$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_3H_3N -50		-	-	$\pm 0,14$ % (± 5 % НКПР)	
Метилбензол (толуол) C_7H_8	СТ- C_7H_8 -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,03$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_7H_8 -50		-	-	$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	
Этилбензол C_8H_{10}	СТ- C_8H_{10} -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,024$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_8H_{10} -50		-	-	$\pm 0,04$ % (± 5 % НКПР)	
н-октан C_8H_{18}	СТ- C_8H_{18} -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,024$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_8H_{18} -50		-	-	$\pm 0,04$ % (± 5 % НКПР)	
Этилацетат $C_4H_8O_2$	СТ- $C_4H_8O_2$ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,06$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- $C_4H_8O_2$ -50		-	-	$\pm 0,10$ % (± 5 % НКПР)	
Метилацетат $C_3H_6O_2$	СТ- $C_3H_6O_2$ -50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,093$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- $C_3H_6O_2$ -50		-	-	$\pm 0,16$ % (± 5 % НКПР)	
Бутилацетат $C_6H_{12}O_2$	СТ- $C_6H_{12}O_2$ -50	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,06$ % (± 5 % НКПР)	15

1	2	3	4	5	6	7
1,3-бутадиен (дивинил) C_4H_6	СТ- C_4H_6 -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,042$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_4H_6 -50		-	-	$\pm 0,07$ % (± 5 % НКПР)	
Диметилсульфид CH_3SCH_3	СТ- C_2H_6S -50T	от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,066$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_2H_6S -50		-	-	$\pm 0,11$ % (± 5 % НКПР)	
1-гексен C_6H_{12}	СТ- C_6H_{12} -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,036$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_6H_{12} -50		-	-	$\pm 0,06$ % (± 5 % НКПР)	
1-бутанол C_4H_9OH	СТ- C_4H_9OH -50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,07$ % (± 5 % НКПР)	15
2-бутанол (втор-бута- нол) сес- C_4H_9OH	СТ-sec- C_4H_9OH - 50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	15
Нонан C_9H_{20}	СТ- C_9H_{20} -50	от 0 до 0,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,035$ % (± 5 % НКПР)	15
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C_8H_8	СТ- C_8H_8 -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	15
Винилхлорид C_2H_3Cl	СТ- C_2H_3Cl -50T	от 0 до 1,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,11$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_2H_3Cl -50		-	-	$\pm 0,18$ % (± 5 % НКПР)	
Циклопропан C_3H_6	СТ- C_3H_6 -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,072$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_3H_6 -50		-	-	$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	
Диметиловый эфир C_2H_6O	СТ- C_2H_6O -50T	от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,081$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_2H_6O -50		-	-	$\pm 0,14$ % (± 5 % НКПР)	
Диэтиловый эфир $C_4H_{10}O$	СТ- $C_4H_{10}O$ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,051$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- $C_4H_{10}O$ -50		-	-	$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	
Хлорбензол C_6H_5Cl	СТ- C_6H_5Cl -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,039$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_6H_5Cl -50		-	-	$\pm 0,065$ % (± 5 % НКПР)	

1	2	3	4	5	6	7
2-бутанон (метилэтилкетон) C_4H_8O	СТ- C_4H_8O -50Т	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- C_4H_8O -50		-	-	$\pm 0,075$ % (± 5 % НКПР)	
2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) tert- C_4H_9OH	СТ-tert- C_4H_9OH -50Т	от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,054$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ-tert- C_4H_9OH -50		-	-	$\pm 0,09$ % (± 5 % НКПР)	
1,4-диметилбензол (п-ксилол) p - C_8H_{10}	СТ- p - C_8H_{10} -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045$ % (± 5 % НКПР)	15
2-метокси-2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) tert- $C_5H_{12}O$	СТ-tert- $C_5H_{12}O$ -50Т	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ-tert- $C_5H_{12}O$ -50		-	-	$\pm 0,075$ % (± 5 % НКПР)	
1,2-димтилбензол (о-ксилол) o - C_8H_{10}	СТ- o - C_8H_{10} -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	15
2-пропанол (изопропанол) i - C_3H_7OH	СТ- i - C_3H_7OH -50	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,1$ % (± 5 % НКПР)	
1-октен C_8H_{16}	СТ- C_8H_{16} -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045$ % (± 5 % НКПР)	15
2-метилбутан (изопентан) i - C_5H_{12}	СТ- i - C_5H_{12} -50Т	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,039$ % (± 3 % НКПР)	15
	СТ- i - C_5H_{12} -50		-	-	$\pm 0,065$ % (± 5 % НКПР)	
Метантиол (метилмеркаптан) CH_3SH	СТ- CH_3SH -50	от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,21$ % (± 5 % НКПР)	15
Этантиол (этилмеркаптан) C_2H_5SH	СТ- C_2H_5SH -50	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,14$ % (± 5 % НКПР)	15
Ацетонитрил C_2H_3N	СТ- C_2H_3N -50	от 0 до 1,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,15$ % (± 5 % НКПР)	15

1	2	3	4	5	6	7
2,3-дитиабутан (диметилди- сульфид) $C_2H_6S_2$	СТ- $C_2H_6S_2$ -50	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,055$ % (± 5 % НКПР)	15

(1) Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведенными в таблице, но указанными в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов.

(2) Значения НКПР для горючих газов и паров в соответствии с ГОСТ 31610.20-1-2020.

(3) Сумма углеводородов (C_x-C_y) – суммарное содержание предельных углеводородов: метан (CH_4), этан (C_2H_6), пропан (C_3H_8), бутан (C_4H_{10}), пентан (C_5H_{12}), гексан (C_6H_{14}), гептан (C_7H_{16}), октан (C_8H_{18}), нонан (C_9H_{20}), декан ($C_{10}H_{22}$).

$C_{вх}$ – содержание определяемого компонента на входе газоанализатора, массовая концентрация $мг/м^3$.

(4) Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации (периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем).

(5) Диапазон показаний соответствует диапазону от 0 до 100 % НКПР или диапазону измерений в зависимости от заказа.

Таблица 4 – Диапазоны измерений объемной доли определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с оптическим инфракрасным сенсором IR (или MEMS/TDLAS/IR)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ) объемной доли, % (ДВК, % НКПР, $мг/м^3$) ⁽²⁾	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Время установления выходного сигнала $T_{0,9}$ ⁽⁴⁾ , с
1	2	3	4	5
Метан CH_4	IR- CH_4 -50T	от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,13$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- CH_4 -50		$\pm 0,22$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- CH_4 -100L	от 0 до 4,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,22$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- CH_4 -50M	от 0 до 2,2 % (от 0 до 14638 $мг/м^3$)	$\pm 0,22$ % (± 1463 $мг/м^3$)	
Этилен C_2H_4	IR- C_2H_4 -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,069$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_2H_4 -50		$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	
Пропан C_3H_8	IR- C_3H_8 -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,051$ % (± 3 % НКПР)	10

1	2	3	4	5
Пропан C_3H_8	IR- C_3H_8 -50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	10
	IR- C_3H_8 -100L	от 0 до 1,7 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- C_3H_8 -50M	от 0 до 0,85 % (от 0 до 15550 мг/м ³)	$\pm 0,085$ % (± 1555 мг/м ³)	
н-бутан C_4H_{10}	IR- C_4H_{10} -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,04$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_4H_{10} -50		$\pm 0,07$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- C_4H_{10} -100L	от 0 до 1,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,07$ % (± 5 % НКПР)	
1-бутен C_4H_8	IR- C_4H_8 -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,048$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_4H_8 -50		$\pm 0,08$ % (± 5 % НКПР)	
2-метилпропан (изобутан) $i-C_4H_{10}$	IR- $i-C_4H_{10}$ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,039$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- $i-C_4H_{10}$ -50		$\pm 0,065$ % (± 5 % НКПР)	
н-пентан C_5H_{12}	IR- C_5H_{12} -50T	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,033$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_5H_{12} -50		$\pm 0,055$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- C_5H_{12} -100L	от 0 до 1,1 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,055$ % (± 5 % НКПР)	
Циклопентан C_5H_{10}	IR- C_5H_{10} -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,042$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_5H_{10} -50		$\pm 0,07$ % (± 5 % НКПР)	
н-гексан C_6H_{14}	IR- C_6H_{14} -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,03$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_6H_{14} -50		$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- C_6H_{14} -100L	от 0 до 1,0 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	
Циклогексан C_6H_{12}	IR- C_6H_{12} -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,03$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_6H_{12} -50		$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	
Этан C_2H_6	IR- C_2H_6 -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,072$ % (± 3 % НКПР)	10

1	2	3	4	5
Этан C_2H_6	IR- C_2H_6 -50	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	10
	IR- C_2H_6 -100L	от 0 до 2,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	
Метанол CH_3OH	IR- CH_3OH -50T	от 0 до 3 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,18$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- CH_3OH -50		$\pm 0,3$ % (± 5 % НКПР)	
Бензол C_6H_6	IR- C_6H_6 -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,036$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_6H_6 -50		$\pm 0,06$ % (± 5 % НКПР)	
Пропилен C_3H_6	IR- C_3H_6 -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,06$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_3H_6 -50		$\pm 0,1$ % (± 5 % НКПР)	
Этанол C_2H_5OH	IR- C_2H_5OH -50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,093$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_2H_5OH -50		$\pm 0,16$ % (± 5 % НКПР)	
н-гептан C_7H_{16}	IR- C_7H_{16} -50T	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,025$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_7H_{16} -50		$\pm 0,042$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- C_7H_{16} -100L	от 0 до 0,85 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,042$ % (± 5 % НКПР)	
Оксид этилена C_2H_4O	IR- C_2H_4O -50T	от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,078$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_2H_4O -50		$\pm 0,13$ % (± 5 % НКПР)	
Диоксид углерода CO_2	IR- CO_2 -1,5	от 0 до 1,5 %	$\pm 0,15$ %	10
	IR- CO_2 -2,5	от 0 до 0,5 % включ.	$\pm 0,05$ %	
		св 0,5 до 2,5 %	$\pm (0,1 \times C_{вх})$ %	
Диоксид углерода CO_2	IR- CO_2 -5	от 0 до 2,5% включ.	$\pm 0,25$ %	
		св 2,5 до 5 %	$\pm (0,1 \times C_{вх})$ %	
2-пропанон (ацетон) C_3H_6O	IR- C_3H_6O -50T	от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,075$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_3H_6O -50		$\pm 0,13$ % (± 5 % НКПР)	
2-метилпропен (изобутилен) $i-C_4H_8$	IR- $i-C_4H_8$ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,048$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- $i-C_4H_8$ -50		$\pm 0,08$ % (± 5 % НКПР)	

1	2	3	4	5
2-метил- 1,3-бутадиен (изопрен) C_5H_8	IR- C_5H_8 -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,051$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_5H_8 -50		$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	
Ацетилен C_2H_2	IR- C_2H_2 -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,069$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_2H_2 -50		$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	
Акрилонитрил C_3H_3N	IR- C_3H_3N -50T	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,084$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_3H_3N -50		$\pm 0,14$ % (± 5 % НКПР)	
Метилбензол (толуол) C_7H_8	IR- C_7H_8 -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,03$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_7H_8 -50		$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	
Этилбензол C_8H_{10}	IR- C_8H_{10} -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,024$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_8H_{10} -50		$\pm 0,04$ % (± 5 % НКПР)	
н-октан C_8H_{18}	IR- C_8H_{18} -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,024$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_8H_{18} -50		$\pm 0,04$ % (± 5 % НКПР)	
	IR- C_8H_{18} -100L	от 0 до 0,8 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,04$ % (± 5 % НКПР)	
Этилацетат $C_4H_8O_2$	IR- $C_4H_8O_2$ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,06$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- $C_4H_8O_2$ -50		$\pm 0,1$ % (± 5 % НКПР)	
Бутилацетат $C_6H_{12}O_2$	IR- $C_6H_{12}O_2$ -50	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,06$ % (± 5 % НКПР)	10
1,3-бутадиен (дивинил) C_4H_6	IR- C_4H_6 -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,042$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_4H_6 -50		$\pm 0,07$ % (± 5 % НКПР)	
1,2-дихлорэтан $C_2H_4Cl_2$	IR- $C_2H_4Cl_2$ - 50T	от 0 до 3,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,19$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- $C_2H_4Cl_2$ -50		$\pm 0,31$ % (± 5 % НКПР)	
Диметилсульфид C_2H_6S	IR- C_2H_6S -50T	от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,066$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_2H_6S -50		$\pm 0,11$ % (± 5 % НКПР)	

1	2	3	4	5
1-гексен C_6H_{12}	IR- C_6H_{12} -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,036$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_6H_{12} -50		$\pm 0,06$ % (± 5 % НКПР)	
1-бутанол C_4H_9OH	IR- C_4H_9OH -50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,07$ % (± 5 % НКПР)	10
2-бутанол (втор-бутанол) $sec-C_4H_9OH$	IR- $sec-C_4H_9OH$ -50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	10
Нонан C_9H_{20}	IR- C_9H_{20} -50	от 0 до 0,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,035$ % (± 5 % НКПР)	10
	IR- C_9H_{20} -100L	от 0 до 0,7 % (от 0 до 100 % НКПР)	$\pm 0,035$ % (± 5 % НКПР)	
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C_8H_8	IR- C_8H_8 -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,05$ % (± 5 % НКПР)	10
Винилхлорид C_2H_3Cl	IR- C_2H_3Cl -50T	от 0 до 1,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,11$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_2H_3Cl -50		$\pm 0,18$ % (± 5 % НКПР)	
Циклопропан C_3H_6	IR- C_3H_6 -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,072$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_3H_6 -50		$\pm 0,12$ % (± 5 % НКПР)	
Диметиловый эфир C_2H_6O	IR- C_2H_6O -50T	от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,081$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_2H_6O -50		$\pm 0,14$ % (± 5 % НКПР)	
Диэтиловый эфир $C_4H_{10}O$	IR- $C_4H_{10}O$ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,051$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- $C_4H_{10}O$ -50		$\pm 0,085$ % (± 5 % НКПР)	
Оксид пропилена C_3H_6O	IR- C_3H_6O -50T	от 0 до 0,95 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,057$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_3H_6O -50		$\pm 0,095$ % (± 5 % НКПР)	
Хлорбензол C_6H_5Cl	IR- C_6H_5Cl -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,039$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_6H_5Cl -50		$\pm 0,065$ % (± 5 % НКПР)	
2-бутанон (метилэтилкетон) C_4H_8O	IR- C_4H_8O -50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,045$ % (± 3 % НКПР)	10
	IR- C_4H_8O -50		$\pm 0,075$ % (± 5 % НКПР)	

1	2	3	4	5
2-метил- 2-пропанол (трет-бутанол) tert-C ₄ H ₉ OH	IR-tert- C ₄ H ₉ OH-50T	от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,054 % (±3 % НКПР)	10
	IR-tert- C ₄ H ₉ OH-50		±0,09 % (±5 % НКПР)	
2-метокси- 2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) tert-C ₅ H ₁₂ O	IR-tert-C ₅ H ₁₂ O- 50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,045 % (±3 % НКПР)	10
	IR-tert-C ₅ H ₁₂ O- 50		±0,075 % (±5 % НКПР)	
1,4-диметилбензол (п-ксилол) p-C ₈ H ₁₀	IR-p-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,045 % (±5 % НКПР)	10
1,2-диметилбензол (о-ксилол) o-C ₈ H ₁₀	IR-o-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,05 % (±5 % НКПР)	10
2-пропанол (изопропанол) i-C ₃ H ₇ OH	IR-i-C ₃ H ₇ OH- 50	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,10 % (±5 % НКПР)	10
1-октен C ₈ H ₁₆	IR-C ₈ H ₁₆ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,045 % (±5 % НКПР)	10
2-метилбутан (изопентан) i-C ₅ H ₁₂	IR-i-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,039 % (±3 % НКПР)	10
	IR-i-C ₅ H ₁₂ -50		±0,065 % (±5 % НКПР)	
Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	IR-CH ₃ SH-50	от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,21 % (±5 % НКПР)	10
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	IR-C ₂ H ₅ SH-50	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,14 % (±5 % НКПР)	10
Ацетонитрил C ₂ H ₃ N	IR-C ₂ H ₃ N-50	от 0 до 1,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,15 % (±5 % НКПР)	10
2,3-дитиабутан (диметилдисульфид) C ₂ H ₆ S ₂	IR-C ₂ H ₆ S ₂ -50	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,055 % (±5 % НКПР)	10
Пары нефти ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	
Пары бензина ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	

1	2	3	4	5
Пары авиационного топлива ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	$\pm(0,1 \times C_{\text{вх}} - 15)$ мг/м ³	
Пары топлива для реактивных двигателей ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	$\pm(0,1 \times C_{\text{вх}} - 15)$ мг/м ³	
Пары керосина ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	$\pm(0,1 \times C_{\text{вх}} - 15)$ мг/м ³	
Пары дизельного топлива ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	$\pm(0,1 \times C_{\text{вх}} - 15)$ мг/м ³	
Пары уайт-спирита ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10

(1) Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведёнными в таблице, но указанными в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов.

(2) Значения НКПР для горючих газов и паров в соответствии с ГОСТ 31610.20-1-2020.

(3) Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, нефть по ГОСТ Р 51858-2002, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013, топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, топливо авиационное по ГОСТ Р 52050-2006, топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей по ГОСТ 12308-2013, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, топлива для двигателей внутреннего сгорания, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51105-2020, керосин по ТУ 38.71-58-10-01, керосин по ТУ 38.401-58-8-90, керосин по ОСТ 38.01407-86, керосин осветительный ТУ 38.401-58-10-01.

$C_{\text{вх}}$ — содержание определяемого компонента на входе газоанализатора, массовая концентрация, мг/м³.

(4) Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации
(периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем).

Таблица 5 – Диапазоны измерений объёмной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с фотоионизационным сенсором (PID)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ) определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности, %		Время установления сигнала в Т _{0,9} ⁽⁵⁾
		объёмной доли, (млн ⁻¹)	массовой концентрации ⁽²⁾ , мг/м ³	приведенной к ДИ	относительной	
1	2	3	4	5	6	7
Винилхлорид C ₂ H ₃ Cl	PID-C ₂ H ₃ Cl-10	от 0 до 1,9 включ.	от 0 до 5 включ.	± 20	-	15
		св. 1,9 до 10	св. 5 до 26	-	± 20	
	PID-C ₂ H ₃ Cl-100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 26 включ.	± 20	-	
		св. 10 до 100	св. 26 до 260	-	± 20	
	PID-C ₂ H ₃ Cl-500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 260 включ.	± 20	-	
		св. 100 до 500	св. 260 до 1300	-	± 20	
Бензол C ₆ H ₆	PID-C ₆ H ₆ -10	от 0 до 4,6 включ.	от 0 до 15 включ.	± 15	-	15
		св. 4,6 до 10	св. 15 до 32,5	-	± 15	
	PID-C ₆ H ₆ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 32,5 включ.	± 15	-	
		св. 10 до 100	св. 32,5 до 325	-	± 15	
	PID-C ₆ H ₆ -500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 325 включ.	± 15	-	
		св. 100 до 500	св. 325 до 1625	-	± 15	
Этилбензол C ₈ H ₁₀	PID-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,1 включ.	± 15	-	15
		св. 10 до 100	св. 44,1 до 441	-	± 15	
	PID-C ₈ H ₁₀ -500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 441 включ.	± 15	-	
		св. 100 до 500	св. 441 до 2205	-	± 15	
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C ₈ H ₈	PID-C ₈ H ₈ -40	от 0 до 6,9 включ.	от 0 до 29,9 включ.	± 20	-	15
		св. 6,9 до 40	св. 29,9 до 173,2	-	± 20	
	PID-C ₈ H ₈ -500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 433 включ.	± 20	-	
		св. 100 до 500	св. 433 до 2165	-	± 20	
н-пропилацетат C ₅ H ₁₀ O ₂	PID-C ₅ H ₁₀ O ₂ -100	от 0 до 30 включ.	от 0 до 127,5 включ.	± 20	-	15
		св. 30 до 100	св. 127,5 до 425	-	± 20	
Эпихлоргидрин C ₃ H ₅ ClO	PID-C ₃ H ₅ ClO-3	от 0 до 0,5 включ.	от 0 до 1,93 включ.	± 20	-	15
		св. 0,5 до 3	св. 1,93 до 11,55	-	± 20	
N,N-димети- лацетамид C ₄ H ₉ NO	PID-C ₄ H ₉ NO-10	от 0 до 0,8 включ.	от 0 до 2,9 включ.	± 20	-	15
		св. 0,8 до 10	св. 2,9 до 36,2	-	± 20	
Хлористый Бензил C ₇ H ₇ Cl	PID-C ₇ H ₇ Cl-3	от 0 до 0,1 включ.	от 0 до 0,52 включ.	± 20	-	15
		св. 0,1 до 3	св. 0,52 до 15,8	-	± 20	
Фурфуриловый Спирт C ₅ H ₆ O ₂	PID-C ₅ H ₆ O ₂ -3	от 0 до 0,12 включ.	от 0 до 0,49 включ.	± 20	-	15
		св. 0,12 до 3	св. 0,49 до 12,24	-	± 20	
Этанол C ₂ H ₅ OH	PID-C ₂ H ₅ OH-2000	от 0 до 500 включ.	от 0 до 960 включ.	± 15	-	15
		св. 500 до 2000	св. 960 до 3840	-	± 15	

1	2	3	4	5	6	7
Моноэтанола-мин (2-аминоэтанол) C_2H_7NO	PID- C_2H_7NO -3	от 0 до 0,2 включ.	от 0 до 0,5 включ.	± 20	-	15
		св. 0,2 до 3	св. 0,5 до 7,6	-	± 20	
	PID- C_2H_7NO -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 5,1 включ.	± 20	-	
		св. 2 до 10	св. 5,1 до 25,4	-	± 20	
Формальдегид CH_2O	PID- CH_2O -10	от 0 до 0,4 включ.	от 0 до 0,5 включ.	± 20	-	15
		св. 0,4 до 10	св. 0,5 до 12,5	-	± 20	
2-пропанол (изопропанол) $i-C_3H_7OH$	PID- $i-C_3H_7OH$ -10	от 0 до 4 включ.	от 0 до 10 включ.	± 20	-	15
		св. 4 до 10	св. 10 до 25	-	± 20	
	PID- $i-C_3H_7OH$ -100	от 0 до 20 включ.	от 0 до 50 включ.	± 20	-	
		св. 20 до 100	св. 50 до 250	-	± 20	
Уксусная кислота $C_2H_4O_2$	PID- $C_2H_4O_2$ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 5 включ.	± 20	-	15
		св. 2 до 10	св. 5 до 25	-	± 20	
	PID- $C_2H_4O_2$ -100	от 0 до 100	от 0 до 250	± 20	-	15
2-метилпропен (изобутилен) (ЛОС по изобутилену) $i-C_4H_8$	PID- $i-C_4H_8$ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 4,6 включ.	± 15	-	15
		св. 2 до 10	св. 4,6 до 23,3	-	± 15	
	PID- $i-C_4H_8$ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 23,3 включ.	± 15	-	15
		св. 10 до 100	св. 23,3 до 233	-	± 15	
	PID- $i-C_4H_8$ -1000	от 0 до 100 включ.	от 0 до 233 включ.	± 15	-	
		св. 100 до 1000	св. 233 до 2330	-	± 15	
1-бутанол C_4H_9OH	PID- C_4H_9OH -10	от 0 до 3,2 включ.	от 0 до 9,9 включ.	± 20	-	15
		св. 3,2 до 10	св. 9,9 до 30,8	-	± 20	
	PID- C_4H_9OH -40	от 0 до 9,7 включ.	от 0 до 29,9 включ.	± 20	-	15
		св. 9,7 до 40	св. 29,9 до 123,3	-	± 20	
	PID- $i-C_4H_8$ -6000	от 0 до 500 включ.	от 0 до 1165 включ.	± 15	-	
		св. 500 до 6000	св. 1165 до 13980	-	± 15	
Диэтиламин $C_4H_{11}N$	PID- $C_4H_{11}N$ -10	от 0 до 3 включ.	от 0 до 9,1 включ.	± 20	-	15
		св. 3 до 10	св. 9,1 до 30,4	-	± 20	
	PID- $C_4H_{11}N$ -40	от 0 до 9,8 включ.	от 0 до 29,8 включ.	± 20	-	
		св. 9,8 до 40	св. 29,8 до 121,6	-	± 20	
Метанол CH_3OH	PID- CH_3OH -10	от 0 до 3,75 включ.	от 0 до 4,98 включ.	± 15	-	15
		св. 3,75 до 10	св. 4,98 до 13,3	-	± 15	
	PID- CH_3OH -40	от 0 до 11,2 включ.	от 0 до 14,9 включ.	± 15	-	
		св. 11,2 до 40	св. 14,9 до 53,2	-	± 15	
Метилбензол (толуол) C_7H_8	PID- C_7H_8 -40	от 0 до 13 включ.	от 0 до 49,8 включ.	± 15	-	15
		св. 13 до 40	св. 49,8 до 153,3	-	± 15	
	PID- C_7H_8 -100	от 0 до 13 включ.	от 0 до 49,8 включ.	± 15	-	
		св. 13 до 100	св. 49,8 до 383	-	± 15	
Фенол C_6H_5OH	PID- C_6H_5OH -3	от 0 до 0,25 включ.	от 0 до 0,98 включ.	± 20	-	15
		св. 0,25 до 3	св. 0,98 до 11,74	-	± 20	
	PID- C_6H_5OH -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7,8 включ.	± 20	-	
		св. 2 до 10	св. 7,8 до 39,1	-	± 20	
1,3-диметилбен- зол (м-ксилол) $m-C_8H_{10}$	PID- $m-C_8H_{10}$ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,2 включ.	± 15	-	15
		св. 10 до 100	св. 44,2 до 442	-	± 15	

1	2	3	4	5	6	7
1,2-диметилбен- зол (о-ксилол) $\text{o-C}_8\text{H}_{10}$	PID-o- C_8H_{10} -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,2 включ.	± 15	-	15
		св. 10 до 100	св. 44,2 до 442	-	± 15	
1,4-диметилбен- зол (п-ксилол) $\text{p-C}_8\text{H}_{10}$	PID-p- C_8H_{10} -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,2 включ.	± 15	-	15
		св. 10 до 100	св. 44,2 до 442	-	± 15	
Оксид этилена $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$	PID- $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ -10	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 3 включ.	± 20	-	15
		св. 1,65 до 10	св. 3 до 18,3	-	± 20	
Фосфин PH_3	PID- PH_3 -10	от 0 до 1 включ.	от 0 до 1,4 включ.	± 20	-	15
		св. 1 до 10	св. 1,4 до 14,1	-	± 20	
Нафталин C_{10}H_8	PID- C_{10}H_8 -10	от 0 до 3,7 включ.	от 0 до 19,7 включ.	± 20	-	15
		св. 3,7 до 10	св. 19,7 до 53,3	-	± 20	
Бром Br_2	PID- Br_2 -2	от 0 до 0,2 включ.	от 0 до 1,33 включ.	± 20	-	15
		св. 0,2 до 2	св. 1,33 до 13,3	-	± 20	
Аммиак NH_3	PID- NH_3 -100	от 0 до 20 включ.	от 0 до 14,2 включ.	± 15	-	15
		св. 20 до 100	св. 14,2 до 71	-	± 15	
	PID- NH_3 -1000	от 0 до 100 включ.	от 0 до 71 включ.	± 15	-	
		св. 100 до 1000	св. 71 до 710	-	± 15	
Этантиол (этилмеркаптан) $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$	PID- $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$ -10	от 0 до 0,4 включ.	от 0 до 1 включ.	± 20	-	15
		св. 0,4 до 10	св. 1 до 25,8	-	± 20	
Метантиол (метилмеркаптан) CH_3SH	PID- CH_3SH -10	от 0 до 0,4 включ.	от 0 до 0,8 включ.	± 20	-	15
		св. 0,4 до 10	св. 0,8 до 20	-	± 20	
	PID- CH_3SH -20	от 0 до 2 включ.	от 0 до 4 включ.	± 20	-	
		св. 2 до 20	св. 4 до 40	-	± 20	
Акриловая кис- лота $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$	PID- $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$ -3,3	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 4,95 включ.	± 20	-	15
		св. 1,65 до 3,3	св. 4,95 до 9,9	-	± 20	
	PID- $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$ -10	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 4,95 включ.	± 20	-	
		св. 1,65 до 10	св. 4,95 до 30	-	± 20	
Этилацетат $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	PID- $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ -100	от 0 до 13 включ.	от 0 до 47,6 включ.	± 20	-	15
		св. 13 до 100	св. 47,6 до 366	-	± 20	
Бутилацетат $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$	PID- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 48,3 включ.	± 20	-	15
		св. 10 до 100	св. 48,3 до 483	-	± 20	
Пропилен (пропен) C_3H_6	PID- C_3H_6 -285	от 0 до 57 включ.	от 0 до 99,8 включ.	± 15	-	15
		св. 57 до 285	св. 99,8 до 499	-	± 15	
2,3-дитиабутан (диметилдисуль- фид) $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}_2$	PID- $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}_2$ -2	от 0 до 0,35 включ.	от 0 до 1,37 включ.	± 20	-	15
		св. 0,35 до 2	св. 1,37 до 7,8	-	± 20	
	PID- $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}_2$ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7,8 включ.	± 20	-	
		св. 2 до 10	св. 7,8 до 39,2	-	± 20	
2,5-фурандион (малеиновый ангидрид) $\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3$	PID- $\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3$ -3	от 0 до 0,25 включ.	от 0 до 1,02 включ.	± 20	-	15
		св. 0,25 до 3	св. 1,02 до 12,2	-	± 20	
	PID- $\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3$ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 8,16 включ.	± 20	-	15
		св. 2 до 10	св. 8,16 до 40,8	-	± 20	

1	2	3	4	5	6	7
Дисульфид углерода (сероуглерод) CS_2	PID- CS_2 -10	от 0 до 1 включ.	от 0 до 3,17 включ.	± 20	-	15
		св. 1 до 10	св. 3,17 до 31,7	-	± 20	
Ацетонитрил $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$	PID- $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$ -10	от 0 до 6 включ.	от 0 до 10,2 включ.	± 15	-	15
		св. 6 до 10	св. 10,2 до 17,1	-	± 15	
Циклогексан C_6H_{12}	PID- C_6H_{12} -100	от 0 до 20 включ.	от 0 до 70 включ.	± 20	-	15
		св. 20 до 100	св. 70 до 350	-	± 20	
1,3-бутадиен (дивинил) C_4H_6	PID- C_4H_6 -500	от 0 до 50 включ.	от 0 до 112 включ.	± 20	-	15
		св. 50 до 500	св. 112 до 1125	-	± 20	
н-гексан C_6H_{14}	PID- C_6H_{14} -1000	от 0 до 84 включ.	от 0 до 301 включ.	± 20	-	15
		св. 84 до 1000	св. 301 до 3584	-	± 20	
Акрилонитрил $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$	PID- $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$ -10	от 0 до 0,7 включ.	от 0 до 1,45 включ.	± 20	-	15
		св. 0,7 до 10	св. 1,45 до 22,1	-	± 20	
Муравьиная кислота CH_2O_2	PID- CH_2O_2 -10	от 0 до 0,5 включ.	от 0 до 0,96 включ.	± 20	-	15
		св. 0,5 до 10	св. 0,96 до 19,1	-	± 20	
н-гептан C_7H_{16}	PID- C_7H_{16} -500	от 0 до 50 включ.	от 0 до 208 включ.	± 15	-	15
		св. 50 до 500	св. 208 до 2084	-	± 15	
	PID- C_7H_{16} -2000	от 0 до 100 включ.	от 0 до 416 включ.	± 15	-	15
		св. 100 до 2000	св. 416 до 8334	-	± 15	
2-пропанон (ацетон) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	PID- $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ -1000	от 0 до 80 включ.	от 0 до 193 включ.	± 15	-	15
		св. 80 до 1000	св. 193 до 2415	-	± 15	
1,2-дихлорэтан $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$	PID- $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ -20	от 0 до 2 включ.	от 0 до 8,23 включ.	± 20	-	15
		св. 2 до 20	св. 8,23 до 82,3	-	± 20	
Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$	PID- $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$ -20	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7,5 включ.	± 20	-	15
		св. 2 до 20	св. 7,5 до 75	-	± 20	
Диметиловый Эфир $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	PID- $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ -500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 192 включ.	± 15	-	15
		св. 100 до 500	св. 192 до 958	-	± 15	
2-метилпропан (изобутан) i- C_4H_{10}	PID-i- C_4H_{10} -1000	от 0 до 100 включ.	от 0 до 241 включ.	± 15	-	15
		св. 100 до 1000	св. 241 до 2417	-	± 15	
2-метил-1-пропанол (изобутанол) i- $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	PID-i- $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ -20	от 0 до 3 включ.	от 0 до 9,2 включ.	± 20	-	15
		св. 3 до 20	св. 9,2 до 61,6	-	± 20	
Циклогексанон $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$	PID- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$ -20	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7 включ.	± 20	-	15
		св. 2 до 20	св. 7 до 70	-	± 20	

1	2	3	4	5	6	7
2-бутанон (метилэтилкетон) C_4H_8O	PID- C_4H_8O -500	от 0 до 60 включ.	от 0 до 180 включ.	± 15	-	15
		св. 60 до 500	св. 180 до 1500	-	± 15	
Тетраэтилортосиликат (TEOS) $C_8H_{20}O_4Si$	PID- $C_8H_{20}O_4Si$ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 17,3 включ.	± 20	-	15
		св. 2 до 10	св. 17,3 до 86,6	-	± 20	
Арсин AsH_3	PID- AsH_3 -3	от 0 до 0,1 включ.	от 0 до 0,3 включ.	± 20	-	15
		св. 0,1 до 3	св. 0,3 до 9,7	-	± 20	
Этилен C_2H_4	PID- C_2H_4 -300	от 0 до 20 включ.	от 0 до 23,4 включ.	± 15	-	15
		св. 20 до 300	св. 23,4 до 351	-	± 15	
	PID- C_2H_4 -1800	от 0 до 100 включ.	от 0 до 117 включ.	± 10	-	15
		св. 100 до 1800	св. 117 до 2106	-	± 10	
Пары нефти ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-	15
		-	св. 300 до 3500	-	± 15	
Пары бензина ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 100 включ.	± 15	-	15
		-	св. 100 до 3500	-	± 15	
Пары авиационного топлива ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-	15
		-	св. 300 до 3500	-	± 15	
Пары топлива для реактивных двигателей ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-	15
		-	св. 300 до 3500	-	± 15	
Пары керосина ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-	15
		-	св. 300 до 3500	-	± 15	
Пары дизельного топлива ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-	15
		-	св. 300 до 3500	-	± 15	
Пары уайт-спирита ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-	15
		-	св. 300 до 3500	-	± 15	
Сумма углеводородов C_2-C_{10} ⁽⁴⁾	PID- C_2C_{10} -3500	-	от 0 до 300 включ.	± 25	-	15
		-	св. 300 до 3500	-	± 25	

1	2	3	4	5	6	7
(1) Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведёнными в таблице по указанным в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов. (2) Пересчёт значений объёмной доли X, млн^{-1}, в массовую концентрацию C, мг/м^3, проводится по формуле: $C = X \times M / V_m$, где C – массовая концентрация компонента, мг/м^3; M – молярная масса компонента, г/моль; V_m – молярный объём газа-разбавителя – воздуха, равный $24,06 \text{ дм}^3/\text{моль}$ при условиях 20°C и $101,3 \text{ кПа}$ по ГОСТ 12.1.005-88. (3) Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, нефть по ГОСТ Р 51858-2002, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013, топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, топливо авиационное по ГОСТ Р 52050-2006, топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей по ГОСТ 12308-2013, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, топлива для двигателей внутреннего сгорания, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51105-2020, керосин по ТУ 38.71-58-10-01, керосин по ТУ 38.401-58-8-90, керосин по ОСТ 38.01407-86, керосин осветительный ТУ 38.401-58-10-01. (4) Сумма углеводородов ($\text{C}_2\text{--C}_{10}$) – суммарное содержание предельных углеводородов: этан (C_2H_6), пропан (C_3H_8), бутан (C_4H_{10}), пентан (C_5H_{12}), гексан (C_6H_{14}), гептан (C_7H_{16}), октан (C_8H_{18}), нонан (C_9H_{20}), декан ($\text{C}_{10}\text{H}_{22}$). (5) Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации (периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем)						

Таблица 6 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих условий эксплуатации на каждые 10°C относительно нормальных условий измерений, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	$\pm 0,25$
Предел допускаемой вариации выходного сигнала, в долях от предела допускаемой основной погрешности	0,5
Время установления выходного сигнала $T_{0,9}$, с, не более	приведено в таблицах 2-5
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$ - относительная влажность окружающей среды, % - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106

Таблица 7 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Вместимость архива, записей, шт.	70000
Габаритные размеры ⁽¹⁾ (высота×ширина×толщина), мм, не более: - для исполнения ПГ ЭРИС-411-1 - для исполнения ПГ ЭРИС-411-2 - для исполнения ПГ ЭРИС-414-1 (без насоса) - для исполнения ПГ ЭРИС-414-1 (с насосом) - для исполнения ПГ ЭРИС-414-2	110×36×61 113×51×44 209×42×81 209×63×81 120×63,5×31,5
Масса ⁽²⁾ , г, не более: - для исполнения ПГ ЭРИС-411-1 - для исполнения ПГ ЭРИС-411-2 - для исполнения ПГ ЭРИС-414-1 - для исполнения ПГ ЭРИС-414-2	200 110 500 180
Напряжение автономного питания от аккумуляторных батарей, В: - для исполнений ПГ ЭРИС-414-1, ПГ ЭРИС-414-2 - для исполнений ПГ ЭРИС-411-1, ПГ ЭРИС-411-2	от 3,6 до 4,2 3,6
Интервал времени непрерывной работы ПГ ЭРИС-414-1, ПГ ЭРИС-414-2 без подзарядки аккумулятора при нормальных условиях ⁽³⁾ , ч, не менее	20
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - атмосферное давление, кПа - относительная влажность воздуха (без конденсации влаги), %, не более	от -45 до +50 от 84 до 106,7 95
Степень защиты оболочки от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-2015	IP66/IP67 IP66/IP68
Маркировка взрывозащиты: - для исполнения ПГ ЭРИС-411-2 - для исполнений ПГ ЭРИС-414-1, ПГ ЭРИС-414-2	PO Ex ia I Ma X/ 0Ex ia IIC T4 Ga X PO Ex ia I Ma X/ 0Ex ia IIC T5 Ga X 0Ex ia IIC T4 Ga X PO Ex ia I Ma X/ 0Ex ia IIC T4 Ga X / Ex ia IIC T135°C Da X PO Ex da ia I Ma X/ 0Ex da ia IIC T4 Ga X
(1) Без учета размеров системы крепления на одежду; (2) Без учета массы сенсоров; (3) Максимальное время работы газоанализатора зависит от количества и моделей сенсоров и условий эксплуатации прибора.	

Таблица 8 – Показатели надёжности

Наименование характеристики	Значение
Средняя наработка на отказ, ч, не менее:	
- для газоанализаторов с термokatалитическим СТ, электрохимическим ЕС и фотоионизационным PID сенсором	35000
- для газоанализаторов с оптическим инфракрасным IR (или MEMS/TDLAS/IR) сенсором	40000
Средний срок службы ^{(1) (2)} , лет	20
⁽¹⁾ Исчисление срока службы газоанализатора начинается с даты ввода в эксплуатацию; ⁽²⁾ Без учета срока службы чувствительного элемента (сенсора).	

Знак утверждения типа

наносится типографским способом или методом лазерной гравировки на маркировочную табличку, закрепленную на заднюю часть корпуса газоанализатора способом наклейки, и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 9 – Комплектность газоанализаторов

Наименование	Обозначение	Количество
Газоанализатор портативный	ПГ ЭРИС-4XX	1 шт.
Паспорт	АПНС.421510.4XX-01 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	АПНС.421510.4XX-00 РЭ	1 экз.
Калибровочная насадка	-	1 шт.
Зарядное устройство	-	1 шт.
Кейс для переноски	-	1*шт.
Модуль передачи данных по радио	-	1*шт.
Ручной насос	-	1*шт.
Моторизированный насос	-	1*шт.
* Определяется заказом.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 15 «Использование по назначению» документов АПНС.421510.411 РЭ «Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-411. Руководство по эксплуатации», АПНС.421510.414 РЭ «Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (п. 4.43);

Приказ Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»;

ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия;

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия ;

ГОСТ Р 52350.29.1-2010 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов;

ГОСТ ИЕС 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов;

ГОСТ 24032-80 Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования. Методы испытаний;

Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. №506 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт»;

ТУ 4215-410-56795556-2015 Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС» (ООО «ЭРИС»)

ИНН 5920017357

Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 8/25

Испытательный центр

Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311373.