

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 19159 от 11 сентября 2025 г.

Срок действия до 19 августа 2030 г.

Наименование типа средств измерений:

Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЩМ

Производитель:

ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары, Российская Федерация

Выдан:

ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары, Российская Федерация

Документ на поверку:

ОПЧ.140.333 МП «Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЩМ. Методика поверки» (с изменением № 2)

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 11.09.2025 № 114

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 11 сентября 2025 г. № 19159

Наименование типа средств измерений и их обозначение: приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЦМ

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицами 3, 4, 5, 8 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: в соответствии с таблицами 1, 6, 7, 9, 9а Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 10 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по ОПЧ.140.333 МП «Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЦМ. Методика поверки» (с изменением № 2).

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: отсутствует.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Производитель средств измерений: Открытое акционерное общество «Электроприбор» (ОАО «Электроприбор»)

Адрес: 428020, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, д. 3

Тел.: (8352) 39-99-18

E-mail: marketing@elpribor.ru.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия, Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2018 г. № 1053 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $2 \cdot 10^9$ Гц», Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2015 г. № 575 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы переменного электрического тока от $1 \cdot 10^{-8}$ до 100 А в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $1 \cdot 10^6$ Гц», Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. № 1621 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа: не предусмотрена.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 63217-16, на 10 листах.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

КОПИЯ ВЕРНА



2021 г. № 1451

Регистрационный № 63217-16

Лист № 1
Всего листов 10

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЦМ

Назначение средства измерений

Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЦМ предназначены для измерений электрических параметров в однофазных электрических сетях переменного тока, трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока с отображением результата измерений в цифровой форме, передачи результатов измерений по цифровым интерфейсам, аналогового преобразования параметров электрической сети в унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения, выполнения функций телесигнализации и телеуправления в составе систем сбора и передачи информации систем телемеханики.

Описание средства измерений

Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЦМ (далее по тексту - приборы) относятся к классу цифровых измерительных преобразователей, реализующих принцип аналого-цифрового преобразования входных величин и последующего расчета параметров электрической сети.

Приборы обеспечивают:

- измерение параметров режима электрической сети: среднеквадратические значения переменного тока и напряжения, активной, реактивной и полной мощностей;
- измерение параметров активной и реактивной энергии (технический учет);
- измерение полного и фазных $\cos \varphi$;
- выполнения функций телесигнализации и телеуправления;
- индикацию параметров качества электроэнергии: положительное/отрицательное отклонение напряжения, длительность провала напряжения, длительность временного перенапряжения, отклонение частоты, кратковременная доза фликера;
- передачу значений параметров по гальванически развязанным цифровым интерфейсам RS485 и Ethernet в автоматизированные системы диспетчерского управления и учета.

Приборы обеспечивают отображение измеренных параметров на светодиодных семисегментных индикаторах в различных комбинациях, в зависимости от заказа.

Приборы со светодиодными индикаторами могут иметь одностороннее исполнение (1, 2 или 3 измеряемых параметра) или многостороннее исполнение.

Приборы имеют единичные светодиодные индикаторы для указания дополнительной информации о текущих отображаемых параметрах и режимах работы прибора.

Приборы имеют возможность выбора вида отображаемых на индикаторах текущих параметров от кнопок управления на передней панели. Приборы дополнительно имеют возможность программирования диапазона выходных аналоговых сигналов.

Приборы имеют возможность оперативного изменения яркости свечения через цифровые интерфейсы RS485, Ethernet с помощью программы конфигурирования, а также с помощью кнопок управления на передней панели.



Лист № 2
Всего листов 10

Приборы имеют возможность настройки диапазона показаний с учетом коэффициентов трансформации по напряжению (для внешних трансформаторов напряжения с номинальным напряжением вторичной обмотки 100 В) и по току (для внешних трансформаторов тока с номинальным током вторичной обмотки 1 А и 5 А) через цифровые интерфейсы RS485, Ethernet, а также с помощью кнопок управления на передней панели.

Приборы обеспечивают передачу измеренных и вычисляемых параметров по цифровым интерфейсам RS485, Ethernet.

Результаты измерений отображаются на цифровых индикаторах.

Варианты поддерживаемых протоколов обмена: ModBus RTU, ModBus TCP, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, IEC 61850-8.1.

Поддерживаемые интерфейсы обеспечивают возможность подключения к приборам дополнительных модулей, расширяющих функциональные возможности приборов (например: модули индикации и табло информационные производства ОАО «Электроприбор»).

Приборы могут применяться для работы в составе технических средств атомных станций (ТС АС) в соответствии с классом безопасности 4 по НП-001-15.

Приборы являются многопредельными и имеют различные исполнения в зависимости от диапазона измерений входного сигнала, напряжения питания, количества и типа интерфейсов, наличия дискретных входов, схемы измерения, цвета и вида индикаторов, наличия дискретных/аналоговых выходов, набора дополнительных опций. По заказу приборы могут иметь ограниченные функциональные возможности и применяться только для измерений параметров активной (P), реактивной (Q) или активной и реактивной (PQ) мощностей. Дополнительно трехфазные четырехпроводные приборы могут подключаться к однофазной сети по фазе А.

Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЩМ выпускаются в виде двух модификаций: ЩМ96 и ЩМ120, отличающихся габаритными размерами.

Информация об исполнении прибора содержится в коде полного условного обозначения: ЩМа-b-c-d-e-f-g-h-i-j,

где ЩМа – тип прибора по габаритным размерам,

b – номинальное напряжение или коэффициент трансформации по напряжению,

c – номинальный ток или коэффициент трансформации по току,

d – условное обозначение напряжения питания,

e – наличие дополнительного интерфейса и дискретных входов,

f – наличие интерфейса Ethernet, дополнительных опций;

g – условное обозначение схемы измерения,

h – цвет или вид индикаторов,

i – наличие выходных сигналов;

j – специальное исполнение.

Конструктивно приборы выполнены в ударопрочном, пылезащищенном, пластмассовом корпусе щитового крепления. Приборы работоспособны при установке в любом положении. Приборы не имеют подвижных частей и являются виброустойчивыми и вибростойкими.

Дополнительно приборы могут изготавливаться с различными вариантами передней панели с креплением на DIN-рейку.

Приборы со светодиодными семисегментными индикаторами, изготавливаемые для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата, предназначены для исполнения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 и для работы в интервале температур от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре плюс 35 °С.

Приборы соответствуют требованиям к рабочим условиям (механические воздействия) по группе 4 ГОСТ 22261-94.

Доступ к внутренним частям приборов возможен только с нарушением пломб/этикеток.

КОПИЯ ВЕРНА

Лист № 3

Всего листов 10

Приборы являются восстанавливаемыми, ремонтными изделиями.

Общий вид приборов с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), габаритные и установочные размеры приведены на рисунках 1 – 3.

Место нанесения заводских (серийных номеров) – в верхней части лицевой панели; способ нанесения – накатка; формат – цифровой (символ «№» и 5 цифр).

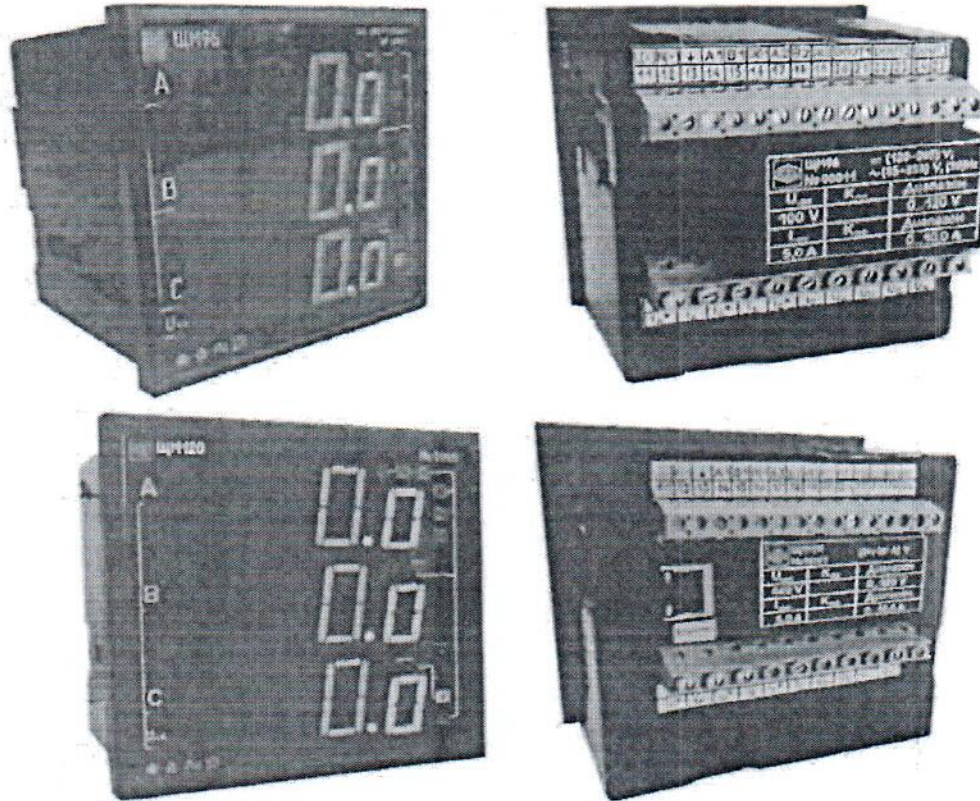


Рисунок 1 – Общий вид приборов


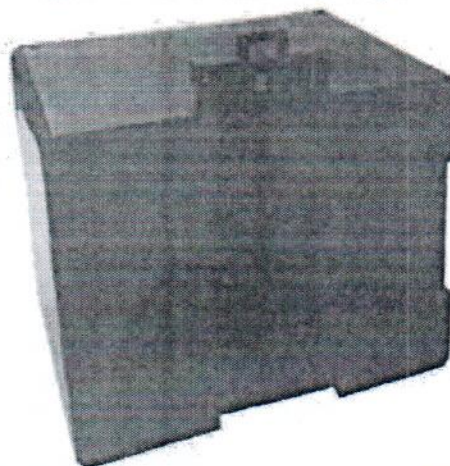


Рисунок 2 – Пример крепления прибора на DIN-рейке

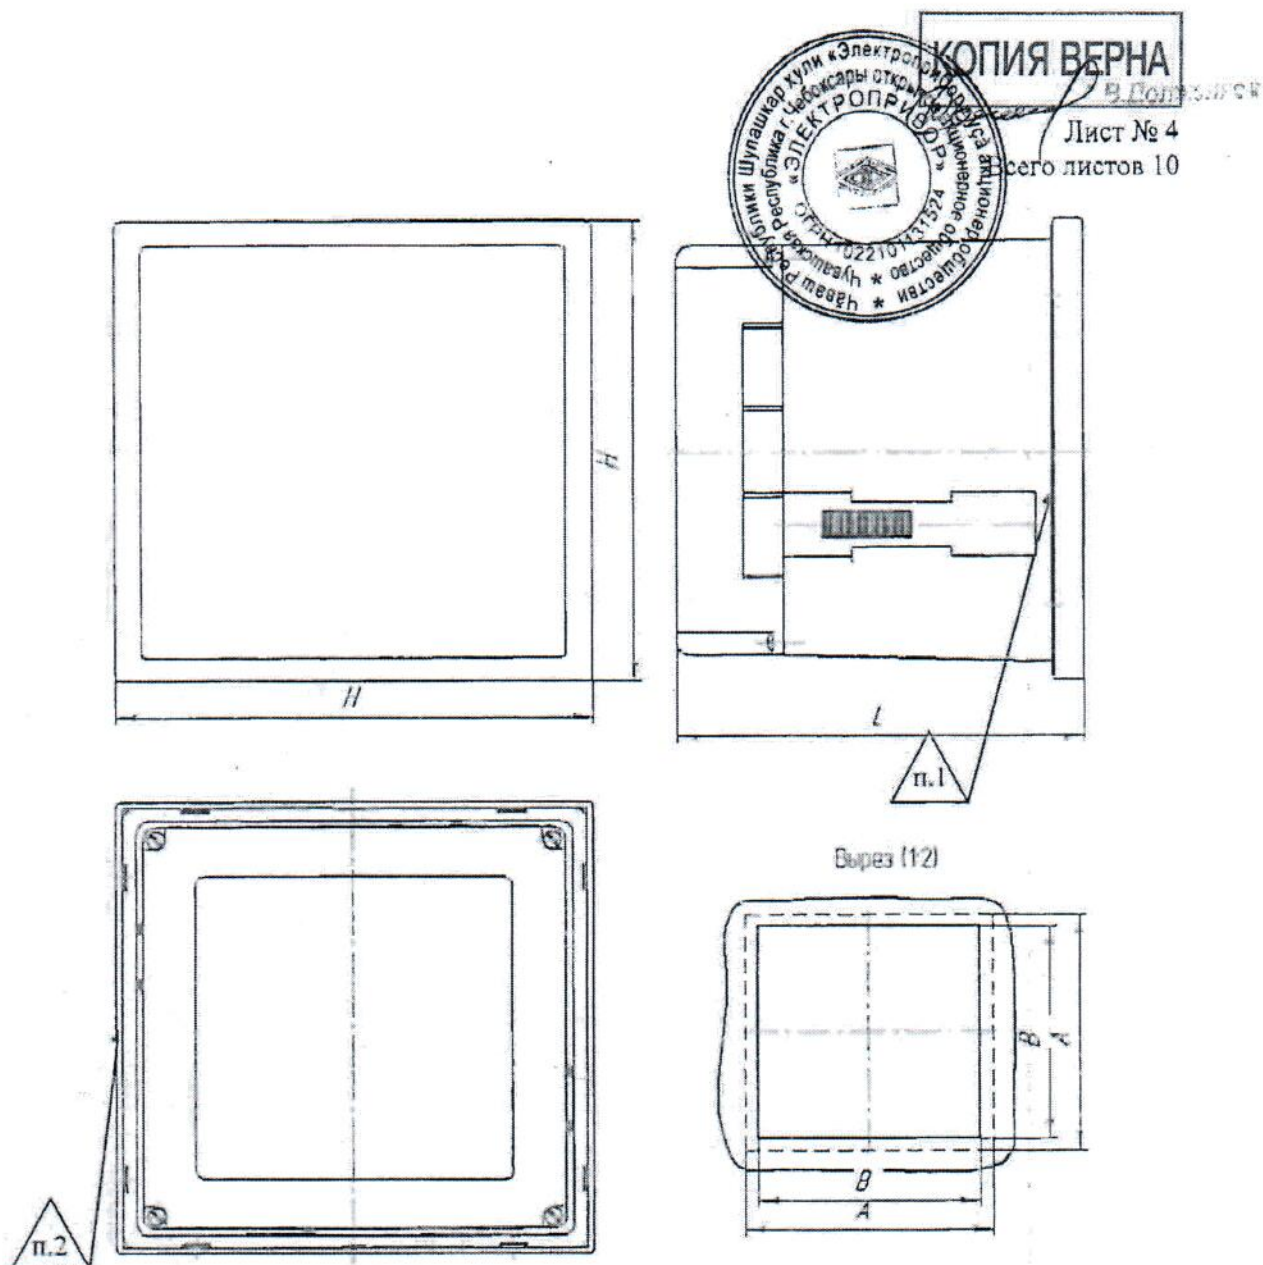

- п. 1 – место пломбирования
п. 2 – место нанесения знака поверки


Рисунок 3 – Габаритные и установочные размеры

Примечание: значения размеров приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация	H, мм, не более	L, мм, не более	A, мм, не более	B, мм, не более
ЦМ96	96	103	100	$92^{+0,8}$
ЦМ120	120	103	100	$92^{+0,9}$

Примечание – приборы (при необходимости) могут иметь габаритные размеры отличные от указанных в таблице, но не более 120×120 мм



Номинальные значения входных токов и напряжений, измеряемых мощностей для приборов трехфазной сети соответствуют значениям, представленным в таблице 4.



КОПИЯ ВЕРНА

Лист № 6
Всего листов 10

Таблица 4

Схема измерений	Напряжение фазное, В		Напряжение линейное (междуфазное), В		(фазный) ток, А	Номинальная мощность (активная, реактивная, полная), Вт, вар, В·А	
	Номинальное значение	Предел измерений	Номинальное значение	Предел измерений		Фазная	Трехфазная (суммарная)
Трехпроводная	—	—	100	120	1,0 5,0	—	173,2 866,0
	—	—	400	480	1,0 5,0	—	692,8 3464,1
Четырехпроводная	57,73 (57,7*)	69,82	100	120	1,0 5,0	57,7 288,6	173,2 866,0
	230,94 (230*)	277,1	400	480	1,0 5,0	230,9 1154,7	692,8 3464,1

Примечание — * условное обозначение номинального фазного напряжения

Номинальные значения входных токов и напряжений для приборов однофазной сети соответствуют значениям, представленным в таблице 5.

Таблица 5

Номинальное напряжение, В	Рабочая область значений входных напряжений, В	Номинальный ток, А	Способ включения
400	от 0 до 480	1; 5	Непосредственный
		1; 5	Через трансформатор тока
100	от 0 до 120	1; 5	Через трансформаторы тока и напряжения

Номинальное значение коэффициента активной мощности $\cos \varphi_{ном} = 1$, коэффициента реактивной мощности $\sin \varphi_{ном} = 1$. Номинальное значение частоты измеряемых сигналов 50 Гц.

Напряжение питания приборов соответствуют значениям, представленным в таблице 6.

Таблица 6

Условное обозначение напряжения питания	Напряжение питания
24ВН	от 18 до 36 В постоянного тока
220ВУ	от 85 до 270 В переменного тока частотой (50±2,5) Гц или от 100 до 265 В постоянного тока

Приборы могут иметь исполнение с дискретными входами.

Максимальное значение тока 10 мА ($R_{вх.инн} = 0$ Ом), напряжением на разомкнутых клеммах: 24 В. Дискретные входы гальванически разделены от остальных цепей прибора.

Приборы могут иметь исполнение с дискретными выходами гальванически разделенным от остальных цепей, с коммутацией постоянного напряжения до 300 В и током до 100 мА или переменного напряжения до 200 В и током до 100 мА по каждому выходу.

Приборы могут иметь исполнение с аналоговыми выходами. Диапазон изменений выходного аналогового сигнала представлен таблице 7. Диапазон изменений выходного аналогового сигнала может быть перепрограммирован при помощи программы-конфигуратора.



КОПИЯ ВЕРНА

Лист № 7
Всего листов 10

Таблица 7

Условное обозначение аналогового выхода	Диапазон изменений выходного аналогового сигнала, мА	Нормирующее значение выходного аналогового сигнала, мА
A	от 0 до 5	5
B	от 4 до 20	20
C	от 0 до 20	20
AP ¹⁾	от 0 до 5 мА	5
BP ²⁾	от 4 до 20 мА	20
CP ³⁾	от 0 до 20 мА	20
EP ⁴⁾	от -5 до +5 мА	5

Примечания

¹⁾ Диапазон изменений выходного аналогового сигнала с условным нулевым значением, равным 2,5 мА (для двуполярного входного сигнала);

²⁾ Диапазон изменений выходного аналогового сигнала с условным нулевым значением, равным 12 мА (для двуполярного входного сигнала);

³⁾ Диапазон изменений выходного аналогового сигнала с условным нулевым значением, равным 10 мА (для двуполярного входного сигнала);

⁴⁾ Диапазон изменений выходного аналогового сигнала с условным нулевым значением, равным 0 мА (для двуполярного входного сигнала)

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений выходных аналоговых сигналов равны $\pm 0,5$ %. Нормирующие значения выходного аналогового сигнала представлены в таблице 7.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ_X , а также абсолютной погрешности ΔX приборов по измеряемому или вычисляемому параметру X не превышают значений, представленных в таблице 8.

Таблица 8

Параметр	γ_X , %	Нормирующее значение	ΔX
Действующее значение фазного напряжения, В при $0,2 \cdot U_{ном} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{ном}$	$\pm 0,2$	$U_{ф.ном}$	-
Действующее значение линейного напряжения, В при $0,2 \cdot U_{ном} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{ном}$, В	$\pm 0,2$	$U_{л.ном}$	
Действующее значение фазного тока, А при $0,01 \cdot I_{ном} \leq I \leq 2 \cdot I_{ном}$	$\pm 0,2$	$I_{ф.ном}$	
Активная мощность фазы нагрузки, Вт	$\pm 0,5$	$P_{ф.ном}$	
Суммарная активная мощность, Вт		$P_{ном}$	
Реактивная мощность фазы нагрузки, вар		$Q_{ф.ном}$	
Суммарная реактивная мощность, вар		$Q_{ном}$	
Полная мощность фазы нагрузки, В·А		$S_{ф.ном}$	
Суммарная полная мощность, В·А		$S_{ном}$	
Коэффициент мощности $\cos \varphi \pm (0,1 \dots 1)$ при $0,6 \cdot U_{ном} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{ном}$ $0,2 \cdot I_{ном} \leq I \leq 2,0 \cdot I_{ном}$		-	
Частота сети, Гц	-	-	$\pm 0,01$

Пределы допускаемых дополнительных погрешностей измерений, вызванных изменением влияющих величин от нормальных значений, представлены в таблице 9.



КОПИЯ ВЕРНА

Лист № 8

Всего листов 10

Таблица 9

Наименование влияющей величины	Диапазон значений влияющей величины	Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений/преобразования
Изменение температуры окружающего воздуха от нормальной	Для климатического исполнения УХЛЗ.1: от -40 до +10 °С; от +30 до +70 °С	0,5 предела допускаемых основных погрешностей
Изменение относительной влажности воздуха от нормальной	Для климатического исполнения УХЛЗ.1: от 80 до 98 % (при температуре +35 °С)	
Изменение частоты сети, Гц	от 45 до 55	
Изменение коэффициента мощности	от 0 до +1; от +1 до 0; от 0 до -1; от -1 до 0	
Изменение напряжения сети питания, В	Постоянный ток от 100 до 220; от 220 до 265 Переменный ток от 85 до 220; от 220 до 270	

Таблица 9а – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм, не более: для ЩМ96	96 96 103
- длина	
- высота	
- глубина	120 120 103
для ЩМ120	
- длина	
- высота	0,5 0,9
- глубина	
Масса, кг, не более: для ЩМ96	0,5 0,9
для ЩМ120	
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	от +10 до +30 от 30 до 80 от 84 до 106,7 (от 630 до 795) от 225,4 до 234,6 от 47 до 53
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С для климатического исполнения УХЛЗ.1 - относительная влажность воздуха, % для климатического исполнения УХЛЗ.1 - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) - частота переменного тока, Гц	от -40 до +70 98 от 84 до 106,7 (от 630 до 795) от 45 до 55
Потребляемая мощность, В·А, не более	15



КОПИЯ ВЕРНА

Лист № 9

Всего листов 10

Продолжение таблицы 9а

Наименование характеристики	Значение
Точность отсчета времени часов для приборов, имеющих исполнение с цифровым интерфейсом Ethernet, при наличии внешнего источника синхронизации S(NTP), не хуже, мс ¹⁾	1
Средний срок службы, лет	30
Средняя наработка на отказ, ч	250 000
Срок сохранности в упаковке и выполненной изготовителем консервации, лет, не менее	1
Примечания ¹⁾ При отсутствии синхронизации часов прибора от внешнего источника уход времени не превышает 0,5 с в сутки. Приборы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.2.091-2012, включая безопасность обслуживающего персонала в части защиты от поражения электрическим током, опасной температуры, воспламенения	

Знак утверждения типа

наносится на этикетку прибора, титульные листы Руководства по эксплуатации и паспорта прибора типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 10 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Прибор (в соответствии с заказом)	ЦМ	1 шт.
Комплект монтажных частей	—	1 шт.
Паспорт	ОПЧ.140.333 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	ОПЧ.140.333 РЭ	1 экз. ¹⁾
Примечание – ¹⁾ допускается один экземпляр на партию из 10 шт.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации ОПЧ.140.333 РЭ в разделе 3 «Использование по назначению».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам цифровым электроизмерительным многофункциональным серии ЦМ

ГОСТ 22261-94 Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2018 г. № 1053 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $2 \cdot 10^9$ Гц»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2015 г. № 575 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств



КОПИЯ ВЕРНА

Лист № 10
Всего листов 10

измерений силы переменного электрического тока от $1 \cdot 10^{-1}$ до $1 \cdot 10^6$ Гц»

ГОСТ 8.551-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. № 1621 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»

ТУ 25-7504.211.1-2010 Приборы цифровые электроизмерительные многофункциональные серии ЦМ. Технические условия

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02B52A920040ACD500155C454C1E1FAD5E
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021

А.П. Шалаев

М.п

«2» ноября 2021 г.

