



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

4413

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип

Осциллографы универсальные С1-127, С1-127/1,

ЧУП "Завод СВТ", г. Минск, Республика Беларусь (ВУ),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 16 0052 07** и допущен к применению в Республике Беларусь с 22 февраля 2007 г.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



С.А. Ивлев

22 февраля 2007 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ 02-02

22 ФЕВ 2007

секретарь НТК

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

**УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР**

Республиканского унитарного пред-
приятия «Белорусский государствен-
ный институт метрологии»

ЖАГОРА Н.А.

2007



ОСЦИЛЛОГРАФЫ С1-127

**ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РБ 0316005207

Выпускают по УШЯИ.411161.001 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Осциллографы С1-127, С1-127/1 (далее осциллографы) предназначены для наблюдения и измерения электрических сигналов размахом от 4 мВ до 300 В и длительностью от 20 нс до 2 с в полосе частот от 0 до 50 МГц.

Область применения: производство, эксплуатация, ремонт и наладка различной радиоэлектронной аппаратуры.

ОПИСАНИЕ

Осциллографы содержат следующие составные части:

- тракт вертикального отклонения (с линией задержки);
- блок развертки;
- блок управления;
- ЭЛТ;
- источник вторичного электропитания со схемой управления ЭЛТ.

Исследуемый сигнал подается на вход одного или обоих каналов тракта вертикального отклонения, где осуществляется усиление сигнала до напряжений, обеспечивающих заданный размер изображения по вертикали на экране ЭЛТ. В тракте вертикального отклонения осуществляется коммутация каналов в зависимости от заданного режима работы каналов осциллографа.

Блок развертки обеспечивает получение синхронного с исследуемым сигналом линейного развертывающего напряжения и его усиление для получения заданного размера изображения сигнала по горизонтали, а также осуществляет управление яркостью ЭЛТ и производит гашение обратного хода луча.

Блок управления служит для управления режимами работы тракта вертикального отклонения и блоком развертки и для их калибровки, а также для компенсации делителя 1:10.

Линия задержки осуществляет необходимую задержку исследуемого сигнала для получения возможности исследования его переднего фронта и подачу его на выходной усилитель "У".

ЭЛТ служит для преобразования электрических сигналов, поступающих с усилителей горизонтального и вертикального отклонения в видимое изображение исследуемого сигнала на экране ЭЛТ.



Источник вторичного электропитания предназначен для преобразования переменных напряжений питающей сети (для осциллографа С1-127 с блоком преобразователя) в необходимые для питания узлов осциллографа уровни напряжений, их стабилизации и сглаживания пульсаций.

Осциллограф С1-127/1 отличается от осциллографа С1-127:

- рабочими условиями эксплуатации;
- комплектом поставки;
- размером рабочей части экрана;
- отсутствием канала «Z» (вход Z - для осуществления внешней яркостной модуляции) и блока преобразователя сети.

Осциллографы С1-127, С1-127/1 выполнены в виде настольных переносных приборов.

Внешний вид осциллографов приведен на рисунках 1 и 2.

Место нанесения на осциллографах оттиска поверительного клейма и поверительного клейма наклейки приведено в приложении А.



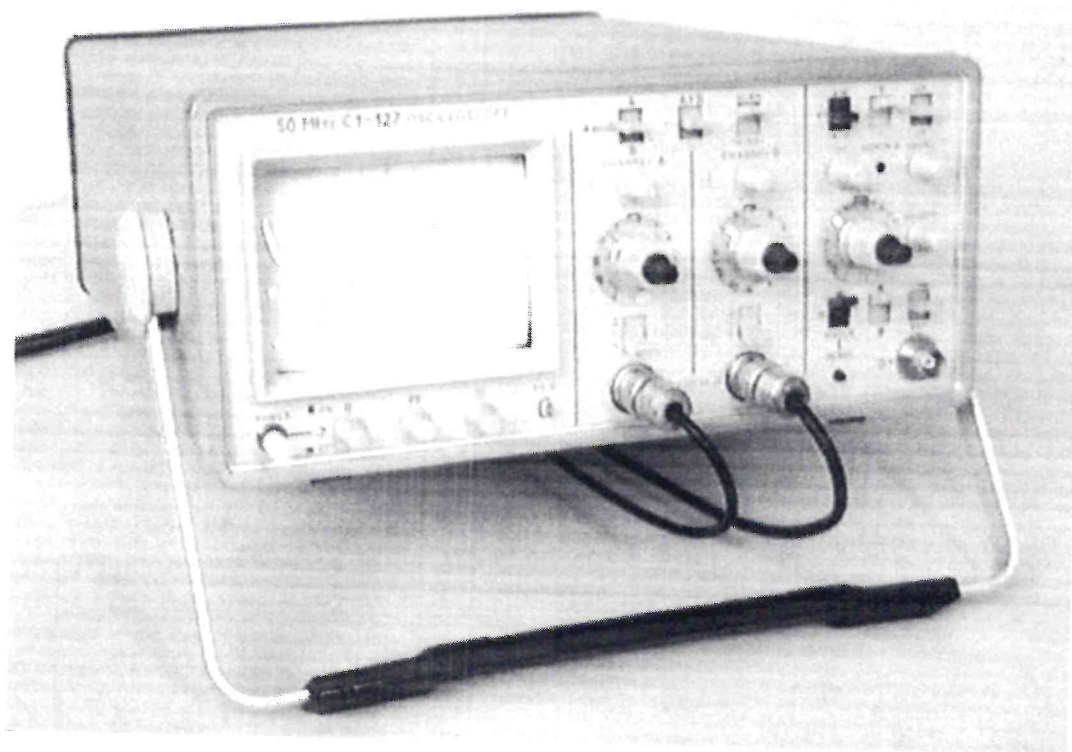


Рисунок 1 - Осциллограф C1-127. Внешний вид.

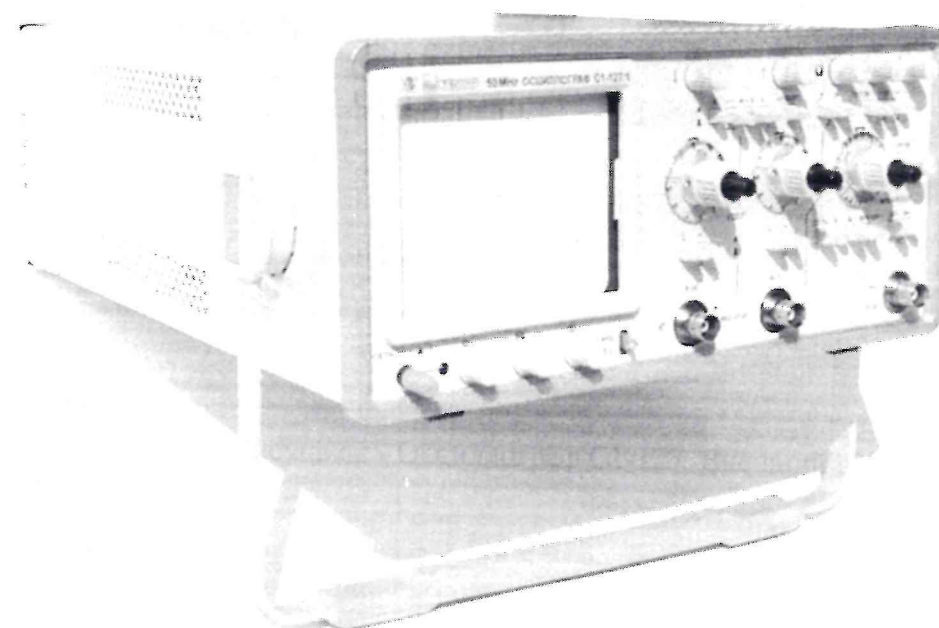


Рисунок 2 - Осциллограф C1-127/1. Внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая часть экрана	60 x 80 мм для С1-127, 64x80 мм для С1-127/1
Число каналов	2
Диапазон коэффициентов отклонения	от 1 мВ/дел до 5 В/дел
Пределы допускаемого значения основной погрешности:	
- для коэффициентов отклонения (0,005-5) В/дел	±3 % (± 4 % с делителем 1:10)
- для коэффициентов отклонения 1 и 2 мВ/дел	±4 % (± 5 % с делителем 1:10)
- в рабочих условиях эксплуатации для коэффициентов отклонения (0,005-5) В/дел	±4,5 % (±5,5 % с делителем 1:10)
- для коэффициентов отклонения 1 и 2 мВ/дел	±6,0 % (±7 % с делителем 1:10)
Диапазон коэффициентов развертки	от 0,05 мкс/дел до 0,2 с/дел
Пределы допускаемого значения основной погрешности коэффициентов развертки:	
- с растяжкой	±3 %
- в рабочих условиях эксплуатации	±4 %
- с растяжкой	±4,5 %
Пределы допускаемого значения основной погрешности измерения временных интервалов для коэффициентов развертки 0,05; 0,1; 0,2 мкс/дел	±6 %
- в рабочих условиях эксплуатации	±5 % (с растяжкой) ±7,5 %

Параметры переходной характеристики (ПХ):

Параметры ПХ	0,005-2 В/дел	5 В/дел	1, 2 мВ/дел	с делителем 1:10 (0,005-2 В/дел)
Время нарастания, нс, не более	7	7	35	7
Выброс, %, не более	5	5	5	10
Время установления, нс, не более	35	35	200	35
Неравномерность на участке установления, %, не более	5	10	5	5
Неравномерность, %, не более	2	2	5	5

Параметры калибратора:

- частота следования импульсов	(1000±10) Гц
- амплитуда	(0,6±0,006) В

Параметры входов каналов вертикального отклонения: непосредственного:

- входное активное сопротивление	(1± 0,03) МОм
- с делителем 1:10)	(10±0,3) МОм
- входная емкость, не более	25 пФ
- с делителем 1:10	15 пФ

Диапазон частот синхронизации

от 10 до 75 МГц для С1-127,
от 10 до 70 МГц для С1-127/1

Минимальный уровень сигнала, не более:

при внутренней синхронизации	0,8 дел
при внешней синхронизации	0,2 В



Масса осциллографа, не более	6 кг
Габаритные размеры, не более	295x130x405 мм
Потребляемая мощность, не более	50 В А (для С1-127), 65 В А (для С1-127/1)
Средняя наработка на отказ, не менее	7000 ч
Гамма-процентный ресурс при $\gamma = 95\%$, не менее	10000 ч
Среднее время восстановления, не более	3 ч
Время непрерывной работы	16 ч
Рабочие условия эксплуатации осциллографа С1-127:	
- температура	от минус 30 до плюс 50 °С
- влажность	98 % при 25 °С
Рабочие условия эксплуатации осциллографа С1-127/1:	
- температура	от плюс 5 до плюс 40 °С
- влажность	90 % при 25 °С
Напряжение питающей сети осциллографов	(220 ± 22) В частотой (50 ± 1) Гц; (220 ± 11) В, (115 ± 6) В частотой (400 ± 10) Гц; (27 ± 2,7) В
с блоком преобразователя для С1-127	

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА


Знак Государственного реестра наносят на лицевую панель осциллографов методом офсетной печати, а также на титульный лист технического описания и инструкции по эксплуатации типографским способом.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав комплекта поставки соответствует таблице 1.
Таблица 1

Наименование, тип	Обозначение	Количество на исполнение		Примечание
		С1-127	С1-127/1	
Осциллограф С1-127	УШЯИ.411161.001	1	-	
Осциллограф С1-127/1	УШЯИ.411161.001-12	-	1	
Комплект ЗИП эксплуатационный, в нем:	Тг4.072.063	1	-	
отвертка	ЕЕ4.094.008	2	-	
блок преобразователя "3.211.014"	Тг3.211.014	1	-	
бленда	Тг7.006.009	1*	-	
кабель N1 "N1"	Тг4.850.252	3	-	
шнур сетевой	РУВИ.685612.017	1	-	
светофильтр	Тг7.222.041	1*	-	
крышка	Тг7.852.552	1	-	
вставка плавкая ВП2Б-1В 2,0 А	АГО.481.304 ТУ	4	-	
переход СР-50-95 ФВ "СР-50-95 ФВ"	ГУЗ.640.095	2	-	
делитель 1:10	Тг2.727.032-12	2	-	со шнуром Тг6.640.399
щуп	Тг6.360.005	2	-	
щуп	Тг6.360.006	2	-	
щуп	Тг6.360.008	2	-	
щуп	Тг6.360.012	2	-	со шнуром Тг6.640.399
наконечник	Тг6.627.018	2	-	
колпачок	Тг8.634.414	2	-	
Эксплуатационная документация				
Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 1	УШЯИ.411161.001 ТО	1	-	
Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть II Альбом схем	УШЯИ.411161.001 ТО1	1	-	
Формуляр	УШЯИ.411161.001 ФО	1	-	



Окончание таблицы 1

Наименование, тип	Обозначение	Количество на исполнение		Примечание
		С1-127	С1-127/1	
Комплект принадлежностей, в нем:	РУВИ.305654.015	-	1	
делитель 1:10	НР-9250	-	2	
переход СР-50-95 ФВ	ГУЗ.640.095	-	2	
вставка плавкая ВП2Б-1В 2,0 А	АГО.481.304 ТУ	-	4	
кабель NI	Тг4.850.252	-	3	
отвертка	7810-0301 ЗВ1 ГОСТ 17199	-	1	
шнур сетевой	РУВИ.685631.040	-	1	
Эксплуатационная документация:				
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	УШЯИ.411161.001-12 ТО	-	1	
Формуляр	УШЯИ.411161.001 ФО	-	1	

* поставляются только для приборов с приемкой ПЗ и на экспорт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

УШЯИ.411161.001 ТУ «Осциллографы С1-127, С1-127/1. Технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.091-2002 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

УШЯИ.411161.001 ТО «Осциллограф С1-127. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. (Методика поверки- раздел 9)».

УШЯИ.411161.001-12 ТО «Осциллограф С1-127/1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. (Методика поверки- раздел 8)».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осциллографы С1-127, С1-127/1 соответствуют требованиям УШЯИ.411161.001 ТУ, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.2.091-2002.


Межповерочный интервал – 24 мес.

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ.
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 234-98-13,
аттестат аккредитации № ВУ112.02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Частное производственное унитарное предприятие «Завод СВТ»
220005, г. Минск, пр. Независимости, 58, к. 30, тел. 293-94-68, факс 284-46-47.
Реквизиты: р/с3012072700010 в ф-ле 529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк» по
г. Минску, код банка 153001720, УНН 190737825, ОКПО 37696999.

Директор частного производственного унитарного предприятия «ЗСВТ»



К.В.Рябокоть

« 2 » 05 2007

Начальник научно-исследовательского центра
испытаний средств измерений и техники БелГИМ


С.В.Курганский

« _____ » _____ 2007

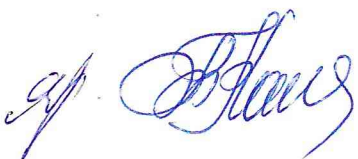



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

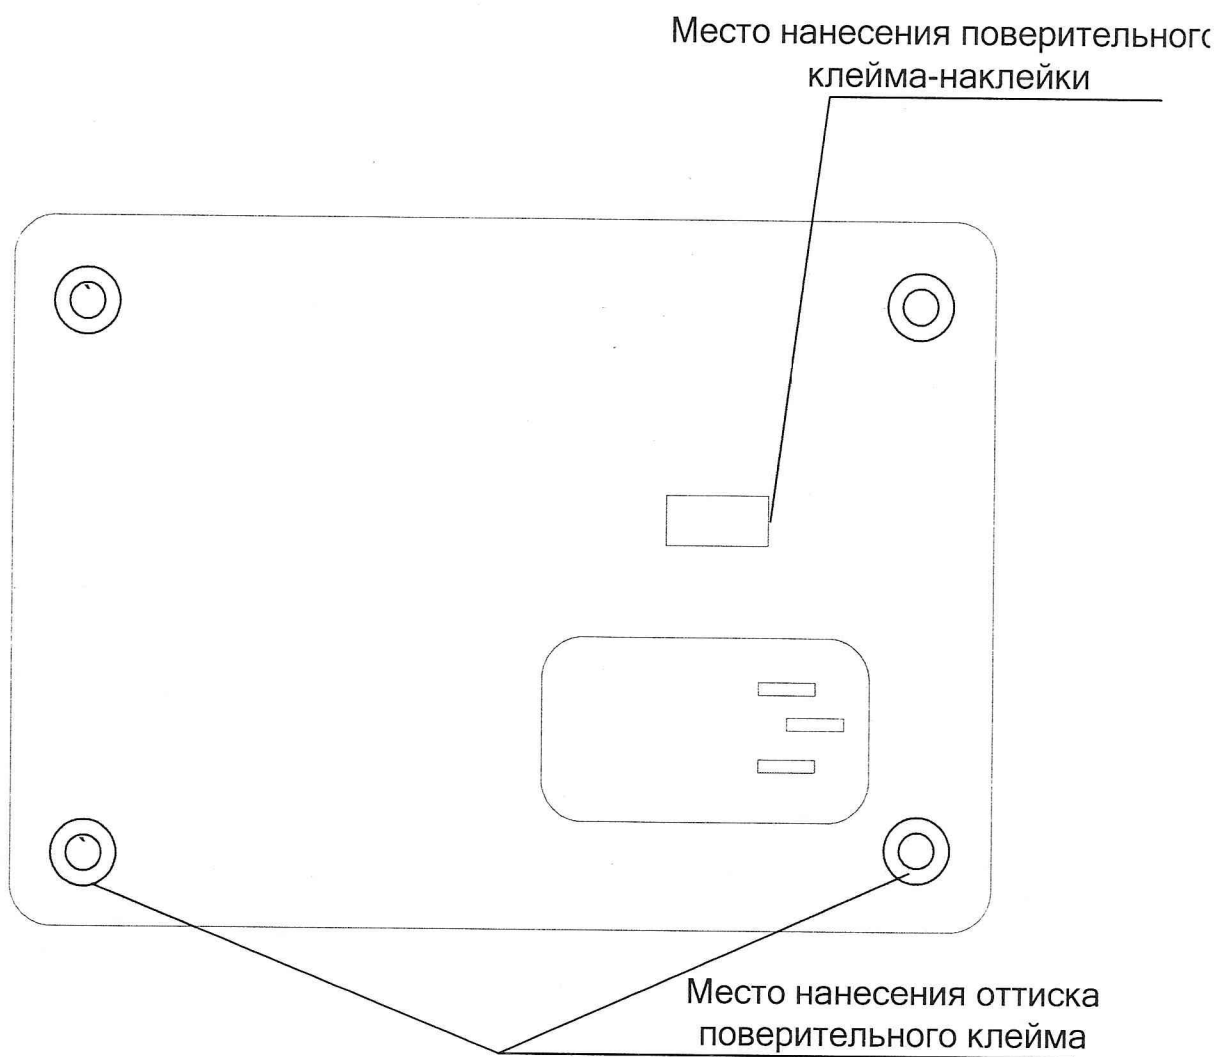


Рисунок А.1 – Место нанесения на задней панели осциллографов С1-127, С1-127/1
оттиска поверительного клейма и поверительного клейма наклейки.