

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

---



№ 19644 от 18 февраля 2026 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:  
**Анализатор окислов азота APNA-370 № 904724**

Производитель:  
**«HORIBA Europe GmbH», Германия**

Выдан:  
**Филиалу «Гомельоблгидромет», г. Гомель, Республика Беларусь**

Документ на поверку:  
**МРБ МП.МН 3886-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы окислов азота APNA-370. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 18.02.2026 № 22  
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений  
от 18 февраля 2016 г. № 19644

Наименование типа средств измерений и их обозначение:  
Анализатор окислов азота APNA-370 № 904724

Назначение и область применения:

Анализатор окислов азота APNA-370 № 904724 (далее – газоанализатор) предназначен для измерений объемной доли оксида азота (NO), диоксида азота (NO<sub>2</sub>), суммы окислов азота (NO<sub>x</sub>).

Область применения – осуществление гидрометеорологической деятельности, мониторинг окружающей среды.

Описание:

Принцип действия газоанализатора основан на двойной перекрестной модуляции потоков с использованием хемиллюминесценции, суть которой состоит в разделении анализируемого газа на две части, одна из которых анализируется с преобразованием (восстановлением NO<sub>2</sub> до NO) с целью определения содержания суммы окислов NO<sub>x</sub>, а другая анализируется без преобразования с целью определения содержания NO. Содержание NO<sub>2</sub> определяется как разность концентраций NO<sub>x</sub> и NO.

Газоанализатор представляет собой стационарный автоматический показывающий прибор непрерывного действия, используемый как автономно, так и в составе измерительных аналитических комплексов.

Конструктивно газоанализатор выполнен в одном блоке, где конвертер и анализатор располагаются в двух отдельных блоках.

На лицевой панели газоанализатора расположены органы управления, сенсорный графический жидкокристаллический экран, разъем для карты памяти типа CF, корпус основного фильтра, служебный последовательный порт.

На задней панели газоанализатора расположены последовательный порт ввода/вывода данных RS-232C, аналоговый выход 4-20 мА (опционально) и порт Ethernet.

Способ отбора пробы – принудительный, при помощи встроенного побудителя расхода.

Газоанализатор применяется только во взрывобезопасных помещениях.

В газоанализаторе предусмотрена возможность автоматической корректировки нулевых показаний и чувствительности, автоматического определения диапазона измерения для аналогового выхода.

Газоанализатор имеет встроенное программное обеспечение (далее – ПО).

ПО осуществляет функции:

- выбор измерительного канала;
- расчет содержания определяемого компонента,
- отображение результатов измерений на ЖКИ дисплее газоанализатора;
- передачу результатов измерений по интерфейсу связи с ПК,
- контроль целостности программных кодов ПО, настроечных и градуировочных констант;
- контроль общих неисправностей (связь, конфигурация);

- контроль архивации измерений,
- контроль внешней связи (RS232C, Ethernet).

Дата изготовления газоанализатора указана на маркировочной табличке.

Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование   | Значение  |
|--|-----------|
| Диапазон измерений объемной доли оксида азота (NO), диоксида азота (NO <sub>2</sub> ), суммы окислов азота (NO <sub>x</sub> ), ppм   | от 0 до 1 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении объемной доли оксида азота (NO), диоксида азота (NO <sub>2</sub> ), суммы окислов азота (NO <sub>x</sub> ) в диапазоне измерений от 0 ppм до 0,1 ppм включительно, % | ±25       |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемной доли оксида азота (NO), диоксида азота (NO <sub>2</sub> ), суммы окислов азота (NO <sub>x</sub> ) в диапазоне измерений свыше 0,1 ppм до 1 ppм, %         | ±25       |

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование   | Значение                   |
|--|----------------------------|
| Предел обнаружения, ppб*   | 0,5                        |
| Время установления показаний, с, не более*   | 120                        |
| Время прогрева, ч, не более*   | 3                          |
| Масса, кг, не более  | 21                         |
| Габаритные размеры, мм, не более   | 430×550×221                |
| Номинальное напряжение питания сети переменного тока с частотой 50 Гц, В*  | 230                        |
| Потребляемая мощность, В·А*  | 170                        |
| Условия эксплуатации:<br>диапазон температуры окружающего воздуха, °С<br>диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %, не более | от 15 до 25<br>от 20 до 80 |
| *Согласно паспорту. При проведении метрологической экспертизы проверка указанных характеристик не проводилась.                             |                            |

Комплектность: представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование                               | Количество |
|--|------------|
| Анализатор окислов азота APNA-370 № 904724 | 1          |
| Паспорт                                    | 1          |

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа средств измерений наносится на лицевую панель газоанализатора.

Поверка осуществляется по МРБ МП.МН 3886-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы окислов азота APNA-370. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений:

техническая документация (паспорт) «HORIBA Europe GmbH», Германия; методика поверки:

МРБ МП.МН 3886-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Анализаторы окислов азота APNA-370. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование и тип средств поверки  |
|---|
| Термогигрометр UNITESS THB1   |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01»  |
| Мультигазовый калибратор SONIMIX 3022-2000  |
| Ротамерт РМ-А-0,25 ГУЗ  |
| Стандартные образцы состава газовых смесей NO-N <sub>2</sub>  |
| Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью. |

Идентификация программного обеспечения: представлена в таблице 5.

Таблица 5

| Идентификационное наименование ПО | Номер версии ПО<br>(идентификационный номер) |
|-----------------------------------|--|
| -                                 | P1000878001M                                 |

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя, а также техническому заданию заявителя на метрологическую экспертизу в отношении единичного экземпляра средства измерений: анализатор окислов азота APNA-370 № 904724 соответствует требованиям технической документации (паспорту) «HORIBA Europe GmbH», Германия.

Производитель средств измерений  
«HORIBA Europe GmbH», Германия  
Julius-Kronenberg-Str 9, 42799 Leichlingen, Germany

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

Телефон: +375 17 374-55-01

факс: +375 17 244-99-38


e-mail: info@belgim.by

- Приложения:
1. Фотографии общего вида средств измерений на 1 листе.
  2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

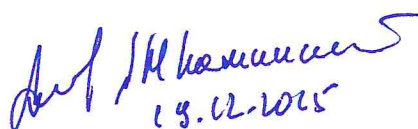  
19.12.25

  
19.12.25

Приложение 1  
(обязательное)  
Фотографии общего вида средств измерений



Рисунок 1.1 – Фотография общего вида анализатора окислов азота APNA-370 № 904724

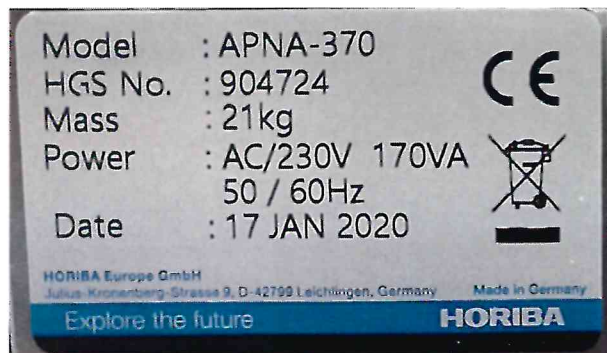


Рисунок 1.2 – Фотография маркировки анализатора окислов азота APNA-370 № 904724

Приложение 2  
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений



Рисунок 2.1 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки