

**Описание типа средств измерений для
Государственного реестра средств измерений**

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП «Белорусский

государственный институт метрологии»

Н. А. Жагора

Сентябрь 2011 г.



**Приборы специализированные определения
концентрации паров этанола в
выдыхаемом воздухе «Алконт 01с»,
«Алконт 01см», «Алконт 01су»,
«Алконт 01са»**

**внесенны в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № РБ 03 25 0559 11**

Выпускают по ТУ РБ 28801552.004-99 .

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с», «Алконт 01см», «Алконт 01су», «Алконт 01са»(далее – приборы) предназначены для измерения концентрации паров этанола в воздухе, выдыхаемом испытуемым человеком.

Область применения – предварительное установление факта употребления алкоголя в организациях и учреждениях здравоохранения, промышленности, транспорта, энергетики, связи и министерства внутренних дел.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия приборов основан на изменении электропроводности чувствительного элемента (полупроводникового газового сенсора) при воздействии на него паро-газовой смеси (этиловый спирт – воздух) пропорционально концентрации этанола в воздухе ($\text{мг}/\text{м}^3$). Встроенная микро-ЭВМ производит обработку электрических сигналов, расчёт и выдачу результатов измерений в цифровом виде в единицах промилле (%), соответствующих содержанию алкоголя в крови ($\text{мг}/\text{мл}$).

Приборы имеют следующие исполнения:

- «Алконт 01с» – базовая модель;
- «Алконт 01см», в отличие от исполнения «Алконт 01с», имеет энергонезависимые часы-календарь реального времени и память 255 – 5500 результатов последних измерений с указанием времени их проведения;
- «Алконт 01су», в отличие от других исполнений, не имеет потребительской связи с персональным компьютером, обладает минимальными габаритами и массой.
- «Алконт 01са» обладает максимальными потребительскими свойствами: встроенный аккумулятор с системой контроля «заряд-разряд» для обеспечения автономной работы, энергонезависимая память на 9000 результатов последних измерений с указанием времени проведения, возможность пофамильного контроля до 512 обследуемых, система пробоотбора, исключающая любые симуляции.

Внешний вид приборов «Алконт 01с» приведен на рисунке 1.

Места расположения знака поверки приведены в приложении А.

Всего листов 2, лист 1





Рисунок 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - 69;
- питание приборов: $12,6 \pm 2$ В и 230 ± 23 В (посредством сетевого адаптера);
 - дополнительно 9 В (6 элементов питания АА (R6) у прибора "Алконт 01с";
 - дополнительно встроенный литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 2000 мА·ч у прибора "Алконт 01са";
- максимальная электрическая мощность, потребляемая приборами (без подсветки) - не более 2,5 Вт;
- режим подготовки к работе - автоматический;
- время подготовки к работе - не более 15 минут;
- продолжительность анализа пробы выдыхаемого воздуха, после полного окончания выдоха – не более 15 секунд, у исполнения «Алконт 01са» – не более 10 секунд;
- продолжительность подготовки прибора к следующему тесту после пробы с концентрацией паров этанола в парогазовой смеси на уровне $450 \text{ мг}/\text{м}^3$ (эквивалентной 1,0 %) – не более 40 секунд;
- коэффициент пересчета входной величины прибора - концентрации паров этанола в парогазовой смеси ($\text{мг}/\text{м}^3$) в отображаемую выходную величину - концентрацию этанола в крови (%) равен 450.
- диапазоны измеряемых значений входной величины – от 0 до $225 \text{ мг}/\text{м}^3$, от 270 до $900 \text{ мг}/\text{м}^3$, отображаемых в выходную величину – от 0,0 до 0,5 %, от 0,6 до 2,0 % с дискретностью показаний – 0,1 %;

- полный диапазон экстраполируемых и отображаемых в специальном режиме значений входной величины – от 0 до 3600 мг/м³ в значения выходной величины – от 0,0 до 8,0 %;
- приведенная погрешность приборов ($\gamma_{\text{пр}}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины от 0 до 225 мг/м³, отображаемых в выходные величины от 0,0 до 0,5 %, не более $\pm 20\%$;
- приведенная погрешность приборов ($\gamma_{\text{пр}}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины от 270 до 900 мг/м³, отображаемых в выходные величины от 0,6 до 2,0 %, не более $\pm 15\%$;
- габаритные размеры приборов (без соединительных шнурков, разъемов и выносных частей):
 - не более 160×115×45 мм для «Алконт 01с»,
 - не более 191×74×27 мм для «Алконт 01см», «Алконт 01су», «Алконт 01са»;
- масса приборов:
 - не более 0,6 кг для «Алконт 01с»,
 - не более 0,4 кг для «Алконт 01см»,
 - не более 0,3 кг для «Алконт 01су»,
 - не более 0,4 кг для «Алконт 01са»;
- средняя наработка приборов на отказ – не менее 6000 часов;
- средний срок службы приборов – не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 8 часов в сутки;
- среднее время восстановления работоспособности приборов путем замены отказавшего газового сенсора – не более 30 минут;
- средний срок сохраняемости приборов – не менее 6 месяцев.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Места и способ нанесения знака утверждения типа:

- таблички на корпусах приборов: в верхней части табличек слева от товарного знака изготовителя и его наименования методом печати;
- в формулярах приборов: на титульных листах формулляров выше наименования приборов в центре листа методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приборов указана в таблице.

	“Алконт 01с” ТФАГ413422.001	“Алконт 01см” ТФАГ413422.001-01	“Алконт 01су” ТФАГ413422.001-02	“Алконт 01са” ТФАГ413422.001-03
1	2	3	4	5
1. Прибор	1	1	1	1
2. Комплект принадлежностей:				
элементы питания R6(AA)	6 (по заказу)	—	—	—
сетевой адаптер 220В/12В,500mA	1	1	1	1
мундштук (ТФАГ713423.001)	100	100	100	100
шнур питания от бортовой сети	1 ТФАГ465139.001	1 ТФАГ465139.001-01	1 ТФАГ465139.001-01	1 ТФАГ465139.001-01



Всего листов 3 из 3

продолжение таблицы

1	2	3	4	5
шнур связи с ПК	1 ТФАГ465644.001	1 ТФАГ465644.001-01	—	1 ТФАГ465644.001-01
дискета с программой поддержки для ПК, 3,5"	1 (Alcont.exe)	—	—	—
диск CD-R с программой поддержки для ПК	—	1 (Alc.exe)	—	1 (Alca.exe)
3. Формуляр	1 ТФАГ413422.001ФО	1 ТФАГ413422.001-01ФО	1 ТФАГ413422.001-02ФО	1 ТФАГ413422.001-03ФО
4. Опора (ТФАГ 304274.001)	—	1	1	1
5. Упаковка (СТБ 1015-97)	1	1	1	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ РБ 28801552.004-99 «Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе “Алконт 01с”, “Алконт 01см”, “Алконт 01су”, “Алконт 01са”».

ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

МП.МН 367-05 «Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе “Алконт 01с”, “Алконт 01см”, “Алконт 01су”, “Алконт 01са”. Методика поверки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с», «Алконт 01см», «Алконт 01су», «Алконт 01са» требованиям технической документации соответствуют.

Межповерочный интервал – не более 6 месяцев для приборов, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии.

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ
г. Минск, Старовиленский тракт, 93
тел. 334-98-13
Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025

Разработчик и изготовитель: ООО «Брестское техническое агентство»
г. Брест, ул. Суворова, 112
тел./факс (-10375-0162) 43-56-58

Главный инженер ООО «Брестское
техническое агентство»

С. Е. Кудрявцев


Начальник НИЦСИиТ
БелГИМ

С. В. Курганский

Всего листов



Приложение А
(Обязательное)

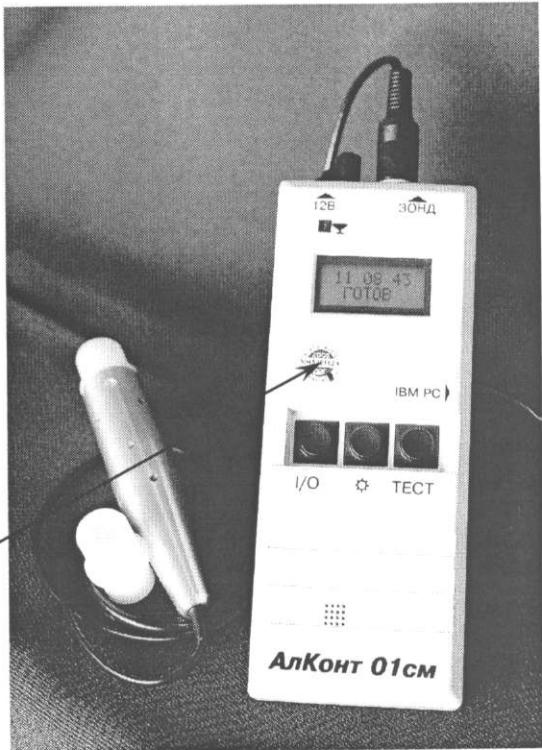

Место расположения знака поверки

