

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Уровнемеры OPTIFLEX

#### Назначение средства измерений

Уровнемеры OPTIFLEX предназначены для контактного измерения дистанции, уровня, раздела фаз жидкостей, паст, шламов, пульп и различных сыпучих материалов.

#### Описание средства измерений

Принцип работы уровнемеров OPTIFLEX основан на методе импульсной рефлектометрии (TDR, Time-Domain Reflectometer): по волноводу посылают зондирующий импульс и измеряют интервал времени двойного пробега этого импульса до места неоднородности волнового сопротивления (границы раздела веществ с разной диэлектрической проницаемостью). Уровень продукта определяется как разность значений высоты установки уровнемера и измеренной дистанции.

Уровнемеры OPTIFLEX состоят из следующих функциональных блоков:

- измерительный преобразователь (преобразователь сигналов), формирующий, излучающий и принимающий радиочастотные импульсы. Он также выполняет измерение интервала времени, и по измеренному значению дистанции до поверхности и значению базовой высоты резервуара вычисляется уровень и объём среды (при наличии градуировочной таблицы);

- фланцевая система, которая соединяет волновод с преобразователем сигналов и соединяет уровнемер с емкостью;

- волновод, по которому распространяются электромагнитные сигналы;
- встроенный индикатор (при наличии), отображающего измеренные величины.

Выходная информация передается по токовому сигналу 4...20 мА с наложенным протоколом HART или по протоколам связи Profibus PA, Foundation Fieldbus.

Уровнемеры OPTIFLEX имеют следующие исполнения:

- 1300 С – компактное;
- 1300 С – разнесенное.

В качестве волновода применяются:

- двойной или одинарный стержень Ø 8 мм длиной до 4 м (неразборный);
- одинарный стержень Ø 8 мм длиной до 6 м (разборный);
- коаксиальный сенсор Ø 22 мм длиной до 6 м (разборный/неразборный);
- сдвоенный трос Ø 4 мм длиной до 8 м;
- одинарный трос Ø 2 мм или 4 мм длиной до 35 м (только для жидкостей);
- одинарный трос Ø 8 мм длиной до 35 м (только для сыпучих продуктов);
- изогнутые версии сенсоров (например, г-образные) заказываются по специальному заказу.

#### Программное обеспечение

Внутреннее ПО реализует функции расчёта расстояния до поверхности среды, уровня, объёма, цифро-аналоговое преобразование измеренных величин в токовое значение на выходе, а также вывод данных на индикатор и через цифровые интерфейсы. На настроочные параметры есть возможность установки пароля.

Уровень защиты ПО уровнемеров OPTIFLEX от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» по Р 50.2.077-2014.



а) 1300 С (компактное исполнение)

б) 1300 С (раздельное исполнение)

Рисунок 1 – Общий вид уровнемеров OPTIFLEX.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

| Идентификационные данные (признаки) | Значение    |
|-------------------------------------|-------------|
| Идентификационное наименование ПО   | VF714/SF719 |
| Номер версии ПО                     | 2.X.X.XX    |
| Цифровой идентификатор ПО           | 0x1146      |

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики

| Наименование параметра   | Значение                  |
|--|---------------------------|
| Диапазон измерений уровня, мм  | 10...35000                |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня (при дистанции до 10 м), мм <sup>1)</sup>      | ± 3                       |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений уровня (при дистанции свыше 10 м), % <sup>1)</sup> | ± 0,03                    |
| Температура окружающей среды, °С   | от минус 40 до плюс 80    |
| Давление измеряемой среды, МПа   | от минус 0,1 до плюс 30,0 |
| Температура на фланце прибора, °С  | от минус 50 до плюс 300   |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В   | 24                        |
| Габаритные размеры конвертора, мм  | 180×182×357               |
| Масса конвертора, кг, не более   | 15,0                      |

Примечание:

<sup>1)</sup> Пределы допускаемой погрешности указаны для оценки результатов измерений уровня как по встроенному индикатору (при наличии), так и по выходному токовому сигналу.

**Знак утверждения типа.**

наносят на корпус уровнемеров OPTIFLEX методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

**Комплектность средства измерений**

Т а б л и ц а 3 – Комплектность средства измерений

| Наименование                | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Уровнемер OPTIFLEX          | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |
| Комплект ЗИП                | По заказу  |

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в руководстве по эксплуатации уровнемеров OPTIFLEX.

**Проверка**

осуществляется по документу: ГОСТ 8.321-2013 «ГСИ. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки».

При поверке применяются следующие средства измерений:

- установка для поверки уровнемеров, ПГ ±1 мм;
- рулетка измерительная металлическая Р50Н2К ГОСТ 7502-98.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к уровням OPTIFLEX**

ТУ 4214-010-33530463-2014 «Уровнемеры OPTIFLEX. Технические условия».

ГОСТ 8.477-82 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости».

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

**Изготовитель**

ООО «КРОНЕ-Автоматика», РФ

Адрес: Россия, 443532, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово.

Тел.: +7 (846) 230 03 70, факс: +7 (846) 230 03 11,

Email: [kar@krohne.su](mailto:kar@krohne.su), Web: <http://www.krohne.ru>

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 31


тел.: +7 (495) 544 00 00, web: <http://www.rostest.ru/>, email: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru)

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

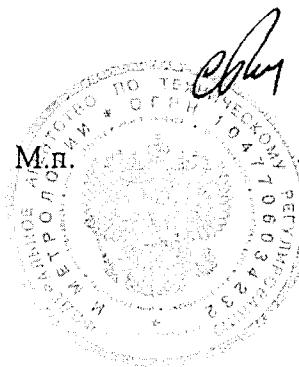

«21» 05 2015 г.