

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Компараторы-калибраторы универсальные КМ300

Назначение средства измерений

Компараторы-калибраторы универсальные КМ300 (далее – компаратор КМ300) предназначены для воспроизведения напряжения, мощности, постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, измерения напряжений постоянного тока, компарирования напряжений постоянного тока, а также воспроизведения угла сдвига фаз между током и напряжением.

Описание средства измерений

В общем случае компаратор КМ300 состоит из следующих трех блоков:

- компаратора – калибратора универсального КМ300К – базового, системообразующего прибора, который управляет остальными блоками компаратора, выполняет функции компарирования напряжения постоянного тока, измерения напряжения постоянного тока, воспроизведения напряжений постоянного и переменного тока. КМ300К может поставляться и использоваться самостоятельно, являясь одной из четырех модификаций компаратора.

- компаратора – калибратора универсального КМ300Р – который является аналогом КМ300К но без функции воспроизведения напряжений переменного тока.

- высоковольтного усилителя (далее – усилитель) КМ300Н.

- преобразователя напряжение - ток (далее – преобразователь) КМ300Т.

Комбинации этих блоков позволяют получить ещё три модификации компаратора:

- компаратор КМ300КН, состоящий из КМ300К и КМ300Н и имеющий расширенный диапазон воспроизведения напряжений постоянного и переменного тока;

- компаратор КМ300КТ, состоящий из КМ300К и КМ300Т и имеющий расширенный диапазон воспроизведения силы постоянного и переменного токов;

- компаратор КМ300КНТ, состоящий из КМ300К, КМ300Н и КМ300Т.

Компаратор КМ300КН при совместной работе с компаратором КМ300КТ обеспечивает воспроизведение мощности и угла сдвига фаз между током и напряжением.

Компаратор – калибратор универсальный КМ300К конструктивно состоит из калибратора, цифрового микровольтметра и микроконтроллера, управляющего работой всего калибратора и обеспечивающего вывод информации для индикации на лицевую панель и связь с подключаемым оборудованием через интерфейсы.

Калибратор содержит источник опорного напряжения, многозначную меру отношения (ММО) напряжений, выполненную на операционном индуктивном делителе, позволяющим получить калибратор напряжений с малыми шумами и стабильным коэффициентом отношения напряжений (Ко), не зависящим от температуры, т.к. Ко определяется числом витков.

Цифровой микровольтметр создан на современной элементной базе, и по сути используется как «нуль-индикатор» при компарировании напряжений постоянного тока. Кроме этого имеется возможность использования микровольтметра для измерения напряжения постоянного тока непосредственно.

На лицевую панель компаратора КМ300К выведены органы управления и индикации.

Общий вид и места нанесения поверительных клейм компараторов – калибраторов универсальных КМ300 представлены на рисунках 1- 4.

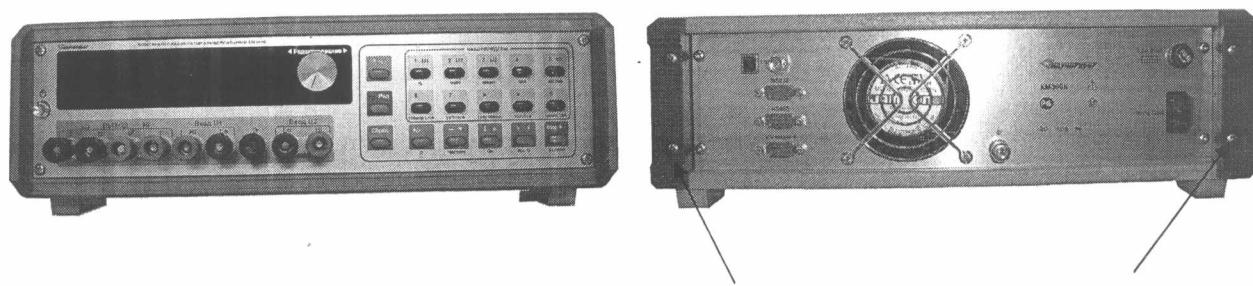


Рисунок 1 - Общий вид передней и задней панели компаратора – калибратора универсального KM300К

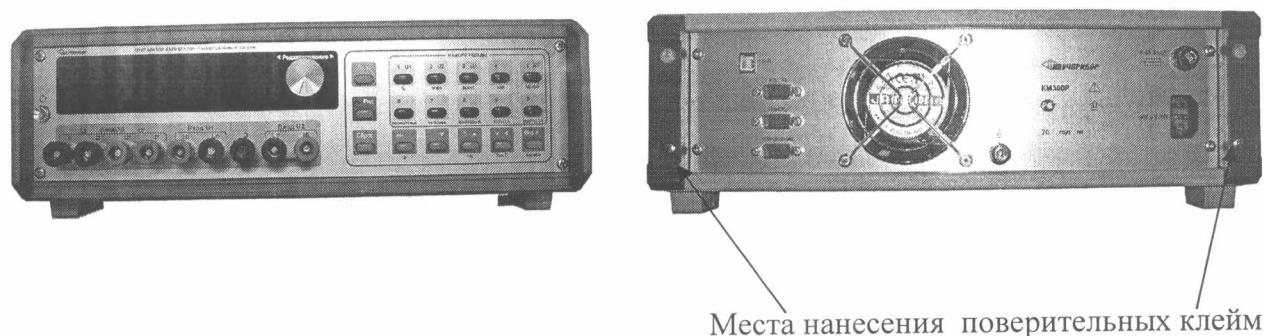


Рисунок 2 - Общий вид передней и задней панели компаратора – калибратора универсального KM300Р

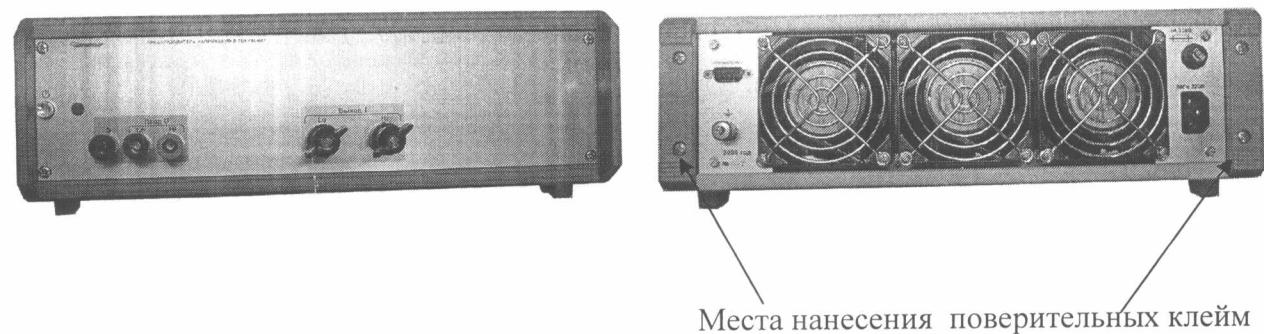


Рисунок 3 - Общий вид передней и задней панели преобразователя KM300Т

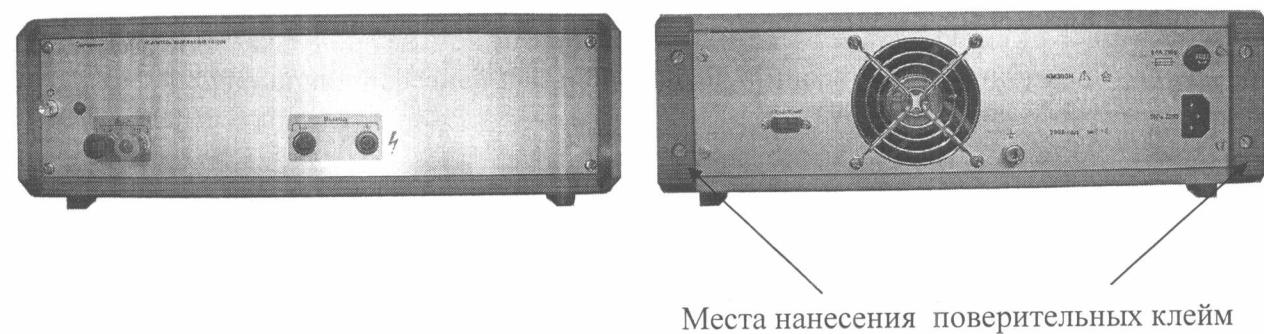


Рисунок 4 - Общий вид передней и задней панели усилителя KM300Н

Программное обеспечение

Калибратор имеет встроенное и внешнее программное обеспечение (ПО). Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Вклад ПО в суммарную погрешность калибраторов незначителен, так как определяется погрешностью индуктивных делителей напряжения и погрешностью АЦП, являющихся ничтожно малой по сравнению с погрешностью измерителя.

Встроенное ПО защищено от несанкционированного доступа аппаратно средствами микроконтроллера, делающими невозможными чтение и изменение микропрограммы, запрограммированной в заводских условиях с использованием специального программатора. Изменить ПО через интерфейс также невозможно.

Внешнее ПО (удаленное управление КМ300С), устанавливаемое на персональный компьютер, предусматривает различные экранные формы, предназначенные для управления калибратором.

Внешнее ПО не является метрологически значимым, поскольку только передает команды, позволяющие переключать множители и выбирать требуемое воспроизведенное номинальное значение напряжения или тока.

Таблица 1- Идентификационные данные программного обеспечения

| Наименование ПО | Идентификационное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Встроенное | Микропрограмма | 2.11 | 0xF5A1 | CRC16 |
| Внешнее | Удаленное управление КМ300 | 1.5 | f50037dd9845fd2aa778c97c 9f005df9 | md5 |

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «А» в соответствии с МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

1 Основные параметры и характеристики компаратора КМ300 в режиме компарирования напряжения постоянного тока

1.1 Компарирование напряжения постоянного тока осуществляется компаратором-калибратором универсальным КМ300К.

Диапазон компарирования от 10 нВ до 10 В;

Пределы допускаемой основной погрешности компарирования указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Пределы допускаемой основной погрешности компарирования напряжения постоянного тока (нелинейность), 7.5 -разрядная шкала

| Предел, Up | Пределы допускаемой основной погрешности, $\pm (\% \text{ от } U + \% \text{ от } Up)$ |
|------------|--|
| | 1 год, $(T_k \pm 1) ^\circ C$ |
| «100mV» | 0,0002 + 0,00004 |
| «1V» | 0,0001 + 0,00001 |
| «10V» | 0,0001 + 0,00001 |

П р и м е ч а н и е - T_k – температура, при которой осуществлялась калибровка компаратора КМ300. T_k не должна выходить за пределы $10-35 ^\circ C$. При выпуске $T_k = (23 \pm 1) ^\circ C$.

U – измеренное значение напряжения;

Up – напряжение пределов.

П р и м е ч а н и е - Время прогрева системы ≥ 1 ч с последующим выполнением операции автокалибровки и установки комплектного нуля (0к). При изменении температуры окружающей среды более 2°C необходима установка нуля после 10 минутной выдержки при новой температуре.

1.2 Величина шума на пределе 10 В (нулевая составляющая) не превышает 0,2 мкВ (пик - пик) в полосе частот 1 Гц (Ти - период индикации измерения 1,2 с).

1.3 Величина шума на пределе 10 В, при воспроизведении 1,0 В не превышает 0,4 мкВ (пик - пик) в полосе частот 1 Гц (Ти - 1,2 с).

1.4 Обеспечивается перекрытие пределов не менее 2 %.

1.5 Время единичного измерения компаратора - не более 4 с на пределе 10 В и Ти - 0,6 с.

2 Основные параметры и характеристики компаратора КМ300 в режиме измерения и воспроизведения напряжения постоянного тока

2.1 Диапазон воспроизведения напряжения

постоянного тока модификациями компаратора КМ300:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| КМ300К, КМ300Р, КМ300КТ | от 10 нВ до 10 В; |
| КМ300КН, КМ300КНТ | от 10 нВ до 1000 В. |

2.2 Диапазон измерения напряжения постоянного

тока модификациями компаратора КМ300:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| КМ300К, КМ300КН, КМ300КТ, КМ300КНТ | от 10 нВ до 1000 В. |
|------------------------------------|---------------------|

2.3 Пределы допускаемой основной погрешности измерения и воспроизведения напряжения постоянного тока указаны в таблицах 3, 4.

П р и м е ч а н и я

1 Погрешность измерения с 6-разрядной шкалой увеличивается на одну единицу младшего разряда.

2 Время прогрева компаратора ≥ 1 ч с последующим выполнением операции автокалибровки и установки нуля.

3 Т_к – температура, при которой осуществлялась калибровка компаратора.

Т_к не должна выходить за пределы $10 - 35^{\circ}\text{C}$. При выпуске Т_к = $(23 \pm 1)^{\circ}\text{C}$.

Таблица 3 - Пределы допускаемой основной погрешности измерения напряжения постоянного тока, 7.5-разрядная шкала

| Предел, Уп | Пределы допускаемой основной погрешности, $\pm (\% \text{ от } U + \% \text{ от } U_{\text{п}})$ ¹⁾ | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 24 часа, $(T_k \pm 1)^{\circ}\text{C}$ | 3 месяца, $(T_k \pm 1)^{\circ}\text{C}$ | 1 год, $(T_k \pm 1)^{\circ}\text{C}$ | 1 год, $(T_k \pm 5)^{\circ}\text{C}$ |
| «100mV» | $0,0005 + 0,00004$ | $0,0009 + 0,00004$ | $0,0011 + 0,00004$ | $0,0013 + 0,00004$ |
| «1V» | $0,00025 + 0,000015$ | $0,00065 + 0,000015$ | $0,00085 + 0,000015$ | $0,001 + 0,000015$ |
| «10V» | $0,0001 + 0,00001$ | $0,0005 + 0,00001$ | $0,0007 + 0,00001$ | $0,00085 + 0,00001$ |
| «100V» ²⁾ | $0,001 + 0,0005$ | $0,0015 + 0,0005$ | $0,0025 + 0,0005$ | $0,0035 + 0,001$ |
| «1000V» ²⁾ | $0,0015 + 0,0005$ | $0,0025 + 0,0005$ | $0,003 + 0,0005$ | $0,004 + 0,001$ |

¹⁾ При выпуске из производства компаратор КМ300 калибруется по рабочему эталону первого разряда (мера постоянного напряжения 7001, погрешность которой менее 0,00015 % годовых).

На пределах 100 mV, 1V, 10V измерения производятся с 7.5 разрядной шкалой, а на пределах 100V и 1000 - с 6.5 разрядной шкалой.

²⁾ Для модификаций КМ300КН, КМ300КНТ.

П р и м е ч а н и е - У – измеренное значение напряжения;

Уп – напряжение пределов.

Таблица 4 - Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока , 7.5-разрядная шкала

| Предел, Up | Пределы допускаемой основной погрешности, $\pm (\% \text{ от } U + \% \text{ от } Up)$ ¹⁾ | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 24 часа, ($T_k \pm 1$) °C | 3 месяца, ($T_k \pm 1$) °C | 1 год, ($T_k \pm 1$) °C | 1 год, ($T_k \pm 5$) °C |
| «100mV» | 0,0005 + 0,00004 | 0,0009 + 0,00004 | 0,0011 + 0,00004 | 0,0013 + 0,00004 |
| «1V» | 0,00025 + 0,000015 | 0,00065 + 0,000015 | 0,00085 + 0,000015 | 0,001 + 0,000015 |
| «10V» | 0,0001 + 0,00001 | 0,0005 + 0,00001 | 0,0007 + 0,00001 | 0,00085 + 0,00001 |
| «100V» ²⁾ | 0,001 + 0,0005 | 0,0015 + 0,0005 | 0,0025 + 0,0005 | 0,0035 + 0,001 |
| «1000V» ²⁾ | 0,0015 + 0,0005 | 0,0025 + 0,0005 | 0,003 + 0,0005 | 0,004 + 0,001 |

¹⁾ При выпуске из производства компаратор КМ300 калибруется по рабочему эталону первого разряда (мера напряжения 7001, погрешность которой менее 0,00015 % годовых).

²⁾ Для модификаций КМ300КН, КМ300КНТ.

Примечание - Up – измеренное значение напряжения;
Up – напряжение пределов.

2.4 Компаратор КМ300 обеспечивает перекрытие пределов измерения и воспроизведения напряжения постоянного тока не менее чем на 2 %.

2.5 Метрологические характеристики и параметры компаратора КМ300 в режиме микровольтметра соответствуют требованиям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5- Характеристики и параметры КМ300 в режиме микровольтметра

| Предел, Up | Пределы допускаемой основной погрешности $\pm (\% \text{ от } U + \% \text{ от } Up)$ | Входной ток, нА | Входное сопротивление |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| 100 μV | 0,2 + 0,04 | < 0,1 | > 10 МОм |
| 1 mV | 0,08 + 0,02 | < 0,1 | > 100 МОм |
| 10 V | 0,01 + 0,002 | < 0,1 | > 10 ГОм |

Примечание - Up – измеренное значение напряжения;
Up – напряжение пределов.

2.6 Параметры выходной цепи компаратора КМ300 в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Параметры выходной цепи компаратора КМ300 в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока

| Предел, Up | Выходное сопротивление, Ом | Максимальный ток на выходе Im, мА |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 100 mV | 20 | - |
| 1 V | 200 | - |
| 10 V | $\leq 0,0003$ | 100 |
| 100 V | $\leq 0,5$ | 10 |
| 1000 V | $\leq 0,5$ | 10 |

2.7 Подавление помехи микровольтметром:

- последовательного (нормального) вида с частотой питающей сети - не менее 100 дБ при динамическом диапазоне (амплитудное значение) 50 мВ;

- параллельного (общего) для напряжений с частотой питающей сети - не менее 120 дБ при динамическом диапазоне (амплитудное значение) 250 В.

2.8 Время установления выходного напряжения компаратора КМ300 (с точностью до 1 млн^{-1}) - не более 3 с (увеличивается на 1 с при изменении полярности или предела).

2.9 Дополнительная температурная погрешность воспроизведения и измерения напряжения постоянного тока, при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10°C - не более основной погрешности, нормируемой за 1 год при температуре $T = (T_k \pm 1)^\circ\text{C}$.

3 Основные параметры и характеристики компаратора КМ300 в режиме воспроизведения напряжения переменного тока

3.1 Диапазон воспроизведения напряжения переменного тока модификациями компаратора КМ300 в частотном диапазоне от 10 до 1000 Гц:

| | |
|-------------------|-------------------|
| KM300K, KM300KT | от 1 мВ до 10 В; |
| KM300KH, KM300KHT | от 1 мВ до 700 В. |

3.2 Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока приведены в таблице 7.

3.3 Время установления выходного напряжения - не более 0,5 с, время установления частоты - не более 0,5 с.

3.4 Дополнительная температурная погрешность воспроизведения напряжения переменного тока, обусловленная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°C - не более основной погрешности, нормируемой за один год при $T = (T_k \pm 1)^\circ\text{C}$.

Таблица 7 - Предел допускаемой основной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока, 6. 5-разрядная шкала

| Пределы, Up (диапазон U) | Частотный диапазон, Гц | Пределы допускаемой основной погрешности за 1 год, $\pm (\% \text{ от } U + \% \text{ от } Up)^1)$ | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| | | $(T_k \pm 1)^\circ\text{C}$ | $(T_k \pm 5)^\circ\text{C}$ |
| «100mV» (1 – 102 мВ) | 10 - 1000 | 0,02 + 0,005 | 0,03 + 0,005 |
| «1V» (10 мВ – 1,02 В) | 10 - 1000 | 0,015 + 0,005 | 0,02 + 0,005 |
| «10V» (0,1 – 10,2 В) | 10 - 1000 | 0,015 + 0,005 | 0,02 + 0,005 |
| «100V» ²⁾ (1 – 102 В) | 10 - 1000 | 0,025 + 0,005 | 0,035 + 0,005 |
| «700V» ²⁾ (10 – 720 В) | 10 - 1000 | 0,03 + 0,005 | 0,04 + 0,005 |

¹⁾ Пределы допускаемой основной погрешности нормируются от 10 % Up до Up.

При выпуске $T_k = (23 \pm 1)^\circ\text{C}$.

²⁾ Для модификаций KM300KH, KM300KHT.

П р и м е ч а н и е - U – измеренное значение напряжения;

Up – напряжение пределов.

3.5 Компаратор КМ300 обеспечивает установку частоты напряжения синусоидальной формы на пределах, с диапазонами, дискретностью и погрешностью, указанными в таблице 8.

Таблица 8 - Пределы, диапазоны и погрешность установки частоты

| Пределы частоты, Гц | Частотный диапазон, Гц | Дискретность, Гц | Пределы допускаемой отно- сительной погрешности ус- тановки частоты, %, не бо- лее |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| 1000 | 10 - 1000 | 1 | 0,003 |

3.6 Нагрузочные характеристики и коэффициент гармоник компаратора КМ300 в режиме воспроизведения напряжения переменного тока удовлетворяют требованиям, указанным в таблице 9.

Таблица 9 - Нагрузочные характеристики и коэффициент гармоник компаратора КМ300 в режиме воспроизведения напряжения переменного тока

| Предел, U _п | Частотный диапазон, Гц | Коэффициент гармоник K _г , %, не более | Нагрузочные характеристики | |
|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Емкость нагрузки, пФ, не более | Ток нагрузки, мА, не более |
| «100мV» | 10 - 1000 | 0,06 | 1000 | 20 |
| «1V» | 10 - 1000 | 0,06 | 1000 | 50 |
| «10V» | 10 - 1000 | 0,06 | 1000 | 50 |
| «100V» | 10 - 1000 | 0,1 | 500 | 10 |
| «700V» | 10 - 1000 | 0,1 | 500 | 10 |

4 Основные параметры и характеристики компаратора КМ300 в режиме воспроизведения силы постоянного тока

4.1 Модификация компаратора КМ300 - компаратор КМ300КТ, в состав которого входят компаратор – калибратор универсальный КМ300К и преобразователь КМ300Т обеспечивает воспроизведение силы постоянного тока от 0,1 нА до 50 А с параметрами и характеристиками, приведенными в таблице 10.

Таблица 10 - Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения силы постоянного тока и выходные параметры калибратора силы постоянного тока, 7,5-разрядная шкала

| Предел, I _п | Пределы допускаемой основной погрешно- сти за 1 год ± (% от I + % от I _п) | | Допустимое сопротивление нагрузки, Ом | Выходное сопротивление, не менее |
|---------------------------|---|-------------------------|--|--|
| | (T _к ± 1) °C | (T _к ± 5) °C | | |
| «1mA» | 0,0025+0,0005 | 0,0035+0,0005 | до 2000 | 1 ГОм |
| «10mA» | 0,0025+0,0005 | 0,0035+0,0005 | до 200 | 100 МОм |
| «100mA» | 0,0025+0,0005 | 0,0035+0,0005 | до 20 | 10 МОм |
| «1A» | 0,005+0,001 | 0,007+0,001 | до 1 | 0,5 МОм |
| «10A» | 0,008+0,002 | 0,012+0,002 | до 0,1 | 20 кОм |
| «50A» ¹⁾ | 0,035+0,004 | 0,05+0,004 | до 0,02 | 2 кОм |

¹⁾ Ток 40 – 50 А задавать в течение 3 мин с последующим перерывом 5 мин.

Примечания

1 Т_к – температура, при которой осуществлялась калибровка компаратора КМ300. Т_к не должна выходить за пределы 15 – 30 °C. При выпуске Т_к = (23 ± 1) °C.

2 I – измеренное значение тока;

I_п – значение предела.

4.2 Динамический диапазон выходного напряжения составляет:

на пределах 1, 10 и 100 мА

от минус 9 до 9 В,

на пределе 1 А

от минус 7 до 7 В,

на пределе 10 А

от минус 2 до 2 В,

на пределе 50 А

от минус 1 до 1 В.

4.3 Компаратор КМ300КТ обеспечивает перекрытие пределов воспроизведения силы постоянного тока не менее 2 %.

4.4 Дополнительная температурная погрешность воспроизведения силы постоянного тока, обусловленная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°C , - не более основной погрешности, нормируемой за один год при $T = (T_k \pm 1)^{\circ}\text{C}$.

5 Основные параметры и характеристики компаратора КМ300 в режиме воспроизведения силы переменного тока

5.1 Модификация компаратора КМ300 - компаратор КМ300КТ обеспечивает воспроизведение силы переменного тока (синусоидальной формы) в диапазоне от 10 мА до 50 А в частотном диапазоне от 10 до 1000 Гц с параметрами и характеристиками, приведенными в таблицах 11, 12.

Таблица 11 - Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения силы переменного тока

| Пределы, I_p (диапазон I) | Частотный диапазон, Гц | Пределы допускаемой основной погрешности за 1 год, $\pm (\% \text{ от } I + \% \text{ от } I_p)$ | | Допустимое сопротивление на нагрузке, Ом |
|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| | | $(T_k \pm 1)^{\circ}\text{C}$ | $(T_k \pm 5)^{\circ}\text{C}$ | |
| «1mA» (10 мА - 1,02 мА) | 10 - 1000 | $0,025 + 0,005$ | $0,03 + 0,005$ | до 2000 |
| «10mA» (0,1 - 10,2 мА) | 10 - 1000 | $0,025 + 0,005$ | $0,03 + 0,005$ | до 200 |
| «100mA» (1 - 102 мА) | 10 - 1000 | $0,025 + 0,005$ | $0,03 + 0,005$ | до 20 |
| «1A» (0,01 - 1,02 А) | 10 - 1000 | $0,035 + 0,005$ | $0,05 + 0,005$ | до 0,5 |
| «10A» (0,1 - 10,2 А) | 10 - 1000 | $0,045 + 0,005$ | $0,065 + 0,005$ | до 0,05 |
| «50A» ¹⁾ (10 - 51,0 А) | 45 - 1000 | $0,08 + 0,02$ | $0,12 + 0,02$ | до 0,02 |

¹⁾ Ток 40 – 50 А выдается в течение 3 мин после чего срабатывает защита от перегрева с последующим перерывом для автоматического охлаждения.

П р и м е ч а н и я

1 T_k – температура, при которой осуществлялась калибровка компаратора КМ300.

T_k не должна выходить за пределы $10 - 35^{\circ}\text{C}$. При выпуске $T_k = (23 \pm 1)^{\circ}\text{C}$.

2 I – измеренное значение тока;

I_p – значение предела.

Таблица 12 - Выходные параметры компаратора КМ300 в режиме воспроизведения силы переменного тока

| Предел, I_p | Частотный диапазон, Гц | Выходные параметры | |
|------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Коэффициент гармоник K_g , %, не более | Выходное сопротивление, не менее |
| «1mA» | 10 - 1000 | 0,08 | 30 МОм |
| «10mA» | 10 - 1000 | 0,08 | 3 МОм |
| «100mA» | 10 - 1000 | 0,08 | 300 кОм |
| «1A» | 10 - 1000 | 0,08 | 30 кОм |
| «10A» | 10 - 1000 | 0,1 | 1 кОм |
| «50A» | 45 - 1000 | 0,15 | 200 Ом |

5.2 Дополнительная температурная погрешность воспроизведения силы переменного тока, обусловленная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°C , - не более основной погрешности, нормируемой за 1 год при $T = (\text{Tk} \pm 1)^{\circ}\text{C}$.

6 Основные параметры и характеристики компаратора КМ300 в режиме калибратора мощности

6.1 Компаратор КМ300 при совместном использовании модификаций КМ300КН и КМ300КТ обеспечивает воспроизведение мощности постоянного и переменного тока и угла сдвига фаз между током и напряжением. Метрологические характеристики компаратора КМ300 в режиме воспроизведение угла сдвига фаз приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Метрологические характеристики компаратора КМ300 в режиме воспроизведение угла сдвига фаз

| Частотный диапазон, Гц | Диапазон значений, (Разрешающая способность) | Пределы абсолютной погрешности $\Delta\phi$ за 1 год, $^{\circ}$ |
|------------------------|--|--|
| 45 - 55 | от минус 180 до плюс 180 | $\pm 0,1$ |
| 55 - 1000 | (0,01) | $\pm (0,1 + 0,002 * (f - 55))$ |

6.2 Диапазон воспроизведения мощности, В·А от 1 мВт до 10кВт.

6.3 Относительная погрешность воспроизведения мощности переменного тока, δ_P определяется по формуле, %:

$$\delta_P = \sqrt{\delta_U^2 + \delta_I^2 + \delta_{\phi}^2},$$

где δ_U - погрешность воспроизведения напряжения переменного тока, определяемая согласно таблице 7, %;

δ_I - погрешность воспроизведения силы переменного тока, определяемая согласно таблице 11, %;

δ_{ϕ} - погрешность воспроизведения коэффициента мощности, рассчитываемая по формуле, %:

$$\delta_{\phi} = 100 \cdot \left(1 - \frac{\text{Cos}(\varphi + \Delta\phi)}{\text{Cos}\varphi} \right),$$

где φ - воспроизводимый угол сдвига фаз между напряжением и токами;

$\Delta\phi$ - предел абсолютной погрешности угла сдвига фаз, определяется согласно таблице 13, $^{\circ}$.

Относительная погрешность воспроизведения мощности постоянного тока, δ_P определяется по формуле, %:

$$\delta_P = \sqrt{\delta_U^2 + \delta_I^2},$$

где δ_U - погрешность воспроизведения напряжения постоянного тока, определяется согласно таблице 4, %;

δ_I - погрешность воспроизведения силы постоянного тока, определяется согласно таблице 10, %.

7 Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха - $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность - 30 – 80 %;
- атмосферное давление - 84 - 106 кПа (630 – 795 мм рт.ст.);
- напряжение питающей сети - $(220 \pm 4,4)$ В.

8 Рабочие условия эксплуатации соответствуют ГОСТ 22261 группа 1:

- температура окружающего воздуха - от 10 до 35°C ;
- относительная влажность - до 80 % при температуре 25°C ;
- напряжение питающей сети - (220 ± 22) В.

9 Время установления рабочего режима компаратора КМ300 - не менее 1 ч.

10 Время непрерывной работы компаратора КМ300
в рабочих условиях эксплуатации - не менее 24 ч.

П р и м е ч а н и е – Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима.

11 Компаратор КМ300 сохраняет свои технические характеристики при питании от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой от 47 до 63 Гц и содержанием гармоник не более 5 %.

12 Электрическая прочность изоляции между сетевыми цепями приборов КМ300К, КМ300Р, КМ300Т, КМ300Н и клеммой заземления (корпусом) выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение 2,2 кВ постоянного напряжения в нормальных условиях.

Электрическая прочность изоляции между входными - выходными клеммами прибора КМ300К, КМ300Р, КМ300Т и корпусом выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение 0,7 кВ постоянного напряжения в нормальных условиях.

Электрическая прочность изоляции между входными-выходными клеммами прибора КМ300Н и корпусом должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение 4,3 кВ постоянного тока в нормальных условиях.

Электрическая прочность изоляции между входными-выходными клеммами ДН вх и экраном (Э) должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение 4,3 кВ постоянного тока в нормальных условиях.

13 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными вместе корпусом, цепями сетевого питания приборов КМ300К, КМ300Р, КМ300Т, КМ300Н относительно входных - выходных клемм - не менее 10^9 Ом.

Электрическое сопротивление изоляции между соединенными вместе цепями сетевого питания приборов КМ300К, КМ300Р, КМ300Т, КМ300Н относительно корпуса - не менее 10^8 Ом.

14 Мощность, потребляемая приборами от сети питания при номинальном напряжении, - не более:

- 44 В·А для компаратора КМ300К, КМ300Р;
- 440 В·А для преобразователя КМ300Т;
- 130 В·А для усилителя КМ300Н.

15 Средняя наработка на отказ каждого из приборов компаратора КМ300 - не менее 15000 ч.

16 Средний срок службы каждого из приборов - не менее 10 лет.

17 Масса модификаций компаратора КМ300 - не более:

- 10 кг для компараторов КМ300К, КМ300Р;
- 22 кг для компаратора КМ300КТ;
- 20 кг для компаратора КМ300КН;
- 32 кг для компаратора КМ300КНТ.

18 Габаритные размеры модификаций компаратора КМ300 - не более (Ш, В, Г):

- 370*130*390 мм для компараторов КМ300К, КМ300Р;
- 370*260*390 мм для компараторов КМ300КТ, КМ300КН;
- 370*390*390 мм для компаратора КМ300КНТ.

Знак утверждения типа

наносят на лицевую панель любым способом и на титульные листы руководства по эксплуатации и формуляра печатным способом.

Комплектность средства измерений

Состав комплекта поставки компаратора КМ300 приведен в таблицах 14, 15, 16, 17, 18.

Таблица 14 - Состав комплекта поставки компаратора КМ300К

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|--|--|------|------------------------------|
| ЗИУСН.349.006-000 | КМ300К – компаратор-калибратор универсальный | 1 | |
| 0ИУСН.140.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| ЗИУСН.349.006-000ФО | Формуляр | 1 | |
| <u>Запасные части и принадлежности</u> | | | |
| | ЗИП компаратора КМ300К | | |
| 5ИУСН.500.300 | Кабель К1 | 2 | |
| 6ИУСН.345.001 | Делитель 100:1 (10 МОм/100 кОм) | 1 | |
| 8ИУСН.585.300 | Перемычка медная | 4 | 3 шт. установлены на клеммах |
| 8ИУСН.588.300-000 | Наконечник | 4 | |
| 8ИУСН.588.300-010 | Наконечник | 2 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В | 2 | |
| | Кабель USB A-B | 1 | |
| | Разъем DB9F | 1 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |

Таблица 15 - Состав комплекта поставки компаратора КМ300Р

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|--|--|------|------------------------------|
| ЗИУСН.349.006-001 | КМ300Р – компаратор-калибратор универсальный | 1 | |
| 0ИУСН.140.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| ЗИУСН.349.006-040ФО | Формуляр | 1 | |
| <u>Запасные части и принадлежности</u> | | | |
| | ЗИП компаратора КМ300Р | | |
| 5ИУСН.500.300 | Кабель К1 | 2 | |
| 8ИУСН.585.300 | Перемычка медная | 4 | 3 шт. установлены на клеммах |
| 8ИУСН.588.300-000 | Наконечник | 4 | |

Продолжение таблицы 15

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|-------------------|-------------------------------------|------|------------|
| 8ИУСН.588.300-010 | Наконечник | 2 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В | 2 | |
| | Кабель USB A-B | 1 | |
| | Разъем DB9F | 1 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |

Таблица 16- Состав комплекта поставки компаратора КМ300КТ

| Обозначение | Наименование | Ко л. | Примечание |
|---------------------|--|-------|------------------------------|
| ЗИУСН.349.006-000 | КМ300К – компаратор-калибратор универсальный | 1 | |
| ЗИУСН.489.002 | КМ300Т – преобразователь напряжение-ток | 1 | |
| 0ИУСН.140.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| ЗИУСН.349.006-010ФО | Формуляр | 1 | |
| | <u>Запасные части и принадлежности</u> | | |
| | ЗИП компаратора КМ300К | | |
| 5ИУСН.500.300 | Кабель К1 | 2 | |
| 6ИУСН.345.001 | Делитель 100:1 (10МОм/100 кОм) | 1 | |
| 8ИУСН.585.300 | Перемычка медная | 4 | 3 шт. установлены на клеммах |
| 8ИУСН.588.300-000 | Наконечник | 4 | |
| 8ИУСН.588.300-010 | Наконечник | 2 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В | 2 | |
| | Кабель USB A-B | 1 | |
| | Разъем DB9F | 1 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |
| | ЗИП преобразователя КМ300Т | | |
| 5ИУСН.500.401 | Кабель К4 | 1 | |
| 5ИУСН.500.402 | Кабель К5 | 1 | |
| 5ИУСН.500.403 | Соединитель (СТ, красный) | 1 | |
| 5ИУСН.500.404 | Соединитель (СТ, черный) | 1 | |
| 5ИУСН.500.405 | Кабель управления | 1 | |
| 5ИУСН.500.500 | Кабель К2 | 1 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15 А 250 В | 2 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |

Таблица 17 - Состав комплекта поставки компаратора КМ300КН

| Обозначение | Наименование | Ко л. | Примечание |
|---------------------|--|-------|------------|
| ЗИУСН.349.006-000 | КМ300К – компаратор-калибратор универсальный | 1 | |
| ЗИУСН.489.002 | КМ300Н – высоковольтный усилитель напряжения | 1 | |
| 0ИУСН.140.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| ЗИУСН.349.006-020ФО | Формуляр | 1 | |

Продолжение таблицы 17

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|-------------------|--|------|---|
| | <u>Запасные части и принадлежности</u> | | |
| | ЗИП компаратора КМ300К | | |
| ЗИУСН.459.008 | Измерительный резистор MP3050 (Под заказ) | 1 | Номинальные значения сопротивлений 0,1; ± 0,02 %, при совместном приобретении с КМ300КТ |
| 5ИУСН.500.300 | Кабель K1 | 2 | |
| 5ИУСН.500.408 | Кабель RS485 | 1 | При совместном приобретении с КМ300КТ |
| 5ИУСН.500.600 | Кабель синхронизации К3 | 1 | При совместном приобретении с КМ300КТ |
| 6ИУСН.345.001 | Делитель 100:1 (10 Мом/100 кОм) | 1 | |
| 8ИУСН.585.300 | Перемычка медная | 4 | 3 шт. установлены на клеммах |
| 8ИУСН.588.300-000 | Наконечник | 4 | |
| 8ИУСН.588.300-010 | Наконечник | 2 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В | 2 | |
| | Кабель USB A-B | 1 | |
| | Разъем DB9F | 1 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |
| | ЗИП усилителя КМ300Н | | |
| 5ИУСН.500.500 | Кабель K2 | 1 | |
| 5ИУСН.500.405 | Кабель управления | 1 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 1 А 250 В | 2 | |
| | Комплект проводов до 1000 В | 1 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |

Таблица 18 – Состав комплекта поставки компаратора КМ300КНТ

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------------|--|------|------------|
| ЗИУСН.349.006-000 | КМ300К – компаратор-калибратор универсальный | 1 | |
| ЗИУСН.489.002 | КМ300Н – высоковольтный усилитель напряжения | 1 | |
| ЗИУСН. 411582.034 | КМ300Т – преобразователь напряжение-ток | 1 | |
| 0ИУСН.140.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| ЗИУСН.349.006-030ФО | Формуляр | 1 | |

Продолжение таблицы 18

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|-------------------|--|------|------------------------------|
| | <u>Запасные части и принадлежности</u> | | |
| | ЗИП компаратора КМ300К | | |
| 5ИУСН.500.300 | Кабель К1 | 2 | |
| 5ИУСН.500.405 | Кабель управления | 1 | |
| 6ИУСН.345.001 | Делитель 100:1 (10МОм/100 кОм) | 1 | |
| 8ИУСН.585.300 | Перемычка медная | 4 | 3 шт. установлены на клеммах |
| 8ИУСН.588.300-000 | Наконечник | 4 | |
| 8ИУСН.588.300-010 | Наконечник | 2 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В | 2 | |
| | Кабель USB A-B | 1 | |
| | Разъем DB9F | 1 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |
| | ЗИП преобразователя КМ300Т | | |
| 5ИУСН.500.401 | Кабель К4 | 1 | |
| 5ИУСН.500.402 | Кабель К5 | 1 | |
| 5ИУСН.500.403 | Соединитель (СТ, красный) | 1 | |
| 5ИУСН.500.404 | Соединитель (СТ, черный) | 1 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15 А 250 В | 2 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |
| | ЗИП усилителя КМ300Н | | |
| 5ИУСН.500.500 | Кабель К2 | 1 | |
| ОЮ0.481.005 ТУ | Вставка плавкая ВП2Б-1В 1 А 250 В | 2 | |
| | Комплект проводов до 1000 В | 1 | |
| | Шнур соединительный | 1 | Сетевой |

Проверка осуществляется по

методике поверки, изложенной в разделе 9 «Методика поверки» руководства по эксплуатации ОИУСН.140.008 РЭ и утвержденная ГЦИСИ ФБУ «Краснодарский ЦСМ» в июле 2013 г.

Основные средства поверки приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Основные средства поверки

| Наименование | Тип средств измерений | Основные технические характеристики средств измерений |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| Мультиметр | 3458А | Линейность на пределе 10 В $\pm 0,00001\%$, измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 100 мВ до 1000 В; погрешность измерения от 0,0008 - 0,001%; измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 10 мВ до 10 В в полосе частот до 1 кГц; погрешность измерения $\pm 0,009\%$ |
| Мера постоянного напряжения | 7001 | Выходное напряжение 10 В; нестабильность за 360 дней $1,5 \text{ млн}^{-1}$ |

Продолжение таблицы 19

| Наименование | Тип средств измерений | Основные технические характеристики средств измерений |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Калибратор-вольтметр универсальный | H4-12 | Измерение напряжения переменного тока в диапазоне от 10 мВ до 1000 В, в частотном диапазоне от 0,1 Гц до 20 кГц; погрешность измерения переменного напряжения 0,003 – 0,005 % |
| Магазин электрического сопротивления | P4830/2 | Класс точности 0,05 |
| Калибратор | KM300KH | Воспроизведение напряжений постоянного тока до 1000 В, погрешность $\pm 0,003 \%$ |
| Измеритель разности фаз | Ф2-34 | Диапазон входных напряжений от 0,2 до 2 В; погрешность измерения угла фазового сдвига 0,1 ° в диапазоне частот до 1000 Гц |
| Катушки электрического сопротивления | P331 P321 | Номинальные сопротивления 1000; 100; 10; 1; 0,1 Ом; стабильность за 1 год $\pm 0,001 \%$ |
| Катушки электрического сопротивления | P310 | Номинальные сопротивления 0,01; 0,001 Ом; стабильность за 1 год $\pm 0,005 \%$ |
| Мера сопротивления | H4-12MC | Номинальные значения сопротивлений 100; 10; 1; 0,01 Ом; отклонение действительных значений сопротивления от номинального значения $\pm 0,01 \%$ |
| Измеритель нелинейных искажений | СК6-13 | Диапазон напряжений от 1 до 100 В; диапазон измеряемых искажений от 0,01 %, с погрешностью не более $\pm 10 \%$ |
| Частотомер электронно-счетный | ЧЗ-63 | Погрешность измерения периода не более $\pm 2 \times 10^{-6} \%$ |

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика воспроизведения напряжения постоянного и переменного тока; силы постоянного и переменного тока, измерения напряжений постоянного тока, компарирования напряжений постоянного тока компаратором-калибратором универсальным KM300 описана в документе 0ИУСН.140.008 РЭ «Компараторы-калибраторы универсальные KM300. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к компараторам-калибраторам универсальным KM300:

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

ГОСТ Р 52319-2005 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»

ГОСТ Р 51522.1-2011 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний»

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16А (в одной фазе)»

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым

Лист № 16
Всего листов 16

ком не более 16А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения»

ГОСТ 8.022-91 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне $1 \cdot 10^{-16} \dots 30\text{A}$ ».

ГОСТ 8.027-89 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электродвижущей силы и постоянного напряжения».

ГОСТ 8.028-86 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления»

МИ 1949-88 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжениями в диапазоне частот $1 \cdot 10^2 \dots 2 \cdot 10^7 \text{ Гц}$ ».

ТУ 4217-029-16851585-2008 «Компараторы-калибраторы универсальные КМ300»

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Применяются при выполнении работ и (или) оказании услуг по обеспечению единства измерений.

Изготовитель


Общество с ограниченной ответственностью предприятие «ЗИП-Научприбор»
(ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»)
тел. (8612) 252-32-92, 252-32-20 факс (8612) 252-32-92
Адрес: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 5.

Испытатель

Государственный центр испытаний средств измерений ФБУ «Краснодарский ЦСМ»

Регистрационный номер № 30021-10, по Государственному реестру. 350040,
г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 104а. Тел.: (861)233-76-50, факс 233-85-86.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии


Ф.В. Булыгин
М.п. «09» 09 2013 г.

