

**Республиканское унитарное предприятие
«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель
тел. (0232) 26 33 01, факс (0232) 26 33 00
e-mail: mail@gomelcsms.by, www.gomelcsms.by

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений**

№ 027/2026 от 04.06.2026 г.

Методика (метод) измерений массовой доли изотиазолинонов (изотиазолинов) в реагентах производства ООО "Экоэнерго" титриметрическим методом,


разработанная в ООО «ЛабАльянс», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, д. 27, офис 148,

установленная в АМИ.КЛ 0122-2026 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Массовая доля изотиазолинонов в реагентах производства ООО «ЭКОЭНЕРГО». Методика измерений титриметрическим методом»,

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Заместитель директора
Государственного предприятия
«Гомельский ЦСМС»

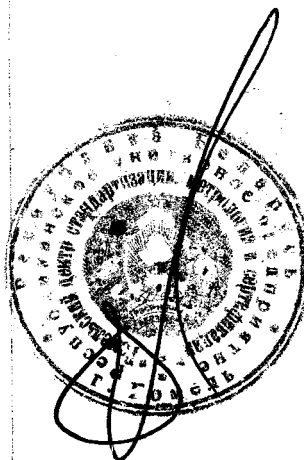

В.А.Мелешко

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

04 июня 2026 г.

Серия ГМ № 00552

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений,
методики (метода) измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерений, %	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ_r , %	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $\sigma_{I(To)}$, %	Относительный предел повторяемости r , %	Относительный предел промежуточной прецизионности $R_{I(To)}$, %	Относительная расширенная неопределенность U ($P=95\%$, $k=2$), %
Массовая доля изотиазолинонов	от 1,00 до 16,0	2,1	2,1	5,9	5,9	6,2