

С С С Р

Комитет по делам мер
и измерительных приборов
при
Совете Министров
СССР

МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ И ДОПУЩЕННЫЕ КОМИТЕТОМ
К ВЫПУСКУ В ОБРАЩЕНИИ И ПРИМЕНЕНИЮ В СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВЕСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТИПА Т2,
2-го класса, для предельных нагрузок 200 г, 1 и 5 кг

РЕЕСТР
232-64.
№ 232
Исключить
Т2-200


НАЗНАЧЕНИЕ

Весы технические типа Т2, 2-го класса, предназначаются для взвешивания медикаментов, ценных материалов и производства технических анализов.

ОПИСАНИЕ

Весы типа Т2 представляют собой равноплечие весы с нижними чашками

На коромысле весов закреплены две грузоприемные и одна опорная призмы и стрелка, служащая указателем равновесия. Нижний заостренный конец стрелки расположен против шкалы, укрепленной на колонке весов.

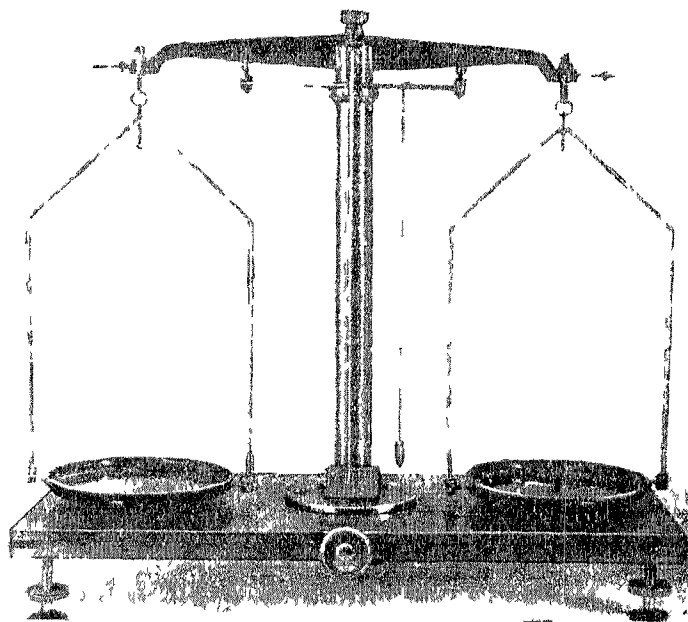

Весы технические типа Т2

Для уравнивания ненагруженных весов коромысло снабжено винтами с тарировочными гайками или флажком.

На грузоподъемных призмах коромысла повешены при помощи серы и дужек грузоприемные чашки или платформы.

Опорная призма коромысла опирается на подушки, запрессованные в головку стержня изолира.

Нижний конец стержня изолира впирается в эксцентрик или клин, перемещением которого при помощи маховичка или ручки приводится в действие изолирующее устройство.


Тип прибора утвержден и допущен к выпуску в обращение и применению в СССР приказом Председателя Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 24 июня 1949 г. за № 129 и внесен в Государственный реестр.

Весы технические типа Т2

Госреестр № 232

На колонке весов укреплена опора, на которую ложится коромысло при опускании стержня изолира.


На этой же опоре укреплен отвес.

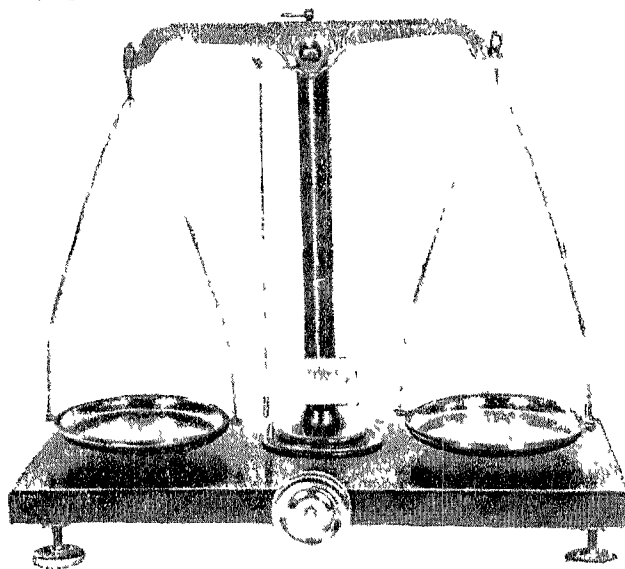

весы технические типа Т2

Колонка весов смонтирована на деревянной доске.

На нижней стороне доски по углам крепятся два установочных винта. В качестве третьей опоры весов служит неподвижный штифт.

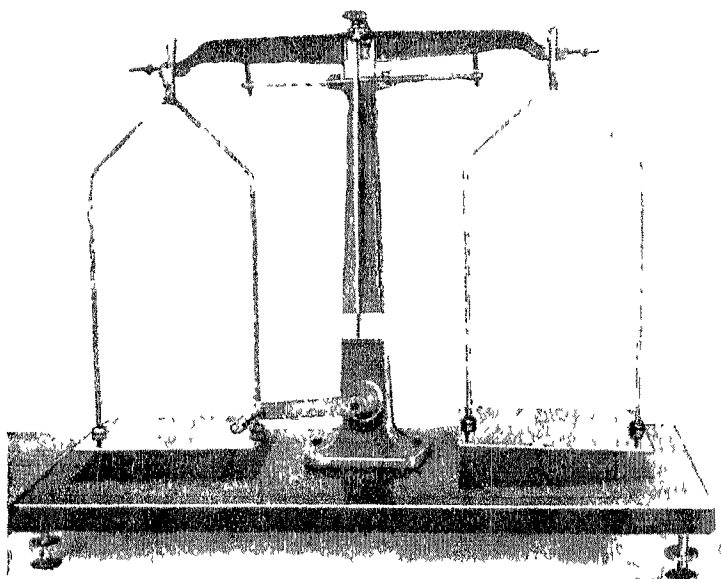

Весы технические типа Т2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное обозначение весов	Допустимые нагрузки		Допустимые погрешности в мг		
	наименьшая	предельная	ненагруженных весов	при 1/10 части предельной нагрузки	при предельной нагрузке
Т2-200	10 г	200 г	8	20	60
Т2-1	50 г	1 кг	20	50	200
Т2-5	200 г	5 кг	50	100	600

Госреестр № 232

Весы технические типа Т2

Габаритные размеры и вес (ориентировочно):

Условное обозначение весов	Длина в мм	Ширина в мм	Высота в мм	Вес весов в кг
Т2-200	330	173	342	2
Т2-1	495	224	414	4
Т2-5	650	285	556	11

МАРКИРОВКА

На лицевой стороне коромысла весов нанесены:

- 1) наименование или товарный знак завода-изготовителя;
- 2) заводской номер;
- 3) обозначение предельной нагрузки;
- 4) обозначение наименьшей допустимой нагрузки.

ПОВЕРКА

Государственная поверка весов технических типа Т2 при выпуске из производства и ремонта, а также находящихся в обращении, производится по Инструкции 16—39 Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

Этой же инструкцией следует руководствоваться при ведомственной поверке