

БЮРЕТКИ АПТЕЧНЫЕ С ДВУХХОДОВЫМ КРАНОМ И БЕЗ КРАНА

Внесены
в Государственный
реестр
под № 3859—73

Взамен 752

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 27 ноября 1973 г. Выпуск разрешен

установочной серии

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бюретки аптечные с двухходовым краном (рис. 1) и без крана (рис. 2), входящие в состав бюреточных установок, предназначены для объемного отмеривания жидких лекарственных препаратов.

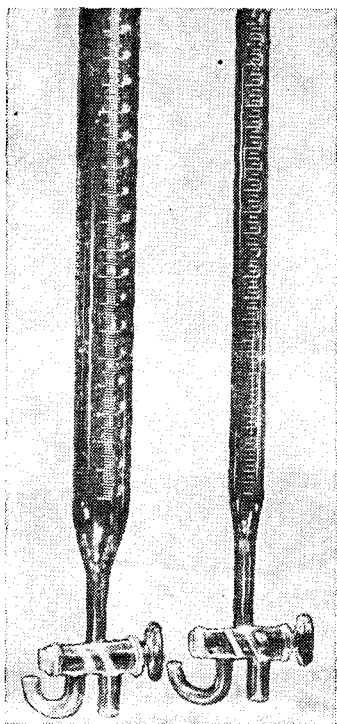


Рис. 1

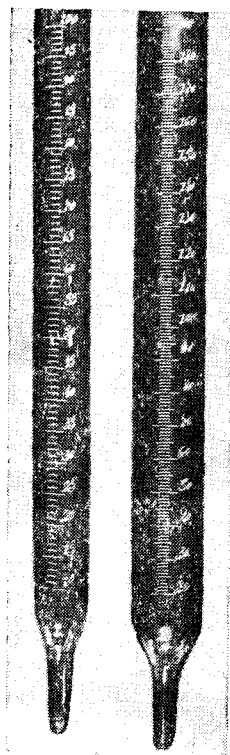


Рис. 2

ОПИСАНИЕ

Алтечные бюретки представляют собой стеклянные цилиндрические трубки с двухходовым краном в нижней части или без крана, градуированные в миллилитрах.

Принцип работы бюреток основан на наполнении и сливе жидкости до требуемого деления шкалы при помощи двухходового или диафрагменного кранов с ручным приводом бюреточной установки, в состав которой входят бюретки без крана.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость бюреток, цена деления и допускаемые отклонения приведены в таблице.

Номинальная вместимость бюреток	Цена деления шкалы	Допускаемые отклонения
мл		
10	0,20	$\pm 0,20$
25	0,25	$\pm 0,25$
60	0,50	$\pm 0,50$
100	1,00	$\pm 1,00$
200	1,00	$\pm 1,00$

Материал — стекло марки НС-1.

Отжиг 100 нм на 1 см длины светового пути.

ПОВЕРКА

Бюретки поверяют в соответствии с требованиями инструкции 31—64 «По поверке мер вместимости стеклянных технических 1-го и 2-го классов».

Испытания проводил и рассматривал их результаты Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).

Изготовитель — Министерство здравоохранения СССР.